
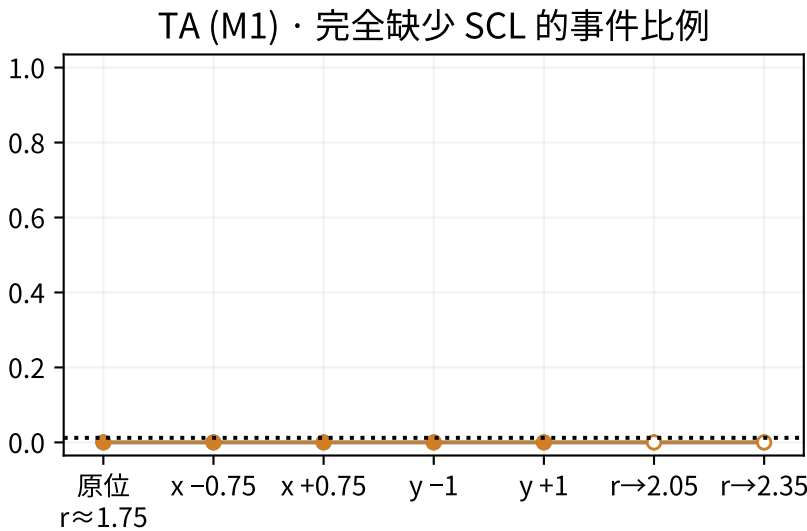
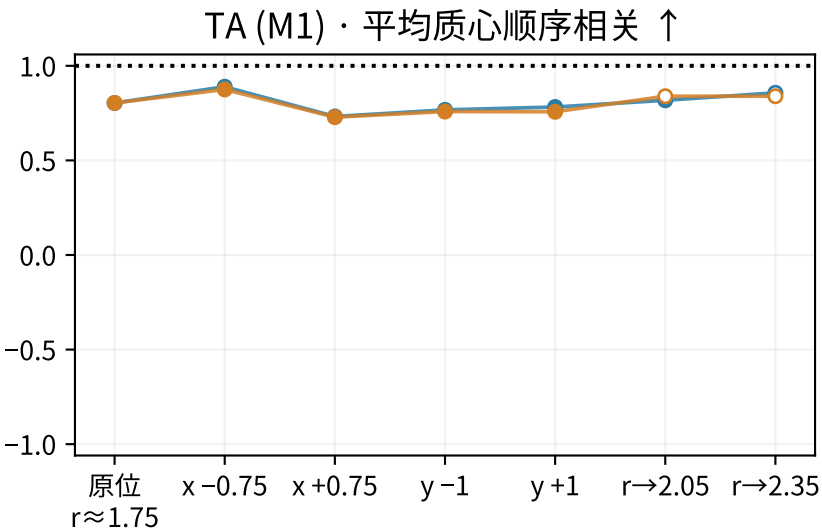
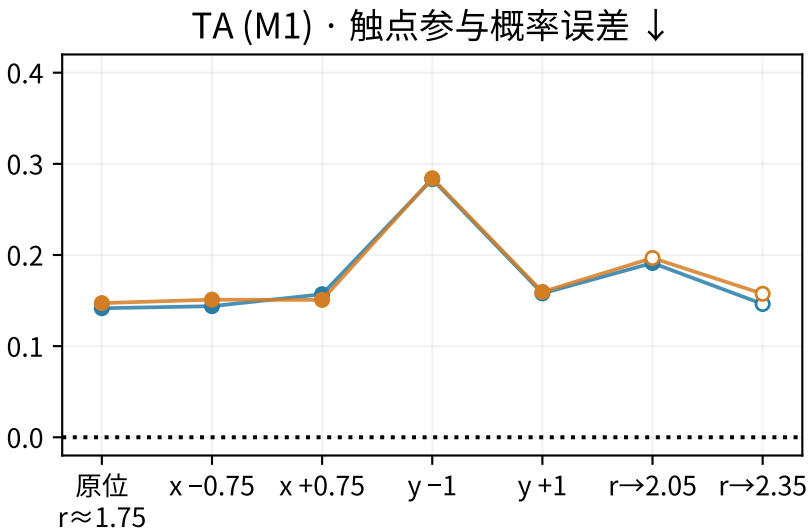
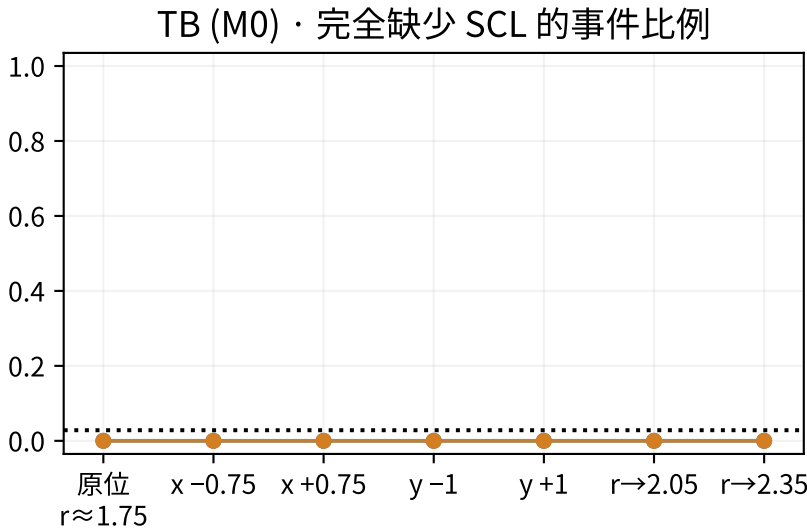
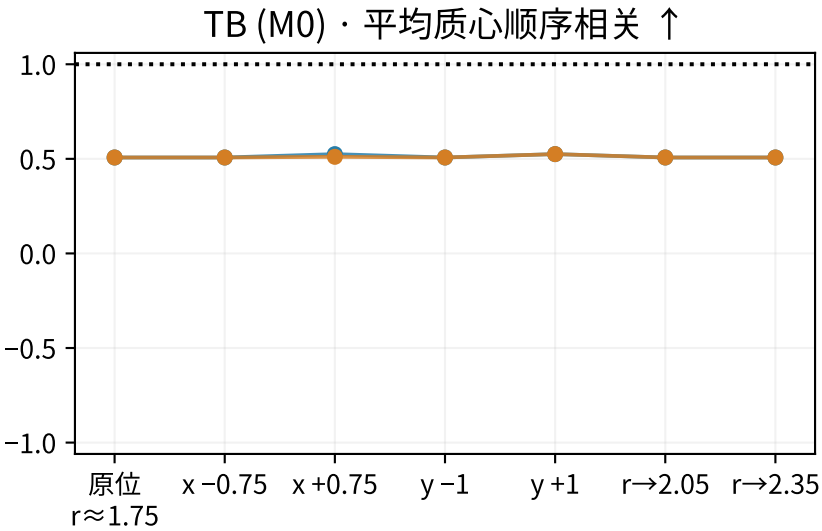


左核椭圆 4：1：左核位置与范围 | 原图三项观测

向外 $EE \times 1$ 、核内 $E \rightarrow I \times 0.75$ ； r 为等面积半径。扩大左核时匹配降阈值总量；平移仍改变core成员。

噪声 847101 噪声 847102 患者 FIT 参考

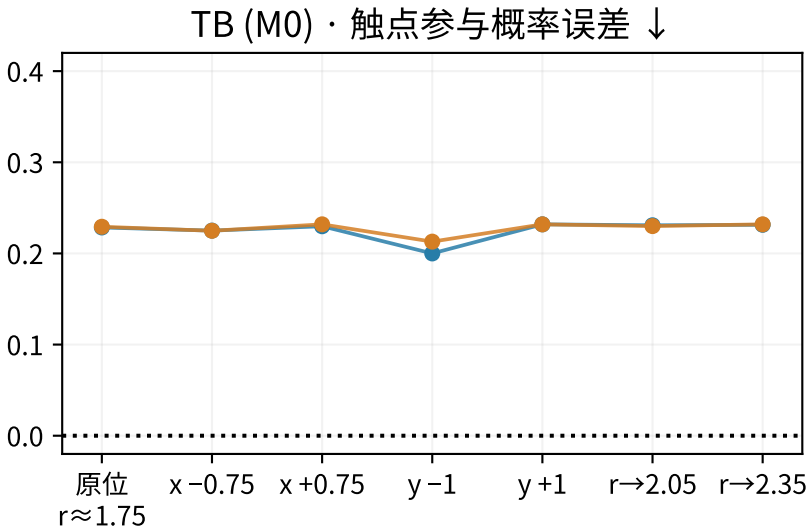

独立几何条件 (mm)；每项均相对原位，其余保持该工作点设置
颜色=两条噪声；固定基础网络 2511。本页已完成 14/14 个运行。

参与误差：15触点参与概率的平均绝对差；顺序相关：参与内归一化rank的逐触点均值与患者的Spearman相关。
整杆缺失只要求四个SCL触点均未参与；它接近0不代表整杆完整参与或内部顺序恢复。误差0 / 相关1是参照值，不是验收门槛。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。