
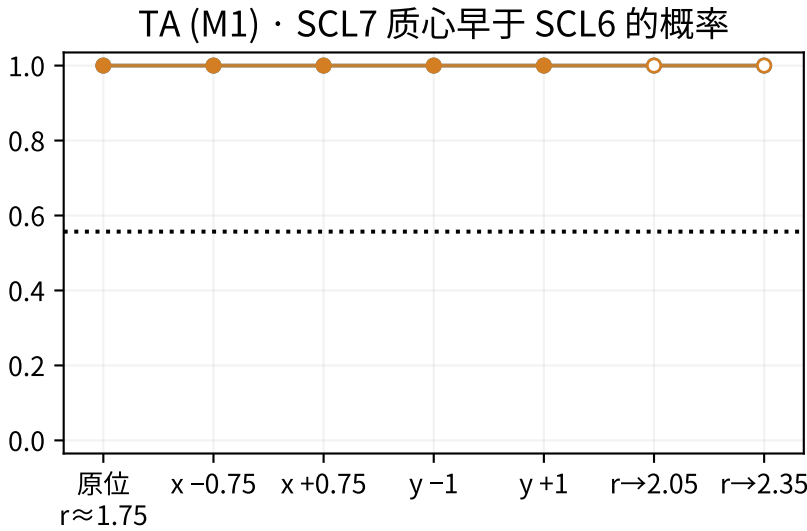
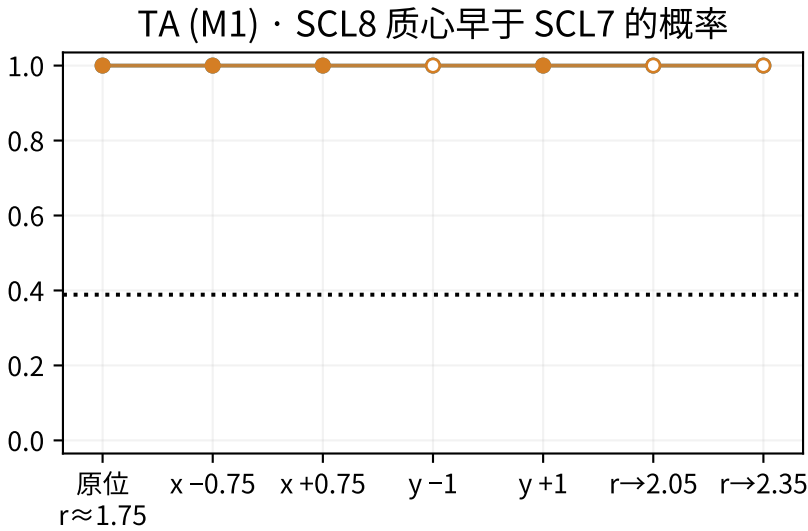
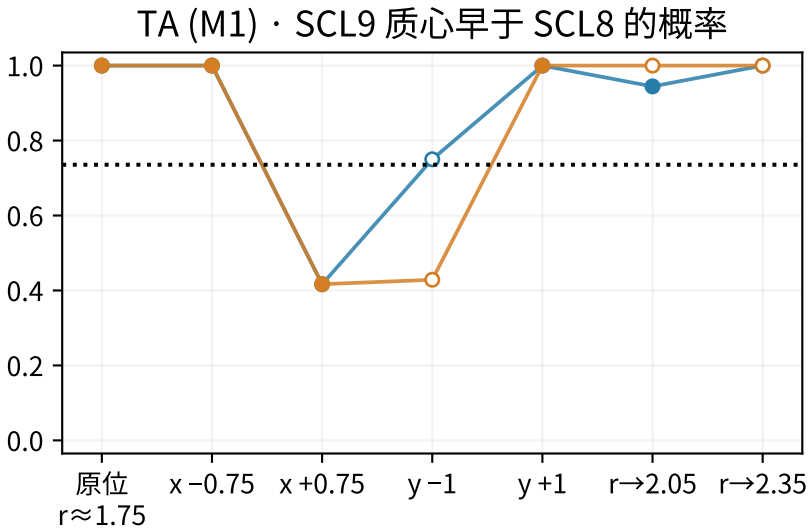
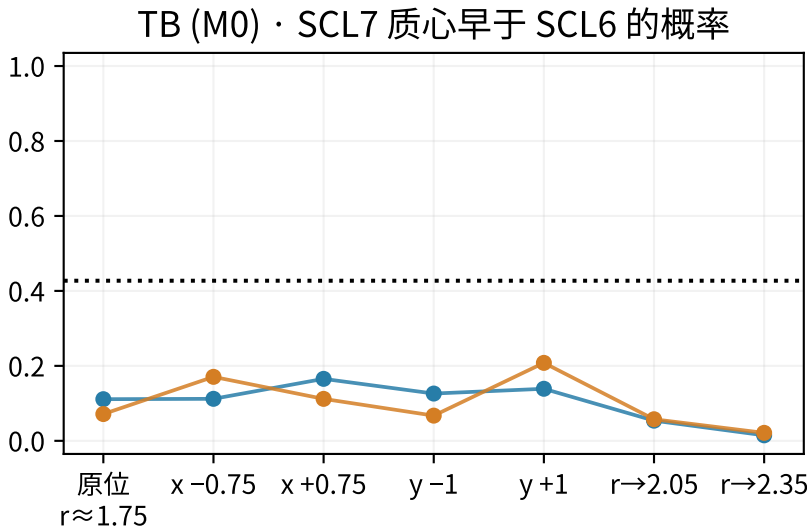
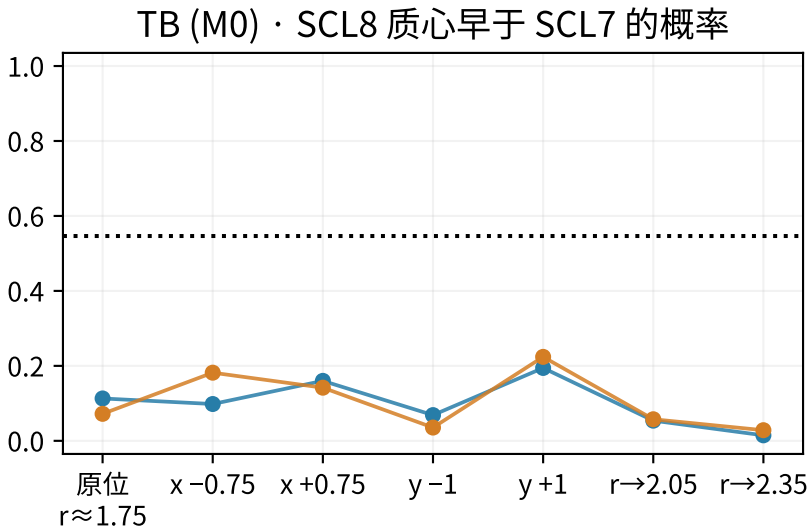


左核椭圆 4：1：左核位置与范围 | SCL 内部相邻顺序

向外 $EE \times 1$ 、核内 $E \rightarrow I \times 0.75$ ； r 为等面积半径。扩大左核时匹配降阈值总量；平移仍改变core成员。

—— 噪声 847101 —— 噪声 847102 患者 FIT 参考

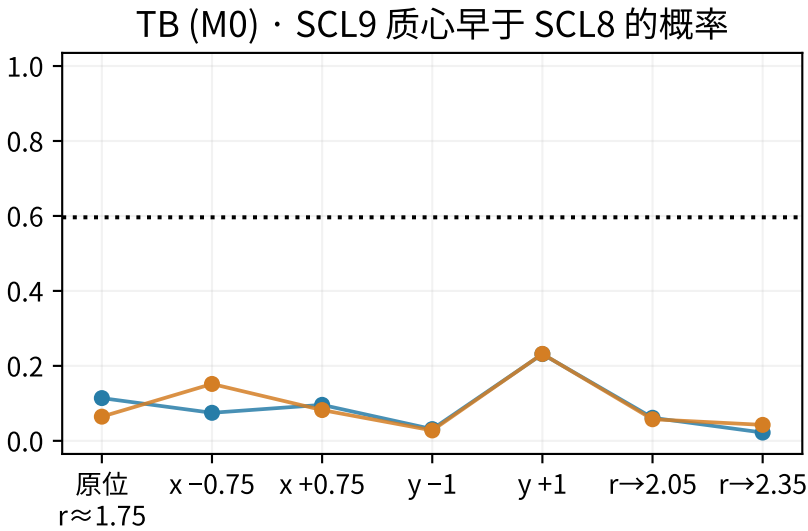

独立几何条件 (mm)；每项均相对原位，其余保持该工作点设置
颜色=两条噪声；固定基础网络 2511。本页已完成 14/14 个运行。

每个概率只使用对应两个触点共同参与的事件，质心完全并列计0.5；不要求四个SCL触点全部参与。
先后概率是时序观测，不等于因果传播路径；黑点线保留患者自身的顺序变异，不强制0或1。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。