
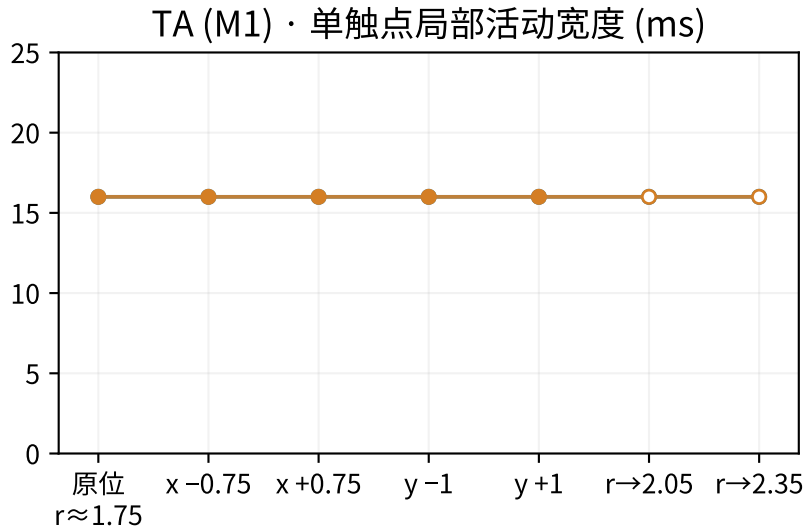
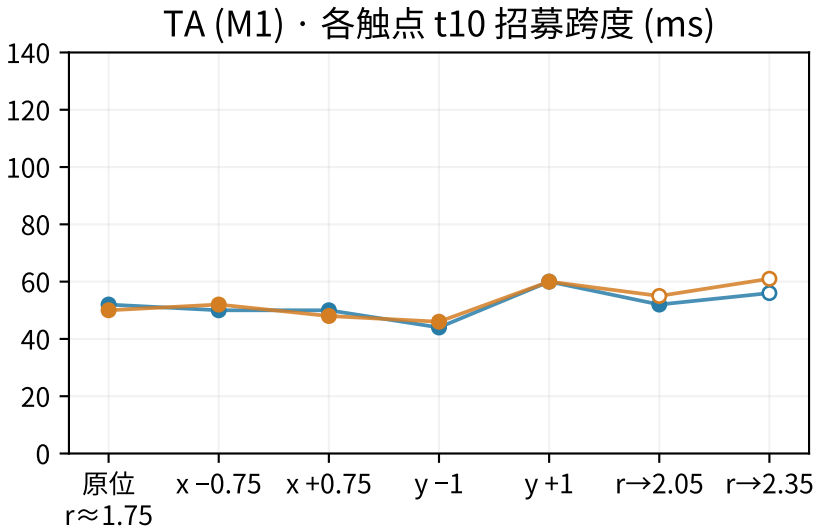
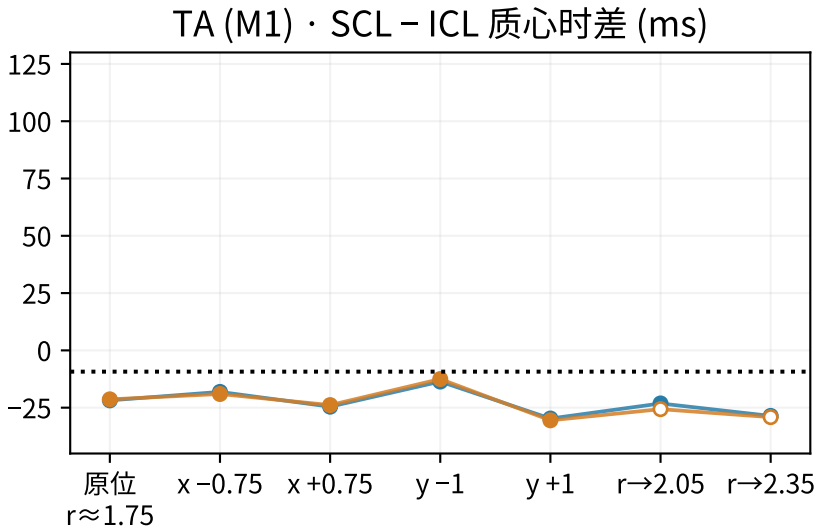
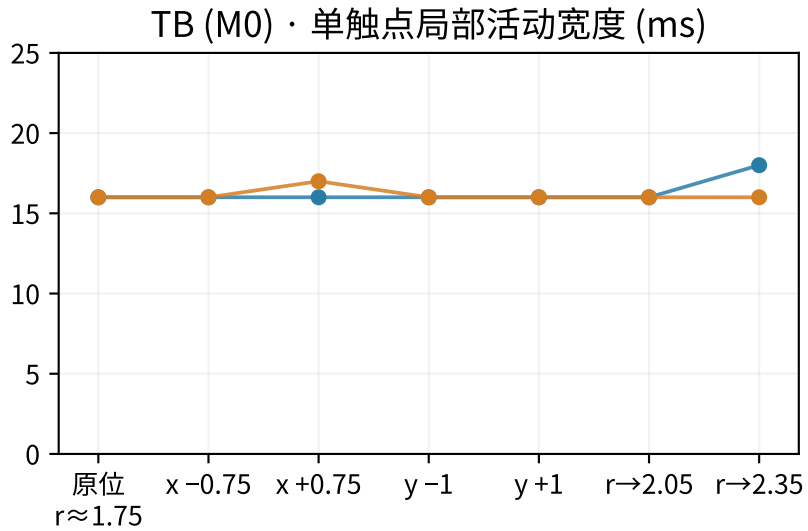
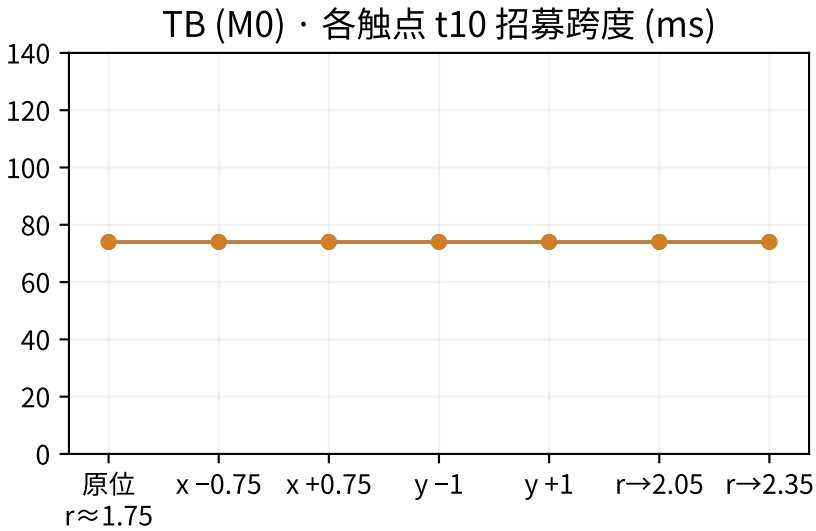


左核椭圆 4：1：左核位置与范围 | 窗内毫秒时间尺度

向外 $EE \times 1$ 、核内 $E \rightarrow I \times 0.75$ ； r 为等面积半径。扩大左核时匹配降阈值总量；平移仍改变core成员。

—— 噪声 847101 —— 噪声 847102 患者 FIT 参考

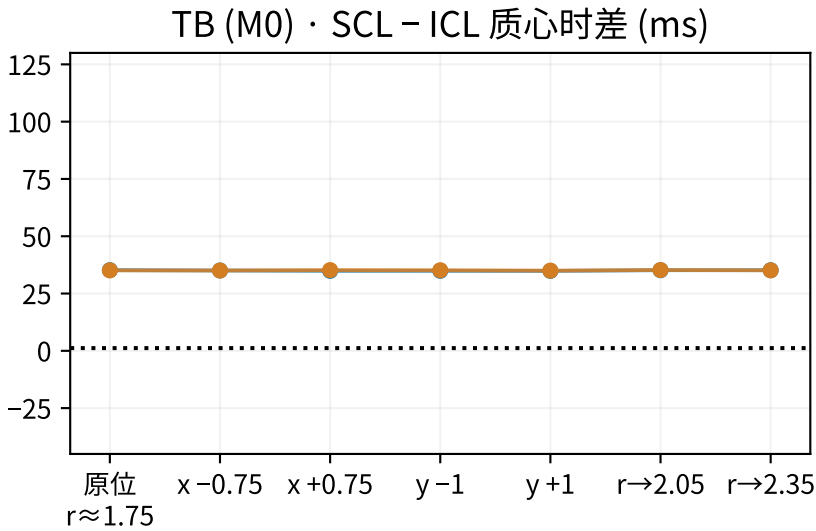

独立几何条件 (mm)；每项均相对原位，其余保持该工作点设置
颜色=两条噪声；固定基础网络 2511。本页已完成 14/14 个运行。

杆间差：每事件参与SCL质心中位数 – 参与ICL质心中位数，再取事件中位数；负值表示SCL较早。

t10跨度：参与触点累计包络质量10%时刻的极差；局部宽度：事件内各触点t90–t10中位数，再跨事件取中位数。后两项仅模型包络，无患者HFO等价线。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。