
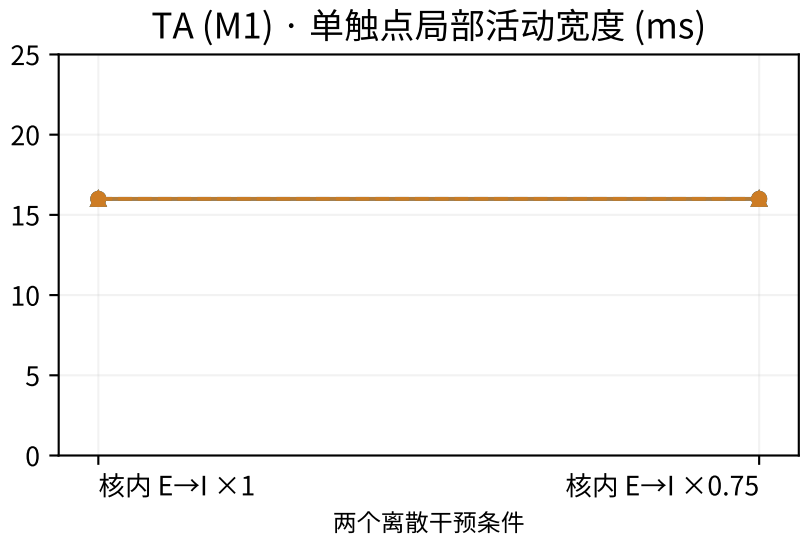
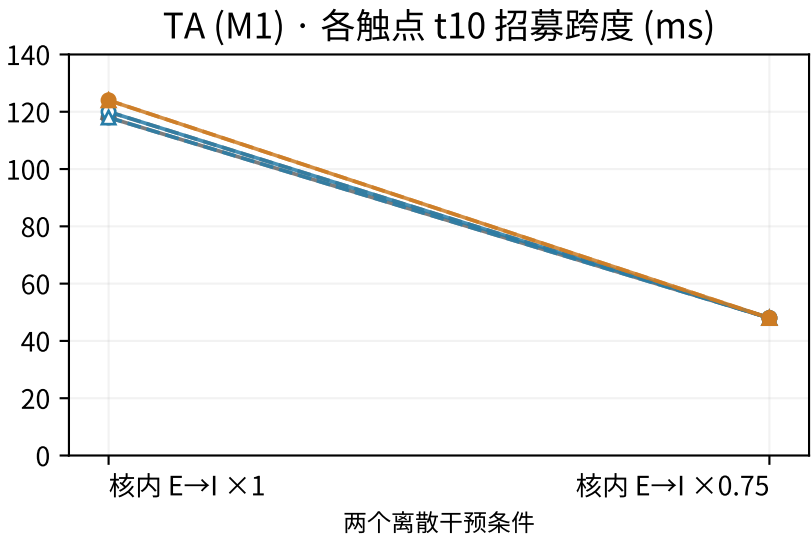
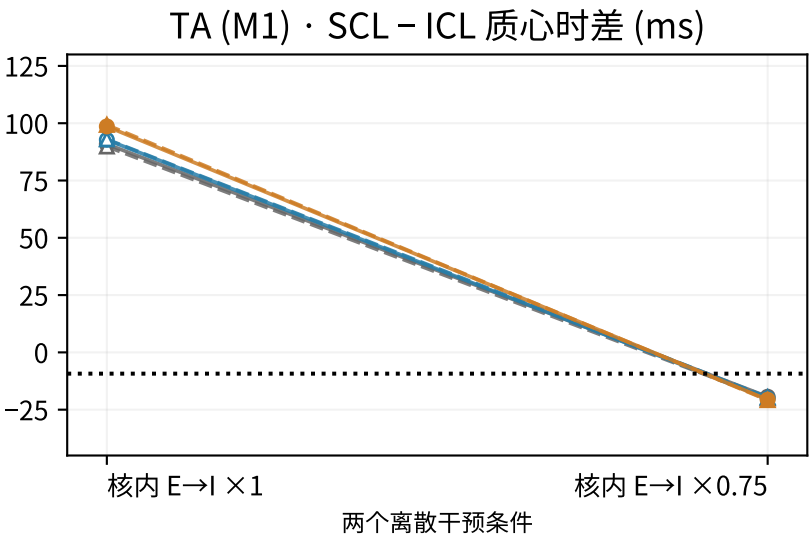
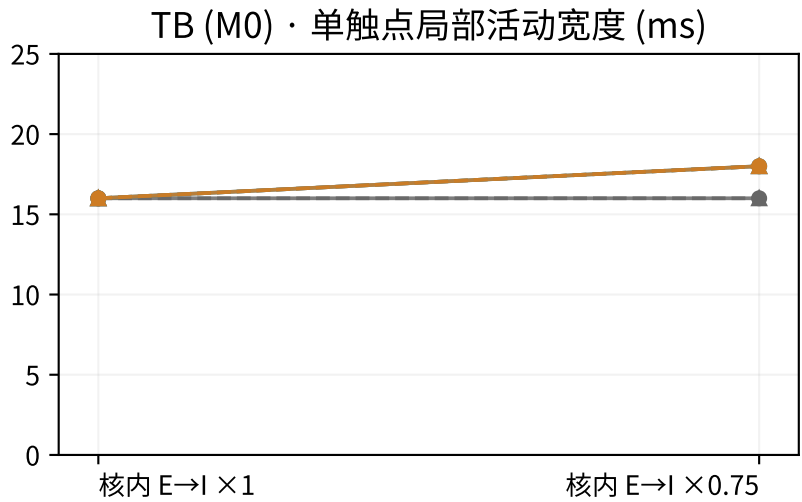
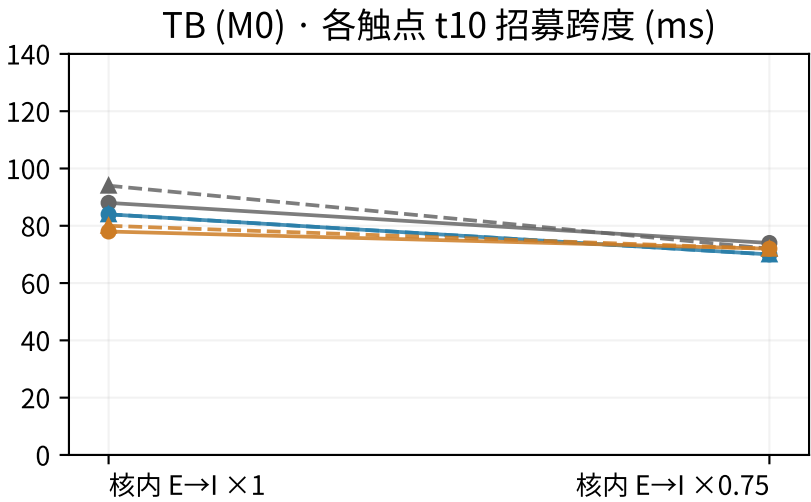


降低核内 E→I：三张网络的端点比较 | 窗内毫秒时间尺度

圆核；向外EE×1；此页只比较两个完整端点，中间细扫另页列出。

网络 2511 网络 2711 网络 2712 噪声 847401 噪声 847402 患者 FIT 参考

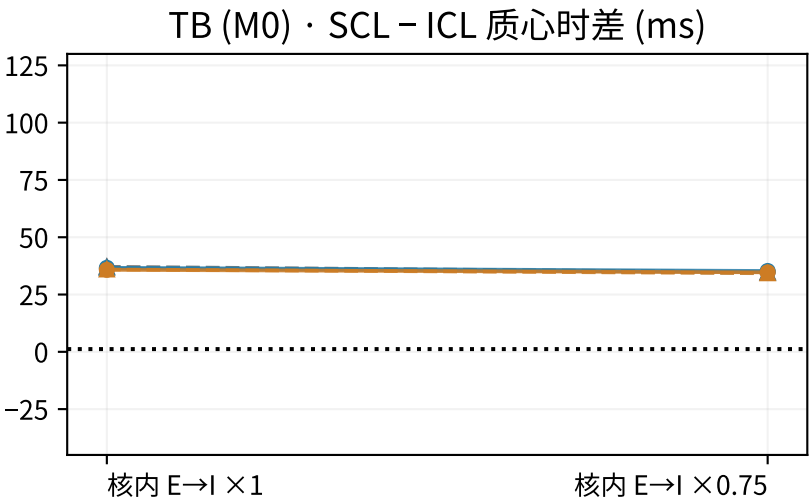

颜色=网络；实线圆点 / 虚线三角=噪声 847401 / 847402。本页已完成 12/12 个运行。
杆间差：每事件参与SCL质心中位数 - 参与ICL质心中位数，再取事件中位数；负值表示SCL较早。
t10跨度：参与触点累计包络质量10%时刻的极差；局部宽度：事件内各触点t90-t10中位数，再跨事件取中位数。后两项仅模型包络，无患者HFO等价线。

每点一条60秒运行，排除前1.5秒；线仅连接已测参数点。空心点=相关事件数<16，未删除或改loss；不是显著性检验。各页同一指标固定Y轴。