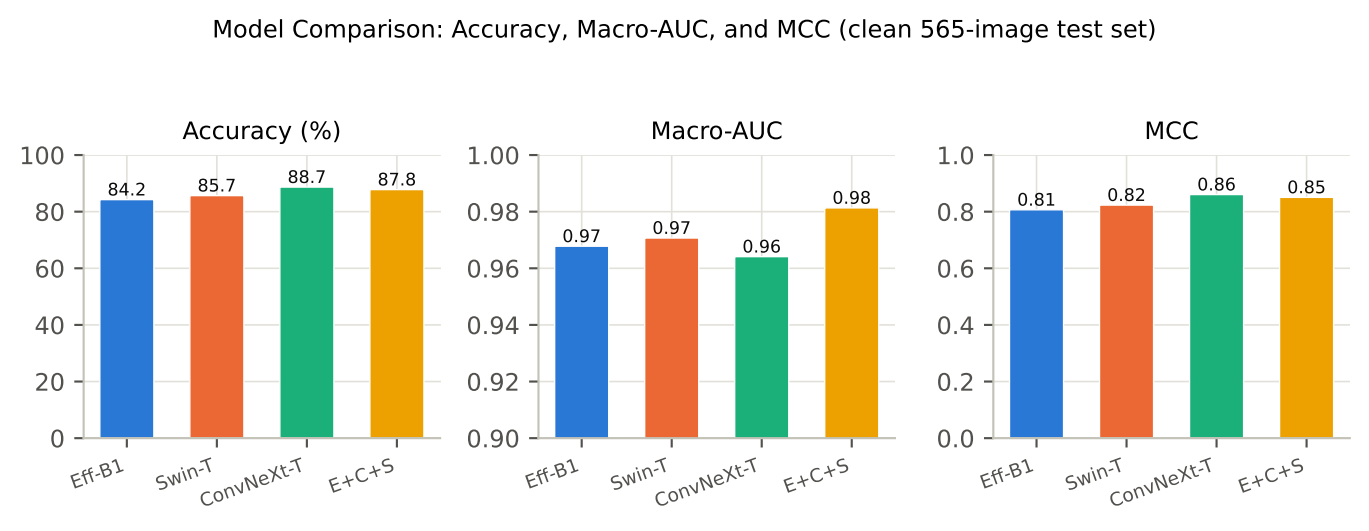
Model Comparison: Accuracy, Macro-AUC, and MCC (clean 565-image test set)
Accuracy (%)
100
80
60
40
20
0
84.2
85.7
88.7
87.8
Eff-B1
Swin-T
ConvNeXt-T
E+C+S
Macro-AUC
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.97
0.97
0.96
0.98
Eff-B1
Swin-T
ConvNeXt-T
E+C+S
MCC
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.81
0.82
0.86
0.85
Eff-B1
Swin-T
ConvNeXt-T
E+C+S