
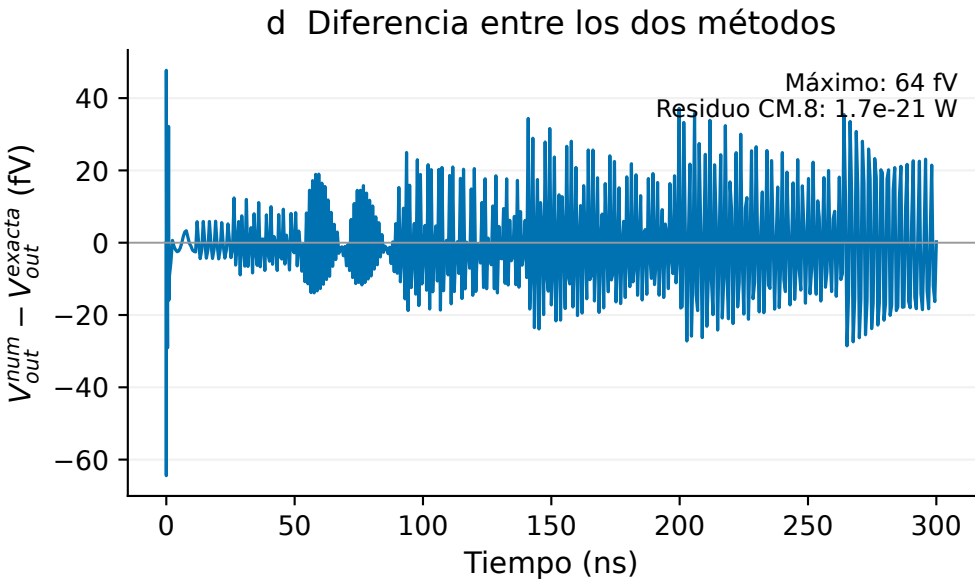
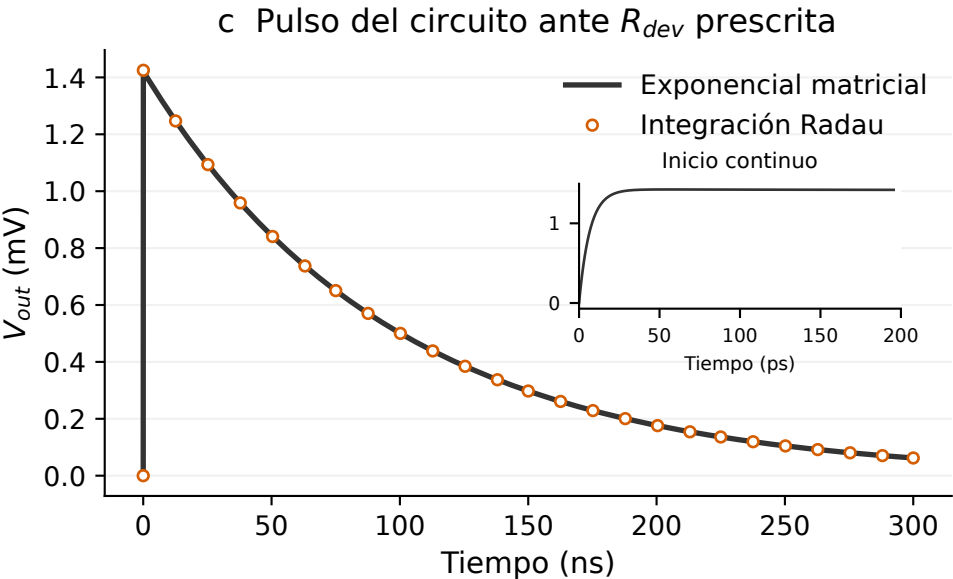
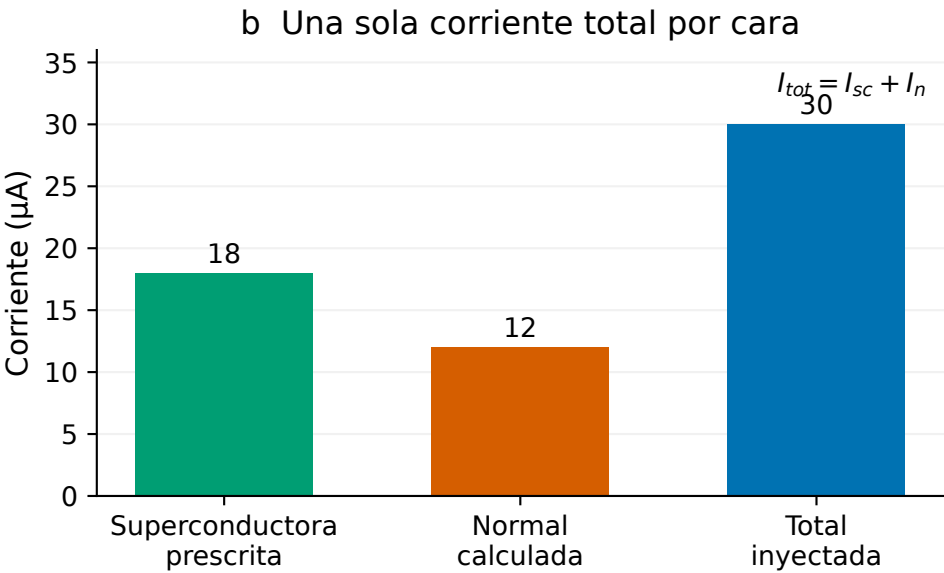


Puerto eléctrico y circuito de lectura

Pruebas analíticas y entrada resistiva prescrita · sin evolución del detector

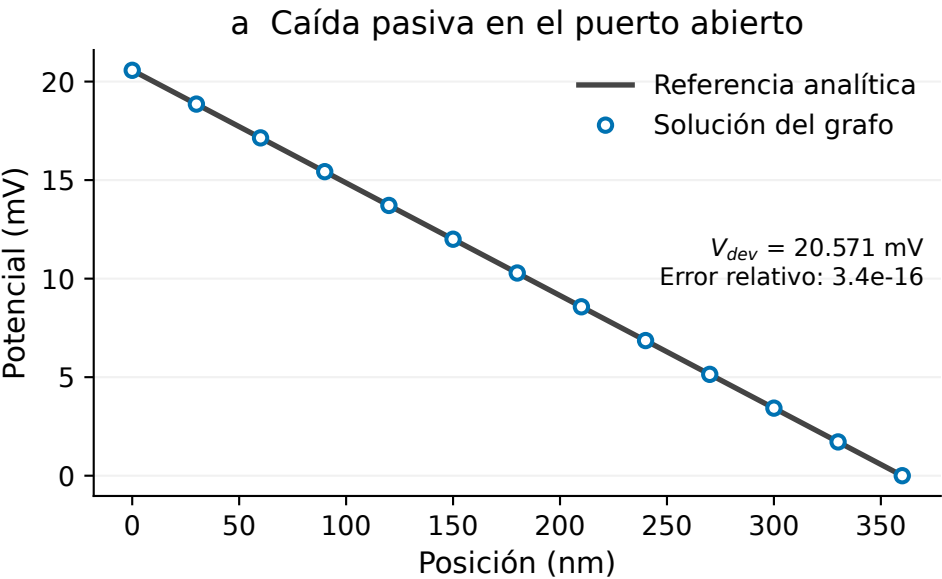

Circuito histórico: 0.300 V; 10 k Ω ; 1 μH ; 50 Ω ; 100 pF. $L_{k,ext} = 7 \text{ nH}$: entrada explícita del ensayo.

Rdev: salto de 0 a 1000 Ω impuesto. No identifica una resistencia del detector ni la partición de inductancia.