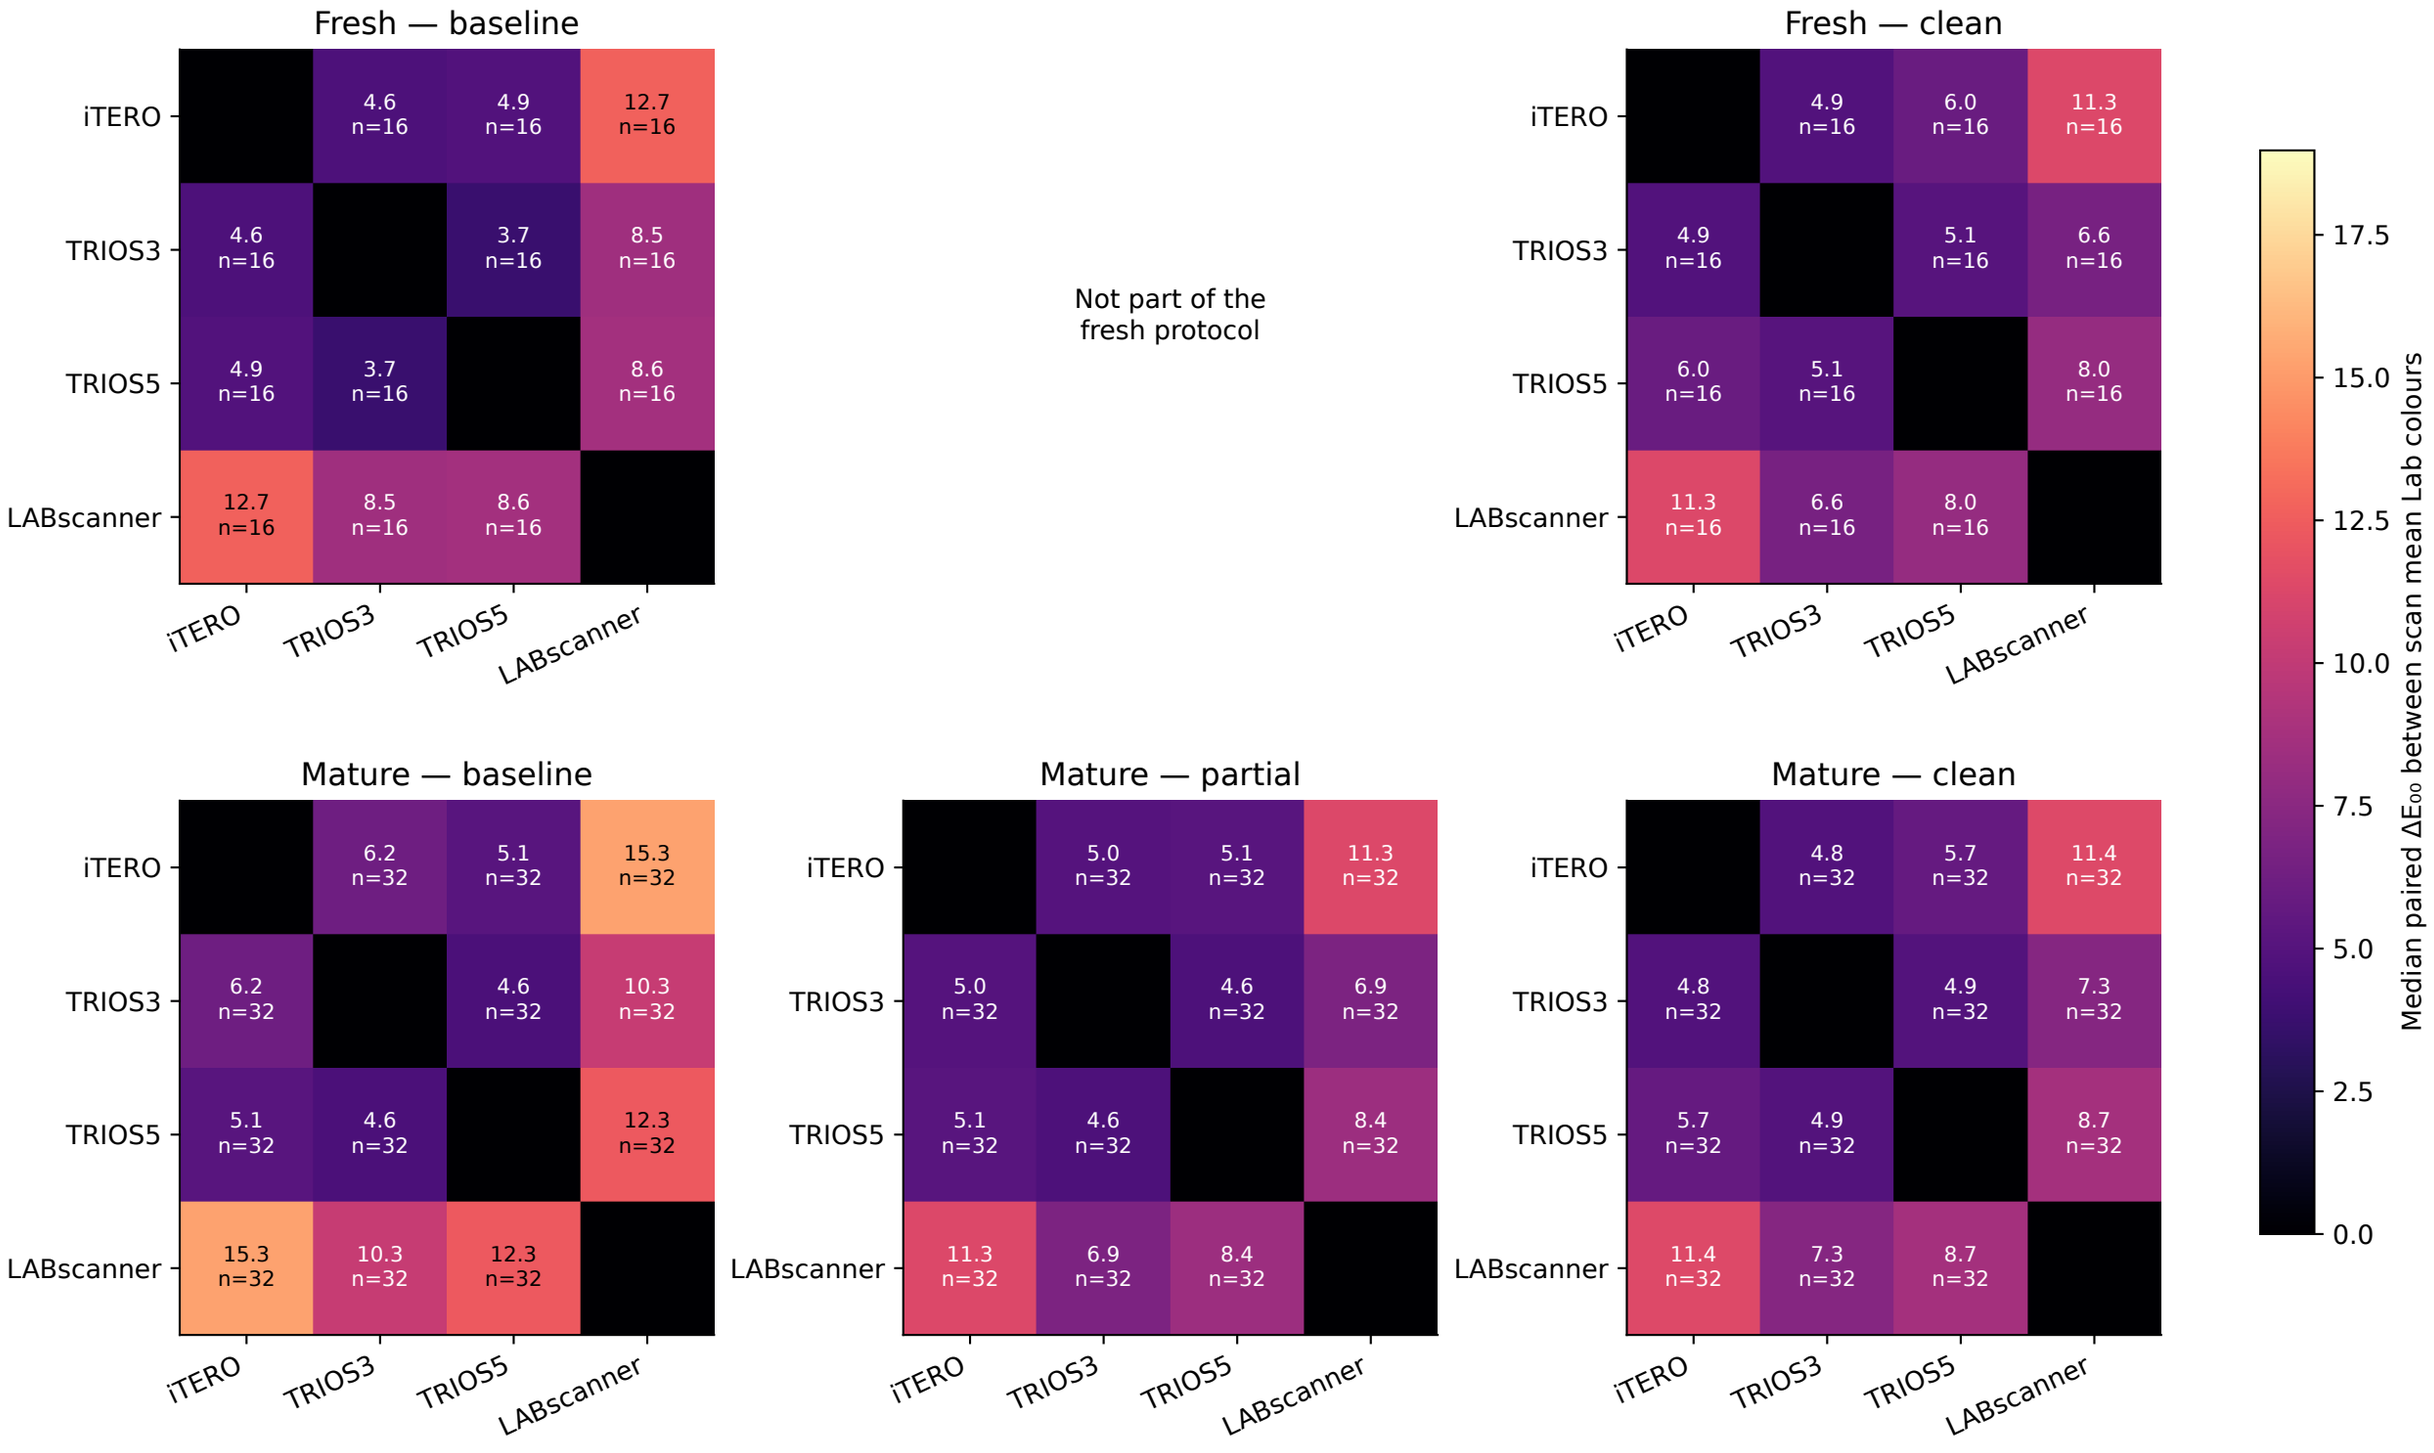
Fresh — baseline
iTERO
TRIOS3
TRIOS5
LABscanner
4.6 n=16
4.9 n=16
12.7 n=16
4.6 n=16
3.7 n=16
8.5 n=16
4.9 n=16
3.7 n=16
8.6 n=16
12.7 n=16
8.5 n=16
8.6 n=16
Not part of the fresh protocol
Fresh — clean
4.9 n=16
6.0 n=16
11.3 n=16
4.9 n=16
5.1 n=16
6.6 n=16
6.0 n=16
5.1 n=16
8.0 n=16
11.3 n=16
6.6 n=16
8.0 n=16
Mature — baseline
6.2 n=32
5.1 n=32
15.3 n=32
6.2 n=32
4.6 n=32
10.3 n=32
5.1 n=32
4.6 n=32
12.3 n=32
15.3 n=32
10.3 n=32
12.3 n=32
Mature — partial
5.0 n=32
5.1 n=32
11.3 n=32
5.0 n=32
4.6 n=32
6.9 n=32
5.1 n=32
4.6 n=32
8.4 n=32
11.3 n=32
6.9 n=32
8.4 n=32
Mature — clean
4.8 n=32
5.7 n=32
11.4 n=32
4.8 n=32
4.9 n=32
7.3 n=32
5.7 n=32
4.9 n=32
8.7 n=32
11.4 n=32
7.3 n=32
8.7 n=32
Median paired ΔE₀₀ between scan mean Lab colours
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5