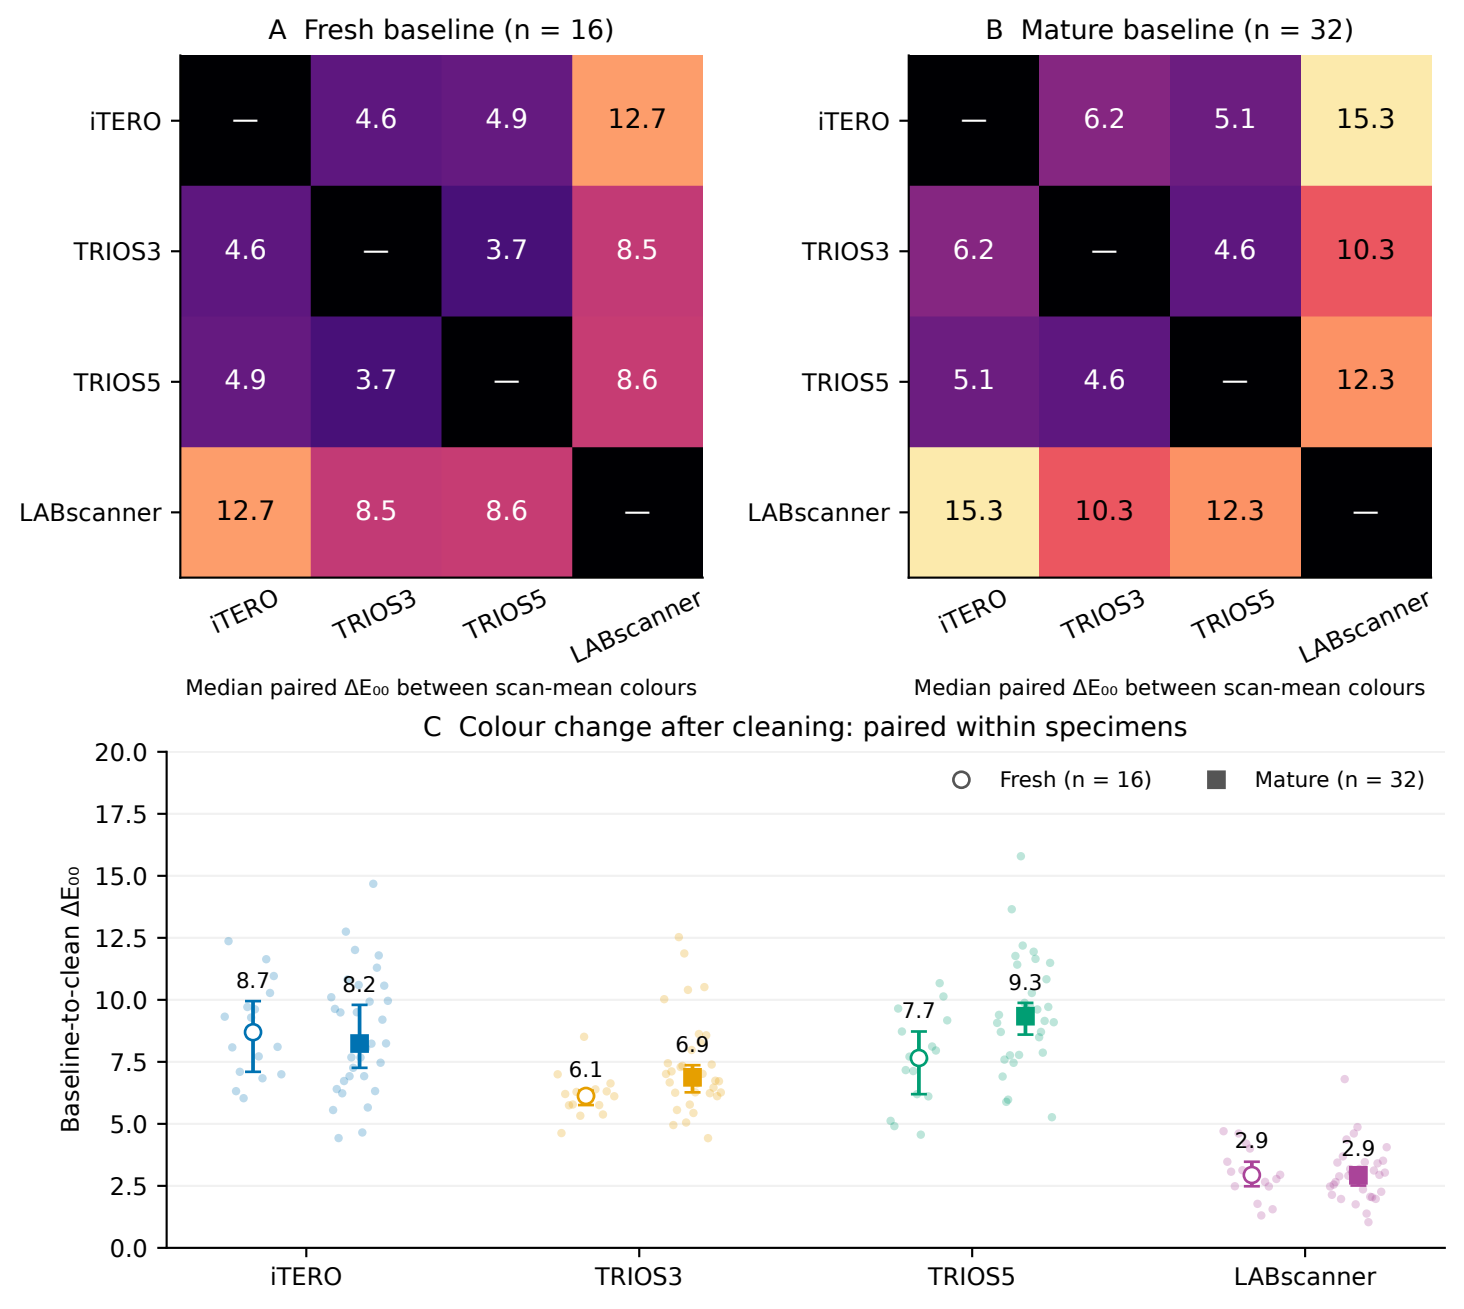
A Fresh baseline (n = 16)
iTERO
TRIOS3
TRIOS5
LABscanner
—
4.6
4.9
12.7
4.6
3.7
8.5
4.9
3.7
8.6
12.7
8.5
8.6
Median paired ΔE₀₀ between scan-mean colours
B Mature baseline (n = 32)
6.2
5.1
15.3
6.2
4.6
10.3
5.1
4.6
12.3
15.3
10.3
12.3
Median paired ΔE₀₀ between scan-mean colours
C Colour change after cleaning: paired within specimens
Fresh (n = 16)
Mature (n = 32)
Baseline-to-clean ΔE₀₀
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
8.7
8.2
6.1
6.9
7.7
9.3
2.9
2.9
iTERO
TRIOS3
TRIOS5
LABscanner