


รายละเอียดการตั้งค่า		สรุปข้อมูลการชั่งน้ำหนักยา 10 เม็ด (g.)	
T11	เครื่องตอก	ค่าน้ำหนัก Min.	3.196
PI-229	เครื่องชั่ง	ค่าน้ำหนัก Max.	3.218
AMLOVASC 10	ชื่อยา	ค่าน้ำหนัก Average	3.206
30791	Lot.	สรุปข้อมูลความหนาเม็ดยา (mm.)	
3.200	น้ำหนักตามทฤษฎี	ค่าความหนา Min.	3.81
3.110	Min	ค่าความหนาMax.	3.99
3.290	Max	ค่าความหนา Average	3.88
2.960	Min. ตามกฎหมาย		
3.440	Max. ตามกฎหมาย		
3.00%	เปอร์เซ็นต์เบี่ยงเบน		
3.70	Min.ความหนา		
4.30	Max.ความหนา		
สำลี	Username ที่ตั้งค่า		
ฉัตรพร	Admin ที่ตรวจสอบการตั้งค่า		
จบการผลิตโดย ชิตชนก วันที่ 21/06/2023, 19:02:46			

Remarks					
วันที่/เวลา	เหตุการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง	สาเหตุ	การแก้ไข	หมายเหตุ	ผู้บันทึก

ข้อกำหนด (ต้องปรับน้ำหนักและชั่งซ้ำทันที)

- 1. มี 1 จุดตกนอก97หรือ103แต่ไม่เกิน95หรือ105
- 2. มี2จุดติดต่อกันระหว่าง97.0-97.5หรือ102.5-103.0
- 3. มี5จุดติดต่อกันด้านใดด้านหนึ่งของ 100

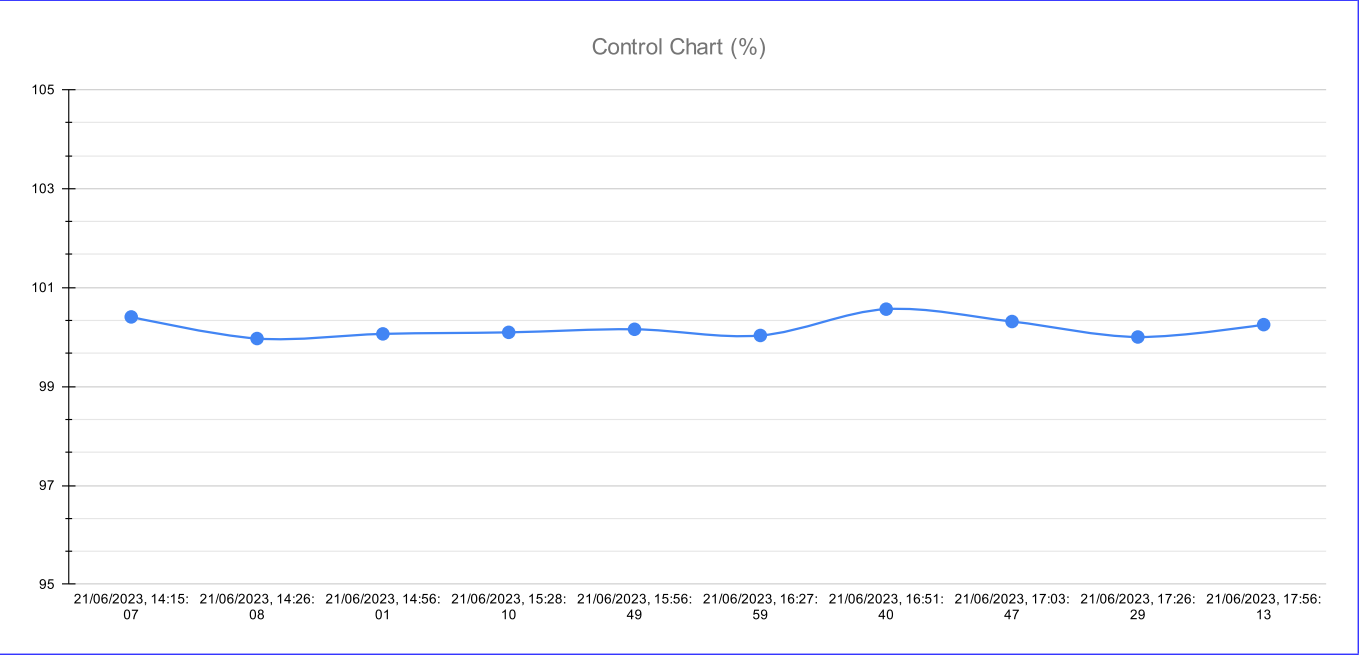

ชื่อยา	AMLOVASC 10	เครื่องชั่ง	PI-229	น้ำหนักตามตะขุ 10 เม็ด	3,200	ค่าความหนา(Thickness)	3.70 - 4.30	มิลลิเมตร(mm)
เลขที่ผลิต	30791	เครื่องตอก	T11	ชวงน้ำหนัก 10 เม็ด	3,110 - 3,290	กรัม (g)	(3.00%)	

[illegible]

