


รายละเอียดการตั้งค่า		สรุปข้อมูลการชั่งน้ำหนักยา 10 เม็ด (g.)	
T11	เครื่องตอก	ค่าน้ำหนัก Min.	0.995
PI-229	เครื่องชั่ง	ค่าน้ำหนัก Max.	1.008
TRIPSYLINE 10	ชื่อยา	ค่าน้ำหนัก Average	1.002
31438	Lot.	สรุปข้อมูลความหนาเม็ดยา (mm.)	
1.000	น้ำหนักตามทฤษฎี	ค่าความหนา Min.	3.02
0.970	Min	ค่าความหนา Max.	3.10
1.030	Max	ค่าความหนา Average	3.06
0.930	Min. ตามกฎหมาย		
1.070	Max. ตามกฎหมาย		
3.00%	เปอร์เซ็นต์เบี่ยงเบน		
2.60	Min.ความหนา		
3.20	Max.ความหนา		
ชิตชนก	Username ที่ตั้งค่า		
สิริยาภรณ์	Admin ที่ตรวจสอบการตั้งค่า		
จบการผลิตโดย ชิตชนก วันที่ 27/06/2023, 16:26:09			

Remarks					
วันที่/เวลา	เหตุการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง	สาเหตุ	การแก้ไข	หมายเหตุ	ผู้บันทึก

ข้อกำหนด (ต้องปรับน้ำหนักและชั่งซ้ำทันที)

- 1. มี 1 จุดตกนอก97หรือ103แต่ไม่เกิน95หรือ105
- 2. มี2จุดติดต่อกันระหว่าง97.0-97.5หรือ102.5-103.0
- 3. มี5จุดติดต่อกันด้านใดด้านหนึ่งของ 100

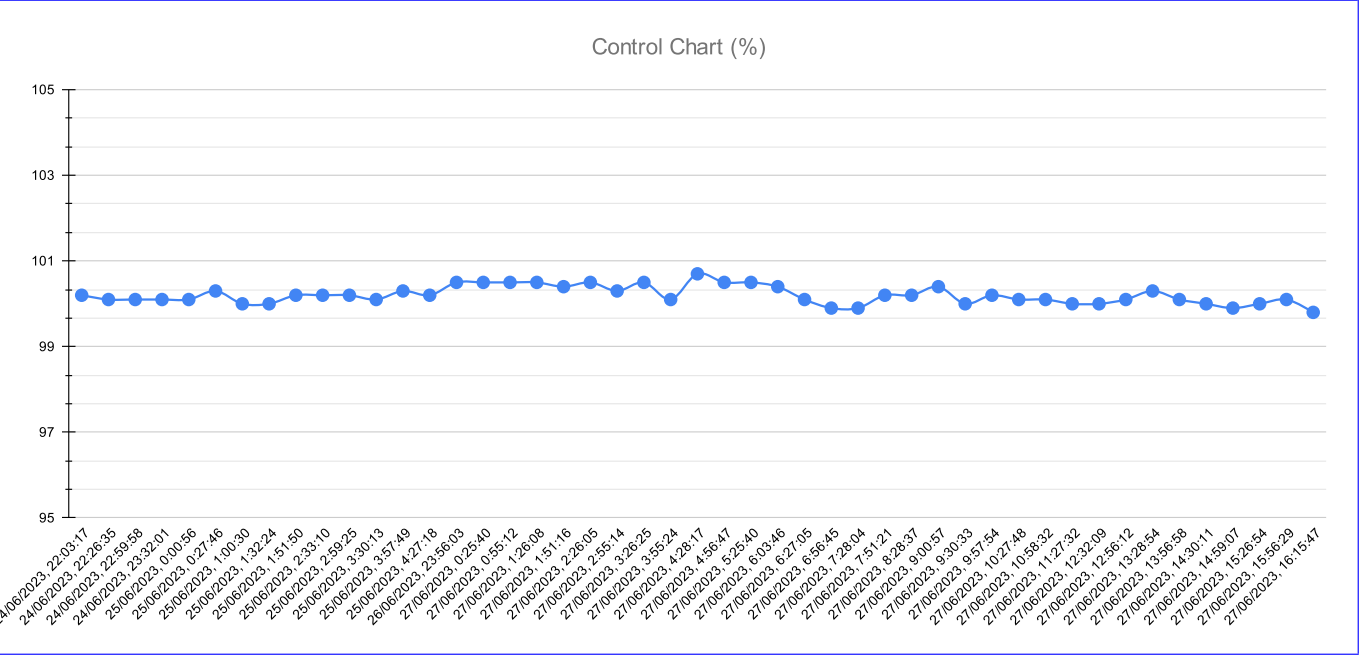

[illegible]