


รายละเอียดการตั้งค่า		สรุปข้อมูลการชั่งน้ำหนักยา 10 เม็ด (g.)	
T17	เครื่องตอก	ค่าน้ำหนัก Min.	0.997
PI-066	เครื่องชั่ง	ค่าน้ำหนัก Max.	1.016
TRAVAN 1.0	ชื่อยา	ค่าน้ำหนัก Average	1.003
30458	Lot.	สรุปข้อมูลความหนาเม็ดยา (mm.)	
1.000	น้ำหนักตามทฤษฎี	ค่าความหนา Min.	2.30
0.970	Min	ค่าความหนาMax.	2.44
1.030	Max	ค่าความหนา Average	2.37
0.920	Min. ตามกฎหมาย		
1.080	Max. ตามกฎหมาย		
3.00%	เปอร์เซ็นต์เบี่ยงเบน		
2.00	Min.ความหนา		
2.80	Max.ความหนา		
สำลี	Username ที่ตั้งค่า		
ฉัตรพร	Admin ที่ตรวจสอบการตั้งค่า		
จบการผลิตโดย สำลี วันที่ 17/06/2023, 05:49:35			

Remarks					
วันที่/เวลา	เหตุการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง	สาเหตุ	การแก้ไข	หมายเหตุ	ผู้บันทึก

ข้อกำหนด (ต้องปรับน้ำหนักและชั่งซ้ำทันที)

- 1. มี 1 จุดตกนอก97หรือ103แต่ไม่เกิน95หรือ105
- 2. มี2จุดติดต่อกันระหว่าง97.0-97.5หรือ102.5-103.0
- 3. มี5จุดติดต่อกันด้านใดด้านหนึ่งของ 100

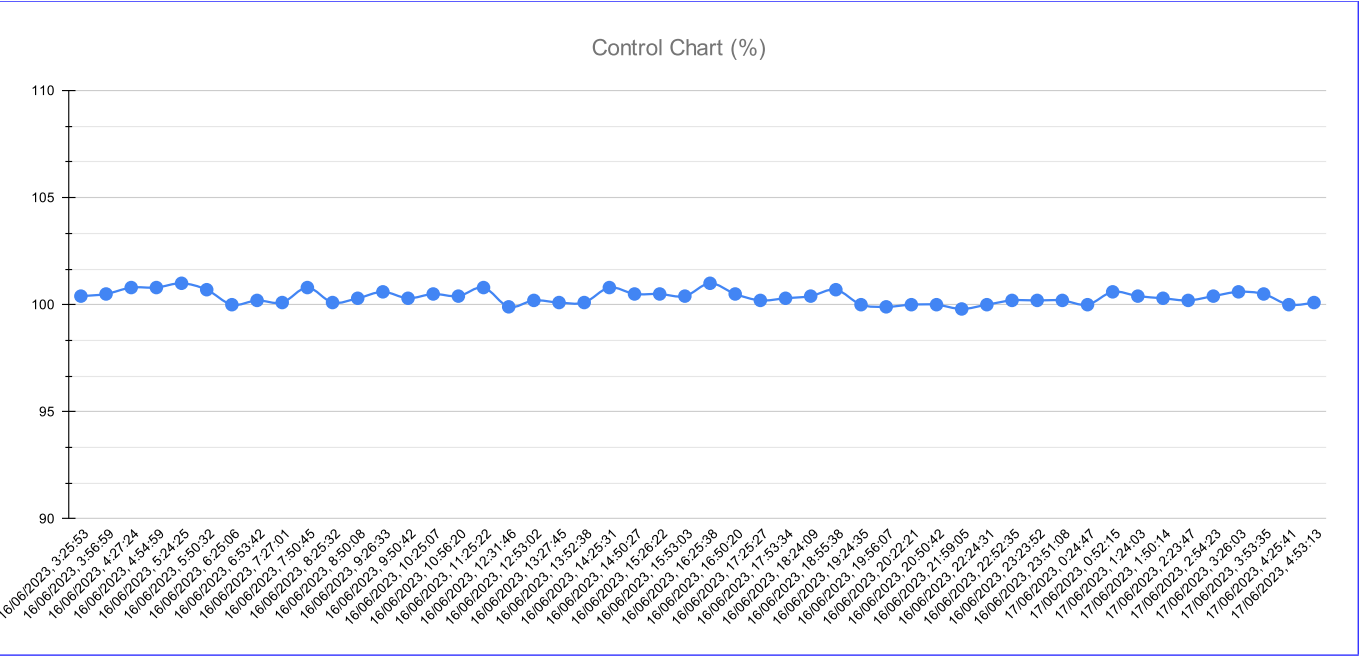





[illegible]