


รายละเอียดการตั้งค่า		สรุปข้อมูลการชั่งน้ำหนักยา 10 เม็ด (g.)	
T11	เครื่องตอก	ค่าน้ำหนัก Min.	5.188
PI-229	เครื่องชั่ง	ค่าน้ำหนัก Max.	5.252
potrim	ชื่อยา	ค่าน้ำหนัก Average	5.216
30652	Lot.	สรุปข้อมูลความหนาเม็ดยา (mm.)	
5.210	น้ำหนักตามทฤษฎี	ค่าความหนา Min.	5.08
5.110	Min	ค่าความหนาMax.	5.16
5.310	Max	ค่าความหนา Average	5.11
4.900	Min. ตามกฎหมาย		
5.400	Max. ตามกฎหมาย		
2.00%	เปอร์เซ็นต์เบี่ยงเบน		
4.80	Min.ความหนา		
5.20	Max.ความหนา		
สำลี	Username ที่ตั้งค่า		
xxxxx	Admin ที่ตรวจสอบการตั้งค่า		
กด ENDJOB โดย สำลี วันที่ 02/06/2023, 04:04:47			

Remarks					
วันที่/เวลา	เหตุการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง	สาเหตุ	การแก้ไข	หมายเหตุ	ผู้บันทึก

ข้อกำหนด (ต้องปรับน้ำหนักและชั่งซ้ำทันที)

- 1. มี 1 จุดตกนอก97หรือ103แต่ไม่เกิน95หรือ105
- 2. มี2จุดติดต่อกันระหว่าง97.0-97.5หรือ102.5-103.0
- 3. มี5จุดติดต่อกันด้านใดด้านหนึ่งของ 100

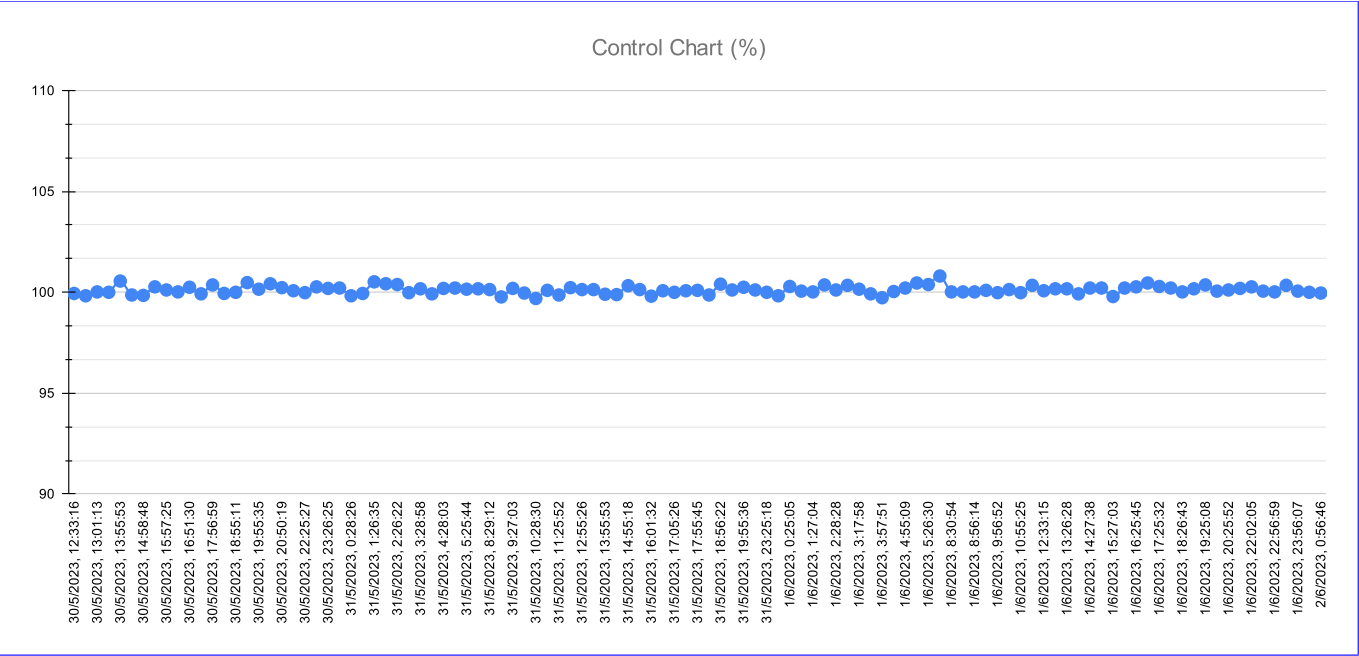

[illegible]



[illegible]