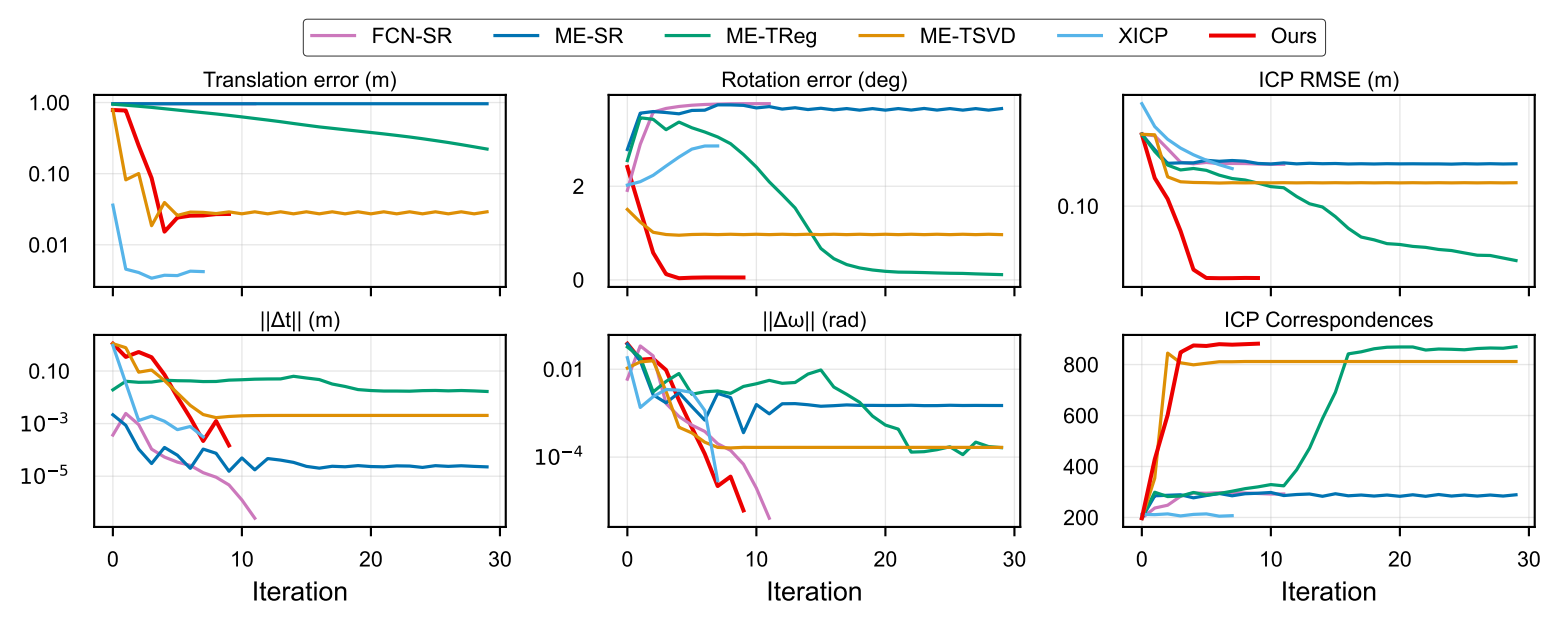
FCN-SR
ME-SR
ME-TReg
ME-TSVD
XICP
Ours
Translation error (m)
1.00
0.10
0.01
Rotation error (deg)
2
0
ICP RMSE (m)
0.10
||Δt|| (m)
0.10
10^{-3}
10^{-5}
||Δω|| (rad)
0.01
10^{-4}
ICP Correspondences
800
600
400
200
0
10
20
30
Iteration