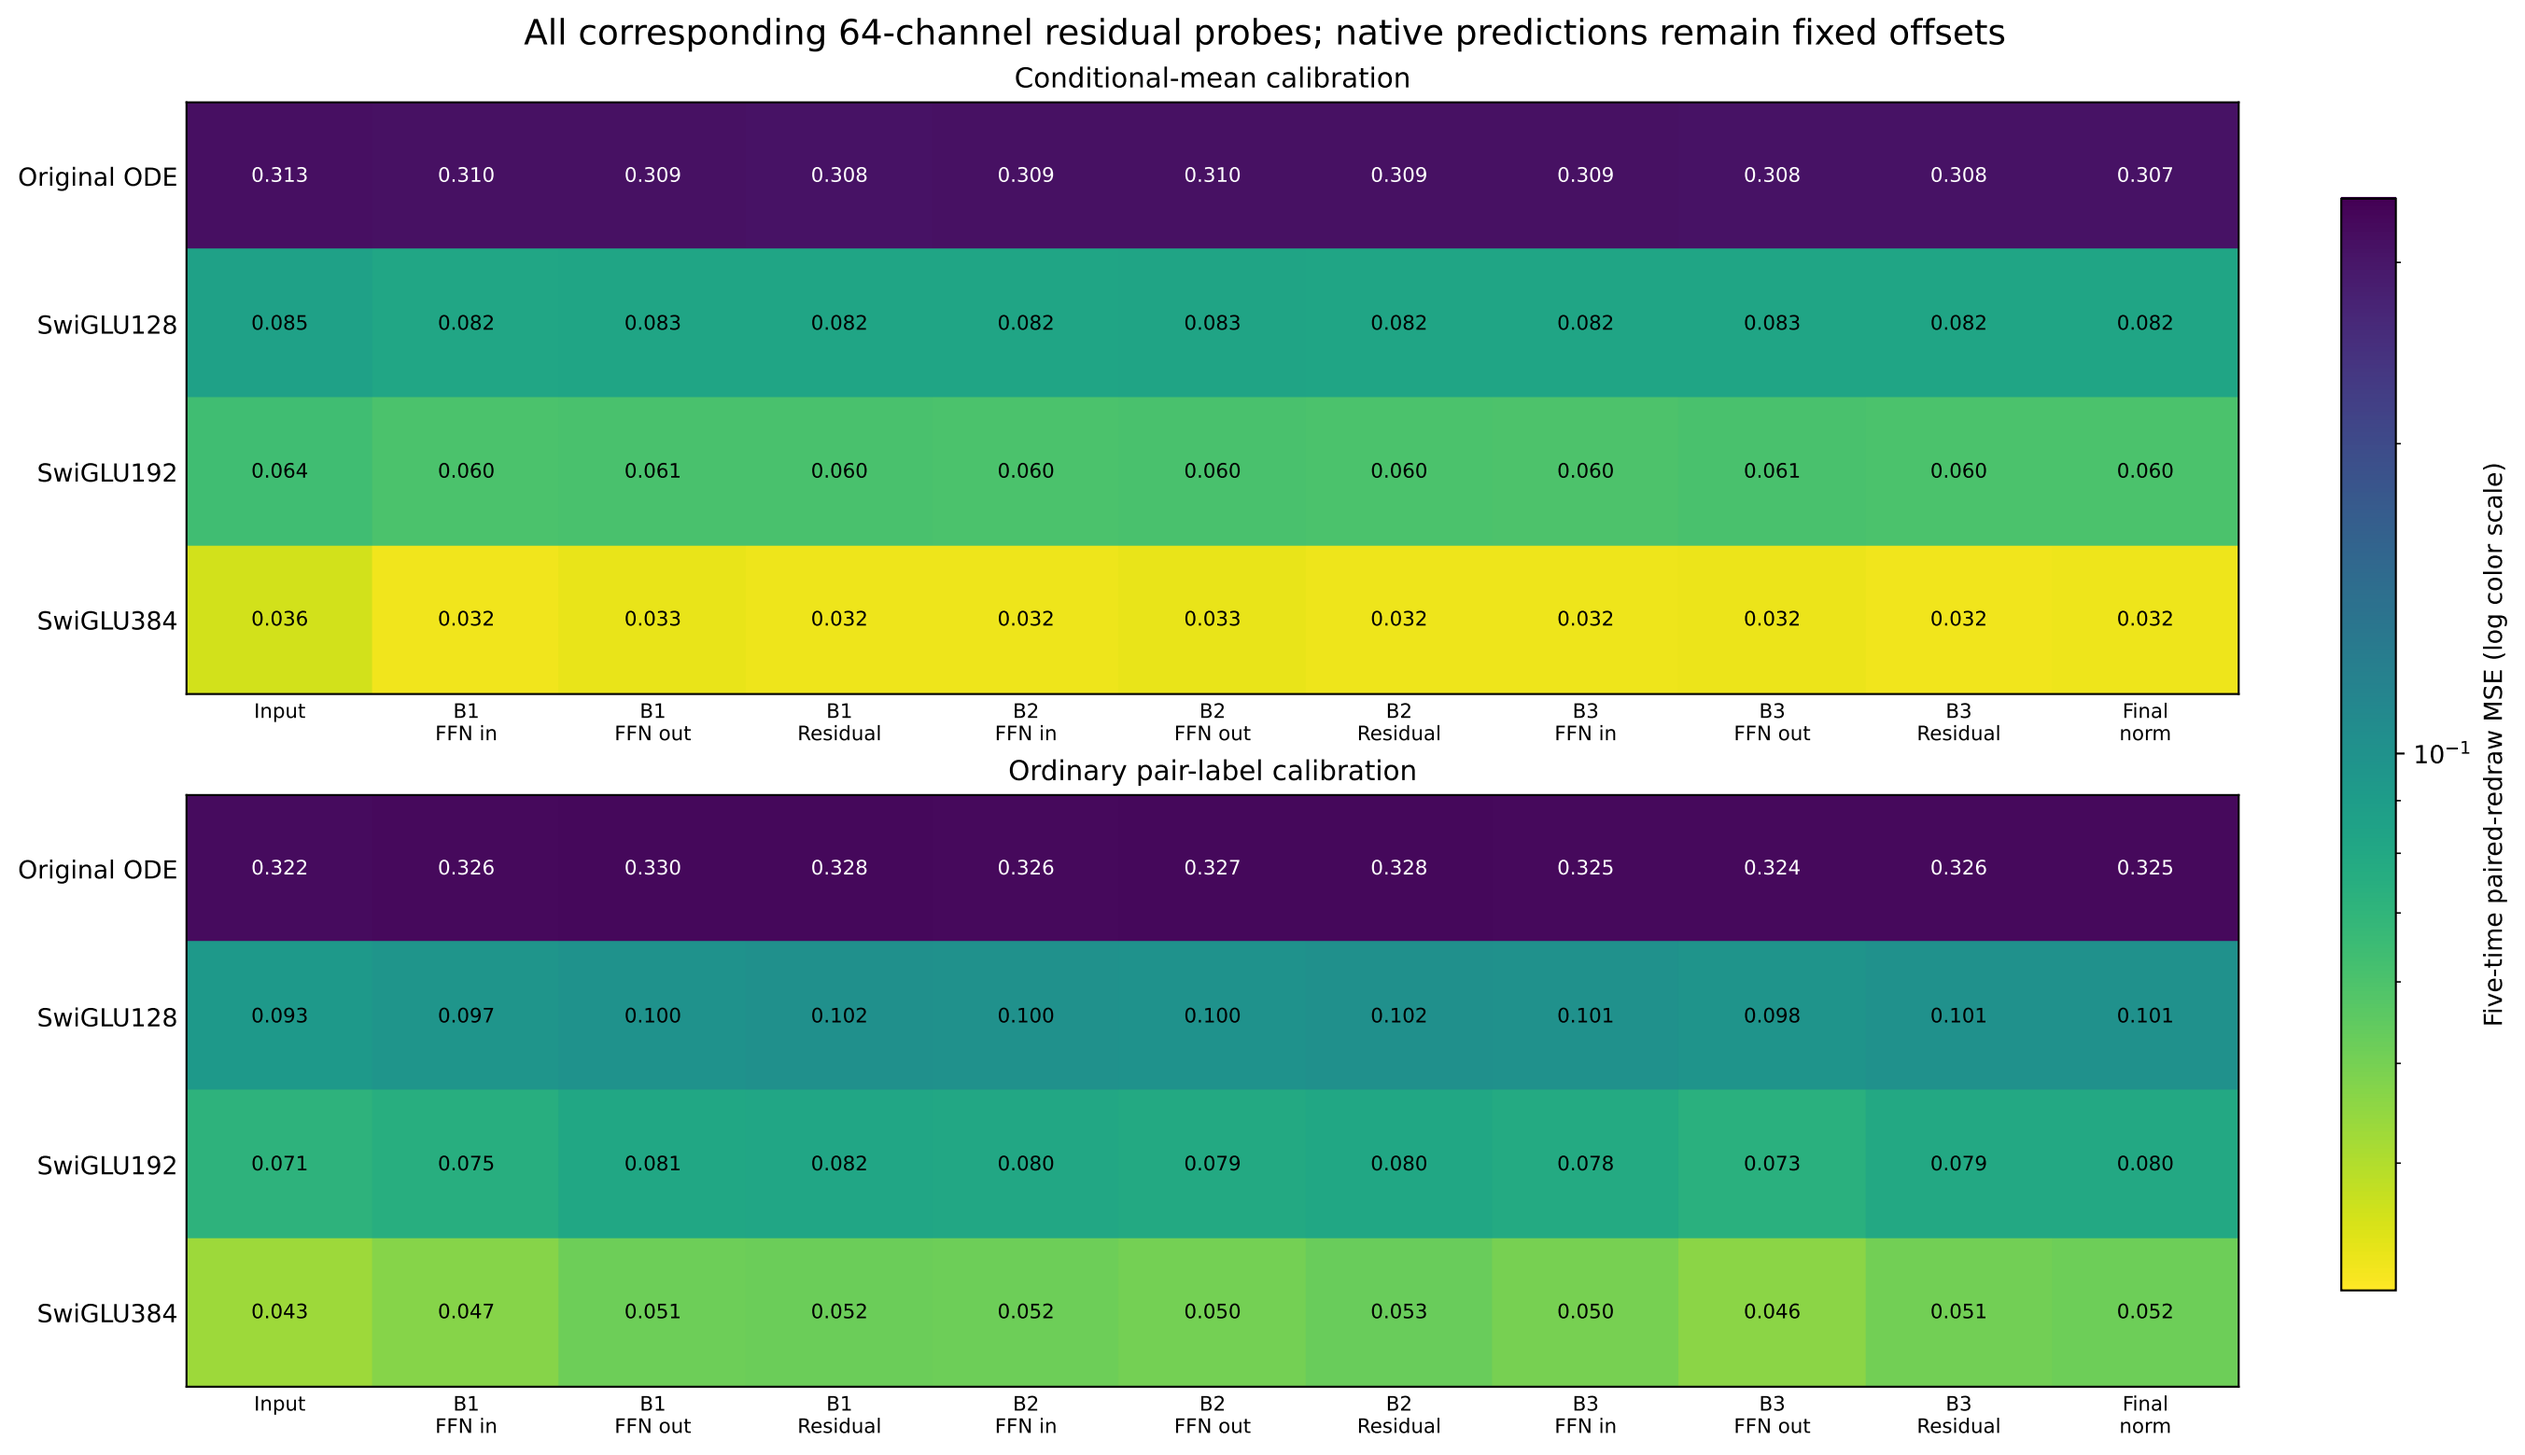
All corresponding 64-channel residual probes; native predictions remain fixed offsets
Conditional-mean calibration
Original ODE
SwiGLU128
SwiGLU192
SwiGLU384
0.313 0.310 0.309 0.308 0.309 0.310 0.309 0.309 0.308 0.308 0.307
0.085 0.082 0.083 0.082 0.082 0.083 0.082 0.082 0.083 0.082 0.082
0.064 0.060 0.061 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.061 0.060 0.060
0.036 0.032 0.033 0.032 0.032 0.033 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032
Input
B1 FFN in
B1 FFN out
B1 Residual
B2 FFN in
B2 FFN out
B2 Residual
B3 FFN in
B3 FFN out
B3 Residual
Final norm
Ordinary pair-label calibration
Original ODE
SwiGLU128
SwiGLU192
SwiGLU384
0.322 0.326 0.330 0.328 0.326 0.327 0.328 0.325 0.324 0.326 0.325
0.093 0.097 0.100 0.102 0.100 0.100 0.102 0.101 0.098 0.101 0.101
0.071 0.075 0.081 0.082 0.080 0.079 0.080 0.078 0.073 0.079 0.080
0.043 0.047 0.051 0.052 0.052 0.050 0.053 0.050 0.046 0.051 0.052
Input
B1 FFN in
B1 FFN out
B1 Residual
B2 FFN in
B2 FFN out
B2 Residual
B3 FFN in
B3 FFN out
B3 Residual
Final norm
10^{-1}
Five-time paired-redraw MSE (log color scale)