


Calibration report

Bio-Rad DATE: 12/18/2019
D-10 TIME: 10:44 AM
S/N: #DA2L121109 Software version: 4.30-2
Calibrator ID: AA90195
Injection date 12/13/2019 12:50 PM
Injection #: 3 Method: HbA2/F
Rack #: B1 Rack position: 2

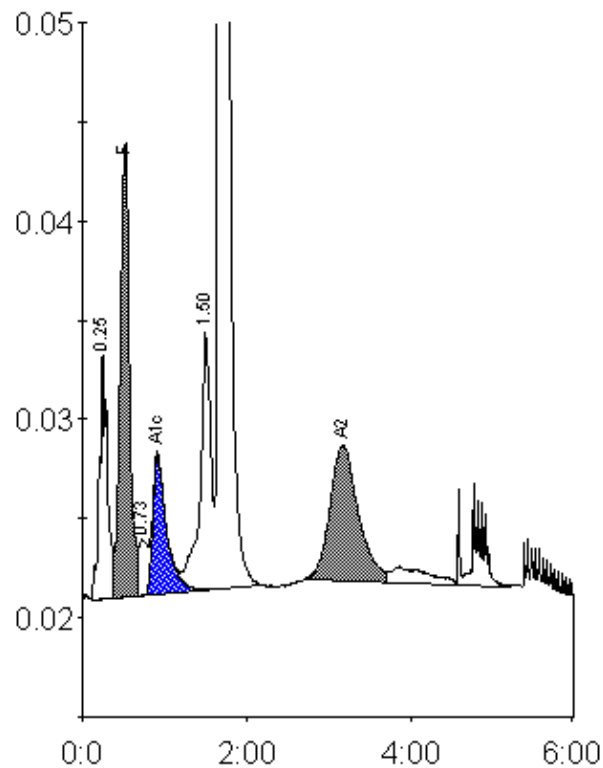

Peak table - ID: CAL2

Peak	R.time	Height	Area	Area %
A1a	0.25	12524	83552	3.3
F	0.52	22639	167539	7.1
LA1c/CHb-1	0.73	2801	19712	0.8
A1c	0.91	6981	81889	5.4
P3	1.50	12949	119384	4.7
A0	1.68	376836	1889836	74.8
A2	3.17	6811	163418	6.9
Total Area:		2525329		

Concentration:	%
F	7.1
A1c	5.4
A2	6.9

Calibration Passed

Analyte	Old Slope	Old Intercept	New Slope	New Intercept
F	0.00	0.00	1.12	-0.30
A1c	0.00	0.00	1.07	1.41
A2	0.00	0.00	1.06	0.03