




SIGA-MAS

SISTEMA INTELIGENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA-MAS METROLOGÍA

Modulo de Servicios

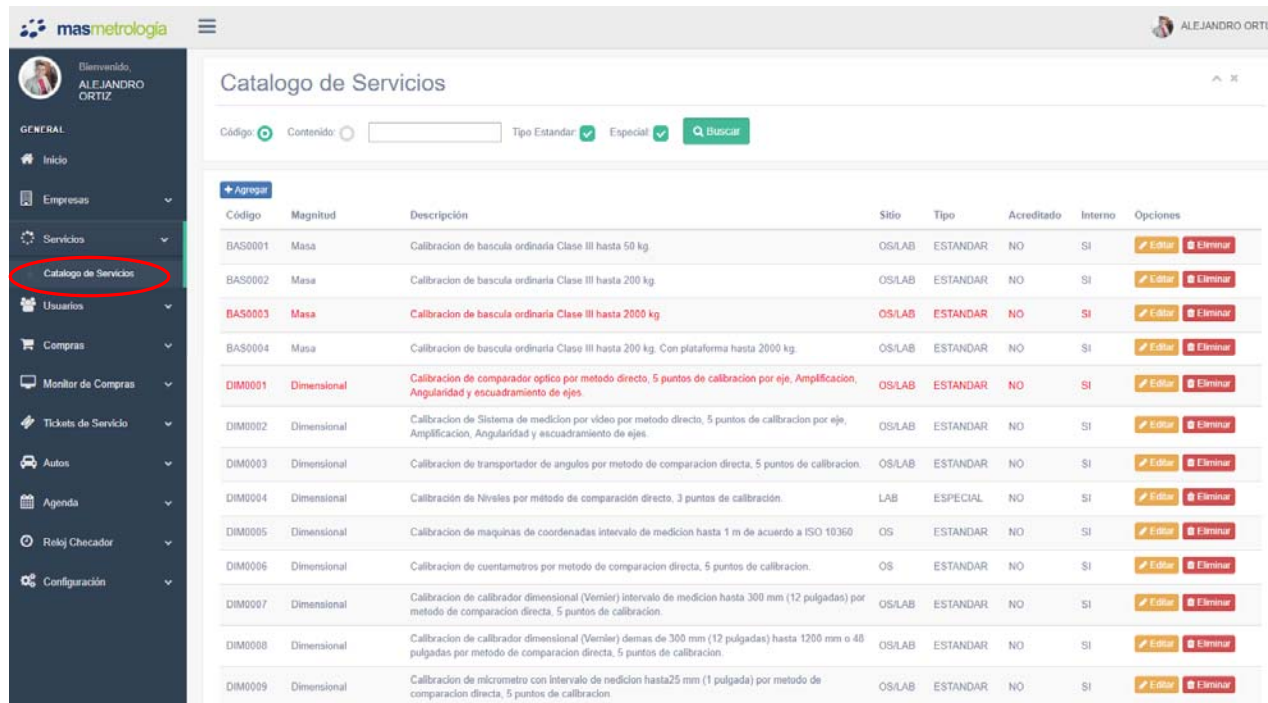


Código	Magnitud	Descripción	Sitio	Tipo	Acreditado	Interno	Opciones
BAS0001	Masa	Calibración de báscula ordinaria Clase III hasta 50 kg.	OS/LAB	ESTANDAR	NO	SI	Editar Eliminar
BAS0002	Masa	Calibración de báscula ordinaria Clase III hasta 200 kg.	OS/LAB	ESTANDAR	NO	SI	Editar Eliminar
BAS0003	Masa	Calibración de báscula ordinaria Clase III hasta 2000 kg.	OS/LAB	ESTANDAR	NO	SI	Editar Eliminar
BAS0004	Masa	Calibración de báscula ordinaria Clase III hasta 200 kg. Con plataforma hasta 2000 kg.	OS/LAB	ESTANDAR	NO	SI	Editar Eliminar
DIM0001	Dimensional	Calibración de comparador óptico por método directo, 5 puntos de calibración por eje, Amplificación, Angularidad y escuadramiento de ejes.	OS/LAB	ESTANDAR	NO	SI	Editar Eliminar
DIM0002	Dimensional	Calibración de Sistema de medición por video por método directo, 5 puntos de calibración por eje, Amplificación, Angularidad y escuadramiento de ejes.	OS/LAB	ESTANDAR	NO	SI	Editar Eliminar
DIM0003	Dimensional	Calibración de transportador de ángulos por método de comparación directa, 5 puntos de calibración.	OS/LAB	ESTANDAR	NO	SI	Editar Eliminar
DIM0004	Dimensional	Calibración de Niveles por método de comparación directa, 3 puntos de calibración.	LAB	ESPECIAL	NO	SI	Editar Eliminar
DIM0005	Dimensional	Calibración de máquinas de coordenadas intervalo de medición hasta 1 m de acuerdo a ISO 10360	OS	ESTANDAR	NO	SI	Editar Eliminar
DIM0006	Dimensional	Calibración de cuentametros por método de comparación directa, 5 puntos de calibración.	OS	ESTANDAR	NO	SI	Editar Eliminar
DIM0007	Dimensional	Calibración de calibrador dimensional (Vernier) intervalo de medición hasta 300 mm (12 pulgadas) por método de comparación directa, 5 puntos de calibración.	OS/LAB	ESTANDAR	NO	SI	Editar Eliminar
DIM0008	Dimensional	Calibración de calibrador dimensional (Vernier) demás de 300 mm (12 pulgadas) hasta 1200 mm o 48 pulgadas por método de comparación directa, 5 puntos de calibración.	OS/LAB	ESTANDAR	NO	SI	Editar Eliminar
DIM0009	Dimensional	Calibración de micrometro con intervalo de medición hasta 25 mm (1 pulgada) por método de comparación directa, 5 puntos de calibración.	OS/LAB	ESTANDAR	NO	SI	Editar Eliminar

El catalogo de servicios muestran los servicios activos y no activos dentro de la empresa.

Asignando el privilegio 'Administrar Servicios' estos podrán ser editados o removidos. Los servicios mostrados en color rojo están temporalmente *Inactivos*

Modulo de Servicios

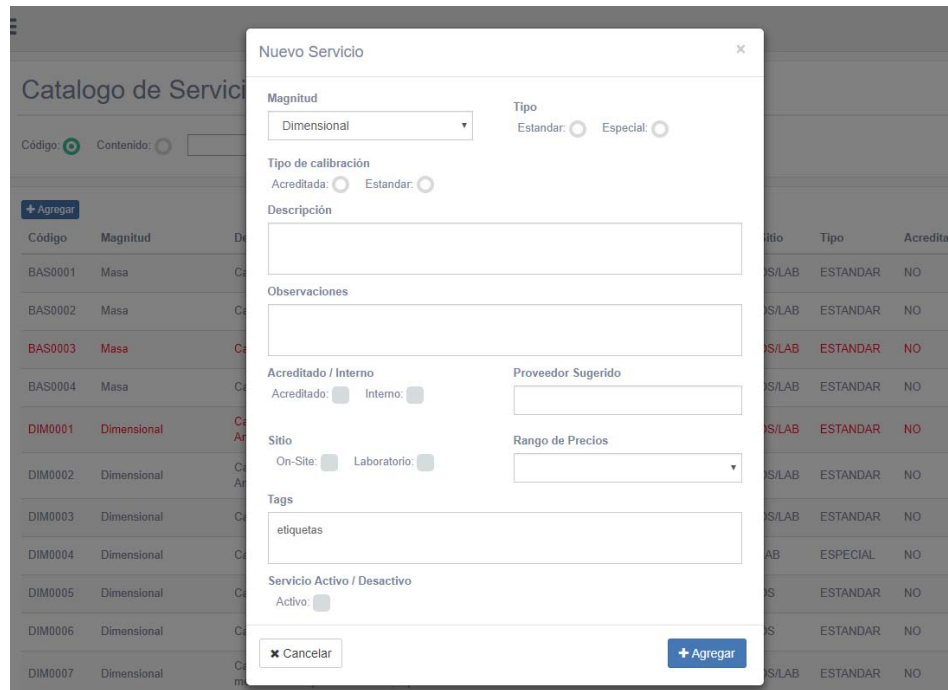

Nuevo Servicio

Magnitud: Dimensional

Tipo: Estandar ☐ Especial ☐

Tipo de calibración: Acreditada ☐ Estandar ☐

Descripción:

Observaciones:

Acreditado / Interno: Acreditado ☐ Interno ☐

Proveedor Sugerido:

Sitio: On-Site ☐ Laboratorio ☐

Rango de Precios:

Tags: etiquetas

Servicio Activo / Desactivo: Activo ☐

Cancelar Agregar

Para dar de alta es necesario hacer click en el botón '+ Agregar' en la parte superior del catalogo, el cual desplegará la pantalla mostrada, llene todos los campos necesarios y posteriormente presione '+ Agregar' en la parte inferior de la pantalla desplegable

Para la edición y eliminación de servicios hacer click en los botones ‘Editar’ y ‘Eliminar’ respectivamente y confirme la acción. Estas funciones estarán activas únicamente si se tiene asignado el privilegio ‘Administrar Servicios’