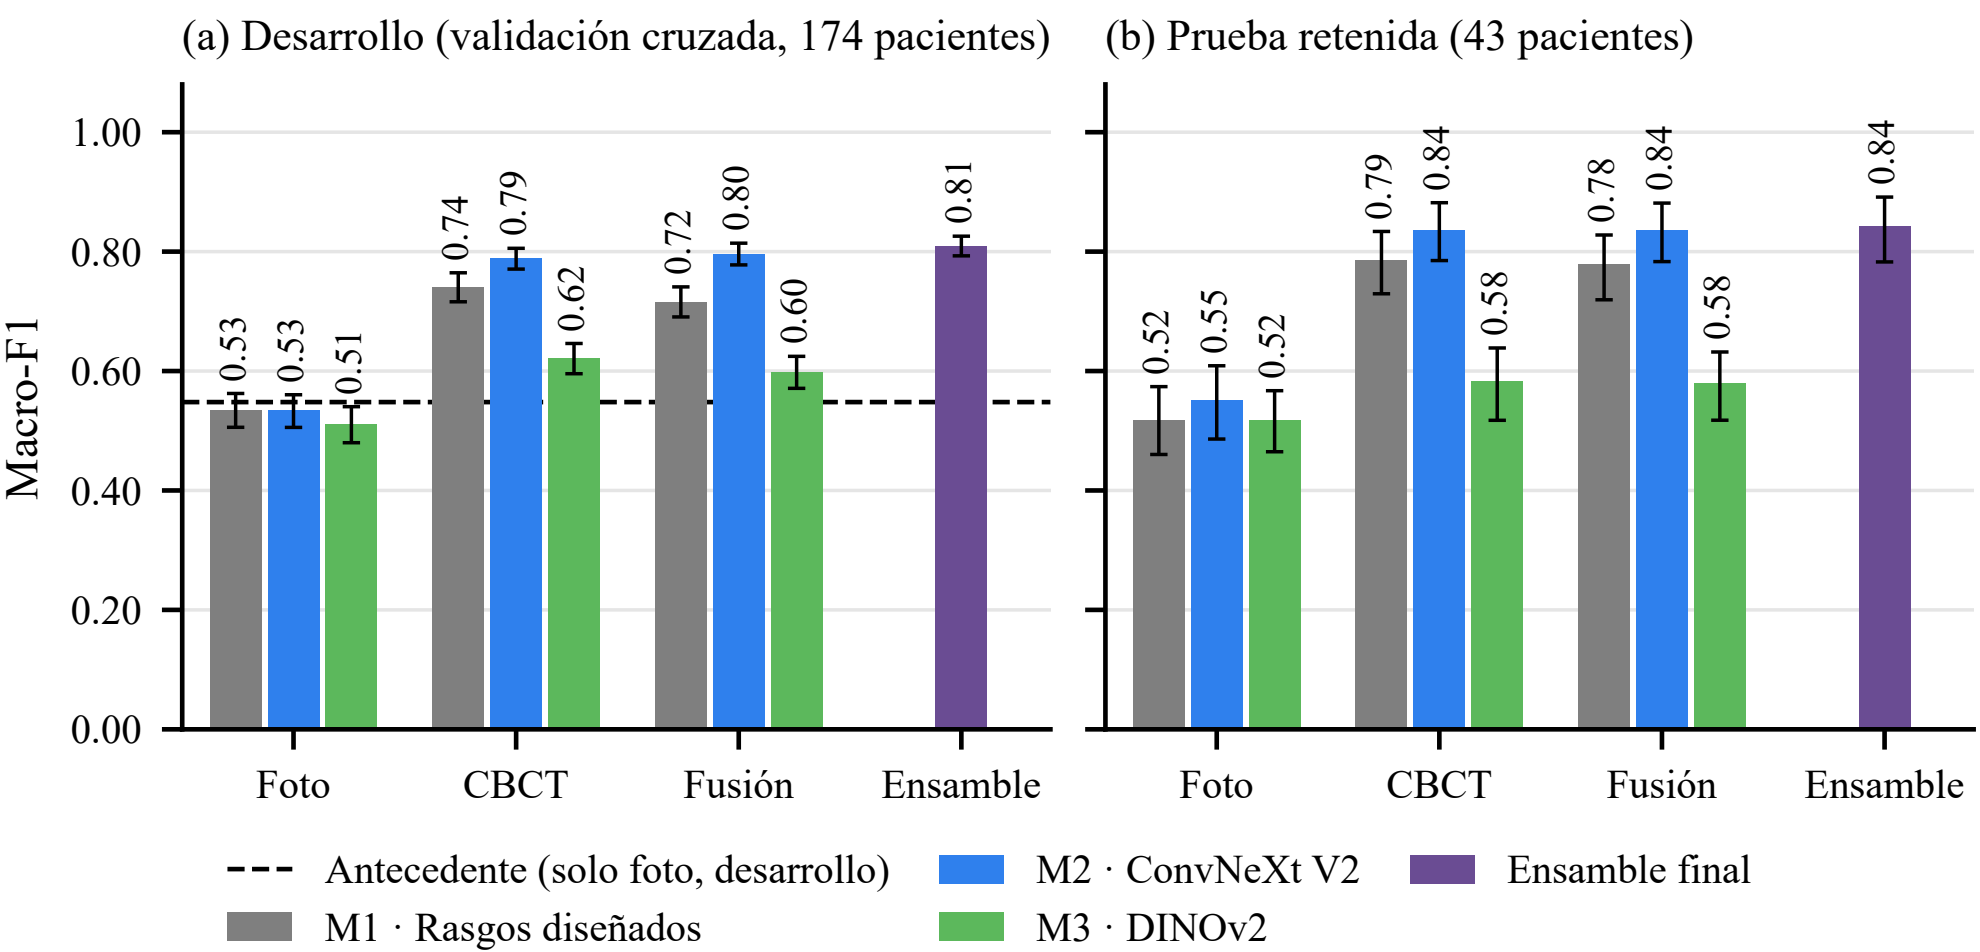
(a) Desarrollo (validación cruzada, 174 pacientes)
(b) Prueba retenida (43 pacientes)
Macro-F1
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
0.53
0.53
0.51
0.74
0.79
0.62
0.72
0.80
0.60
0.81
0.52
0.55
0.52
0.79
0.84
0.58
0.78
0.84
0.58
0.84
Foto
CBCT
Fusión
Ensamble
Antecedente (solo foto, desarrollo)
M1 · Rasgos diseñados
M2 · ConvNeXt V2
M3 · DINOv2
Ensamble final