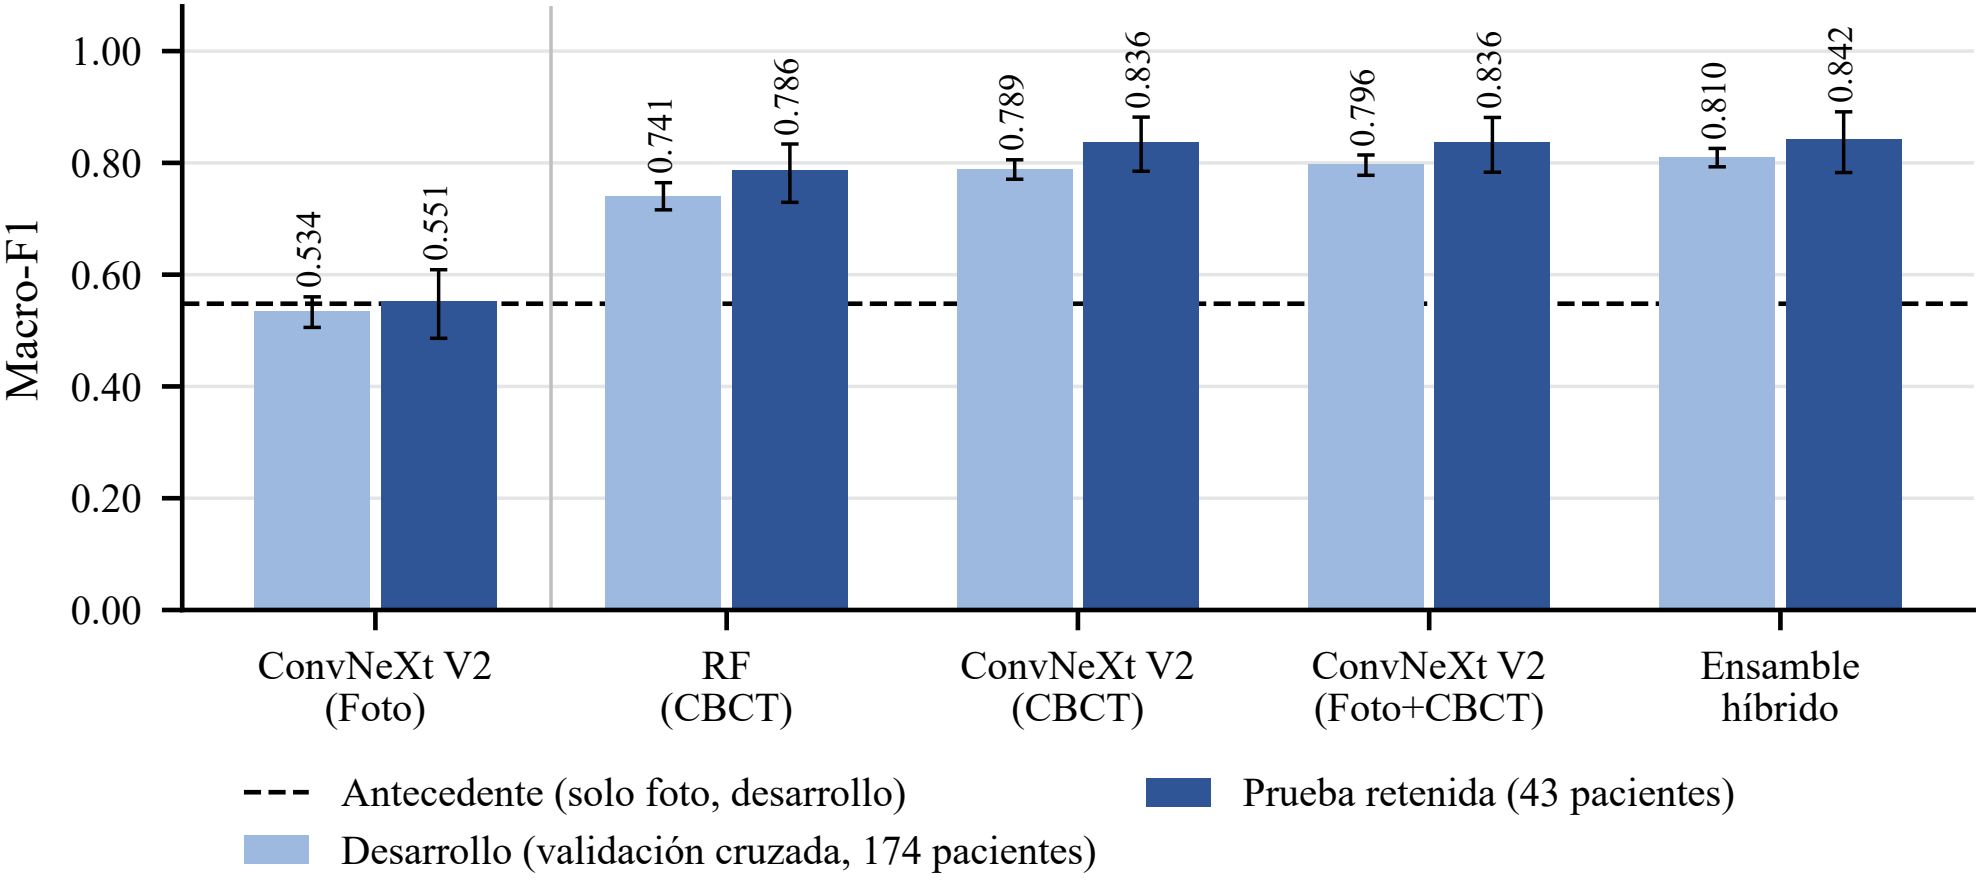
Macro-F1
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
0.534
0.551
0.741
0.786
0.789
0.836
0.796
0.836
0.810
0.842
ConvNeXt V2 (Foto)
RF (CBCT)
ConvNeXt V2 (CBCT)
ConvNeXt V2 (Foto+CBCT)
Ensamble híbrido
Antecedente (solo foto, desarrollo)
Prueba retenida (43 pacientes)
Desarrollo (validación cruzada, 174 pacientes)