

QA File Parameter

Patient Name : TEST ONLY, T8
Patient ID : ZZ203
Plan Date : 25/11/2019
SSD :
SDD :
Depth :
Energy : 0
Angle :

Absolute Dose Comparison

Difference (%) : 3.0
Distance (mm) : 3.0
Threshold (%) : 10.0
Meas Uncertainty : Yes
Use Global % : Yes

Summary (Gamma Analysis)

Total Points : 248
Passed : 246
Failed : 2
% Passed : 99.2
*DTA/Gamma is using 2D Mode


Dose Values in cGy

	CAX	Norm	Sel	Max
ArcCHECK		188.91	37.83	188.91
Plan	43.43	185.64	44.83	204.27
ArcCHECK		3.27	-7.00	-15.36
-Plan				
% Diff		1.76	-3.77	-8.27
DTA(mm)	NA	0.00	NA	
Coords (y,x) cm	0,0	1,16.5	0,-0.5	

Notes

Reviewed By :


ArcCHECK

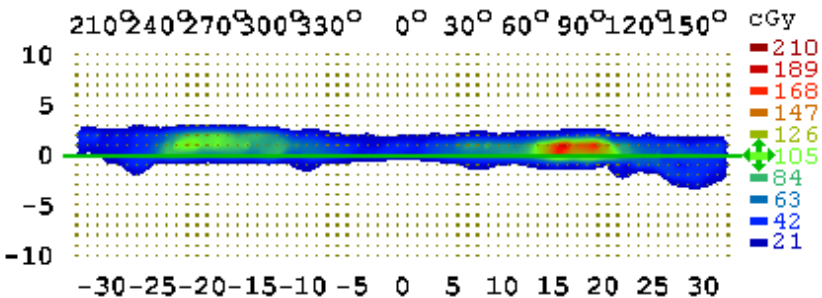

R:\Eclipse SC24\ZZ203\Measured files\3.txt



Plan

CAX Offset X=0 Y=-1

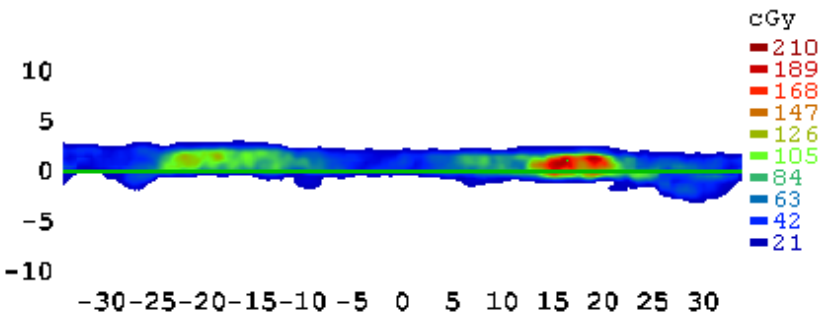

...\1.2.246.352.71.2.380660429640.3133245.201911...

ArcCHECK-Plan

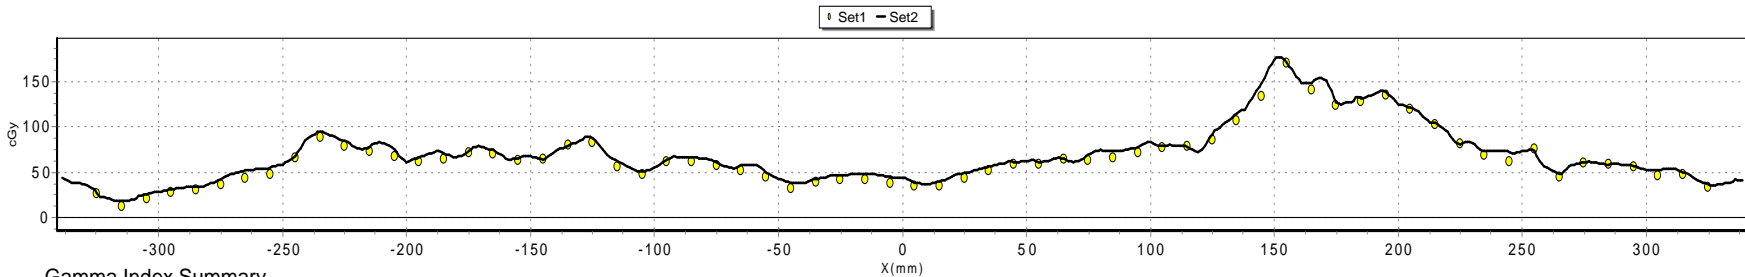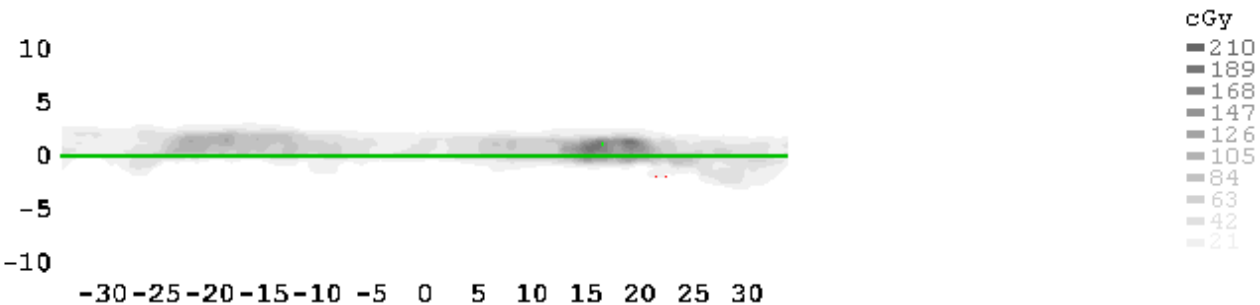

Gamma Index Summary

	Minimum	Maximum	Average	Stdv
Points Within Threshold	0.00	1.07	0.41	0.28
All Points	0.00	1.07	0.16	0.18