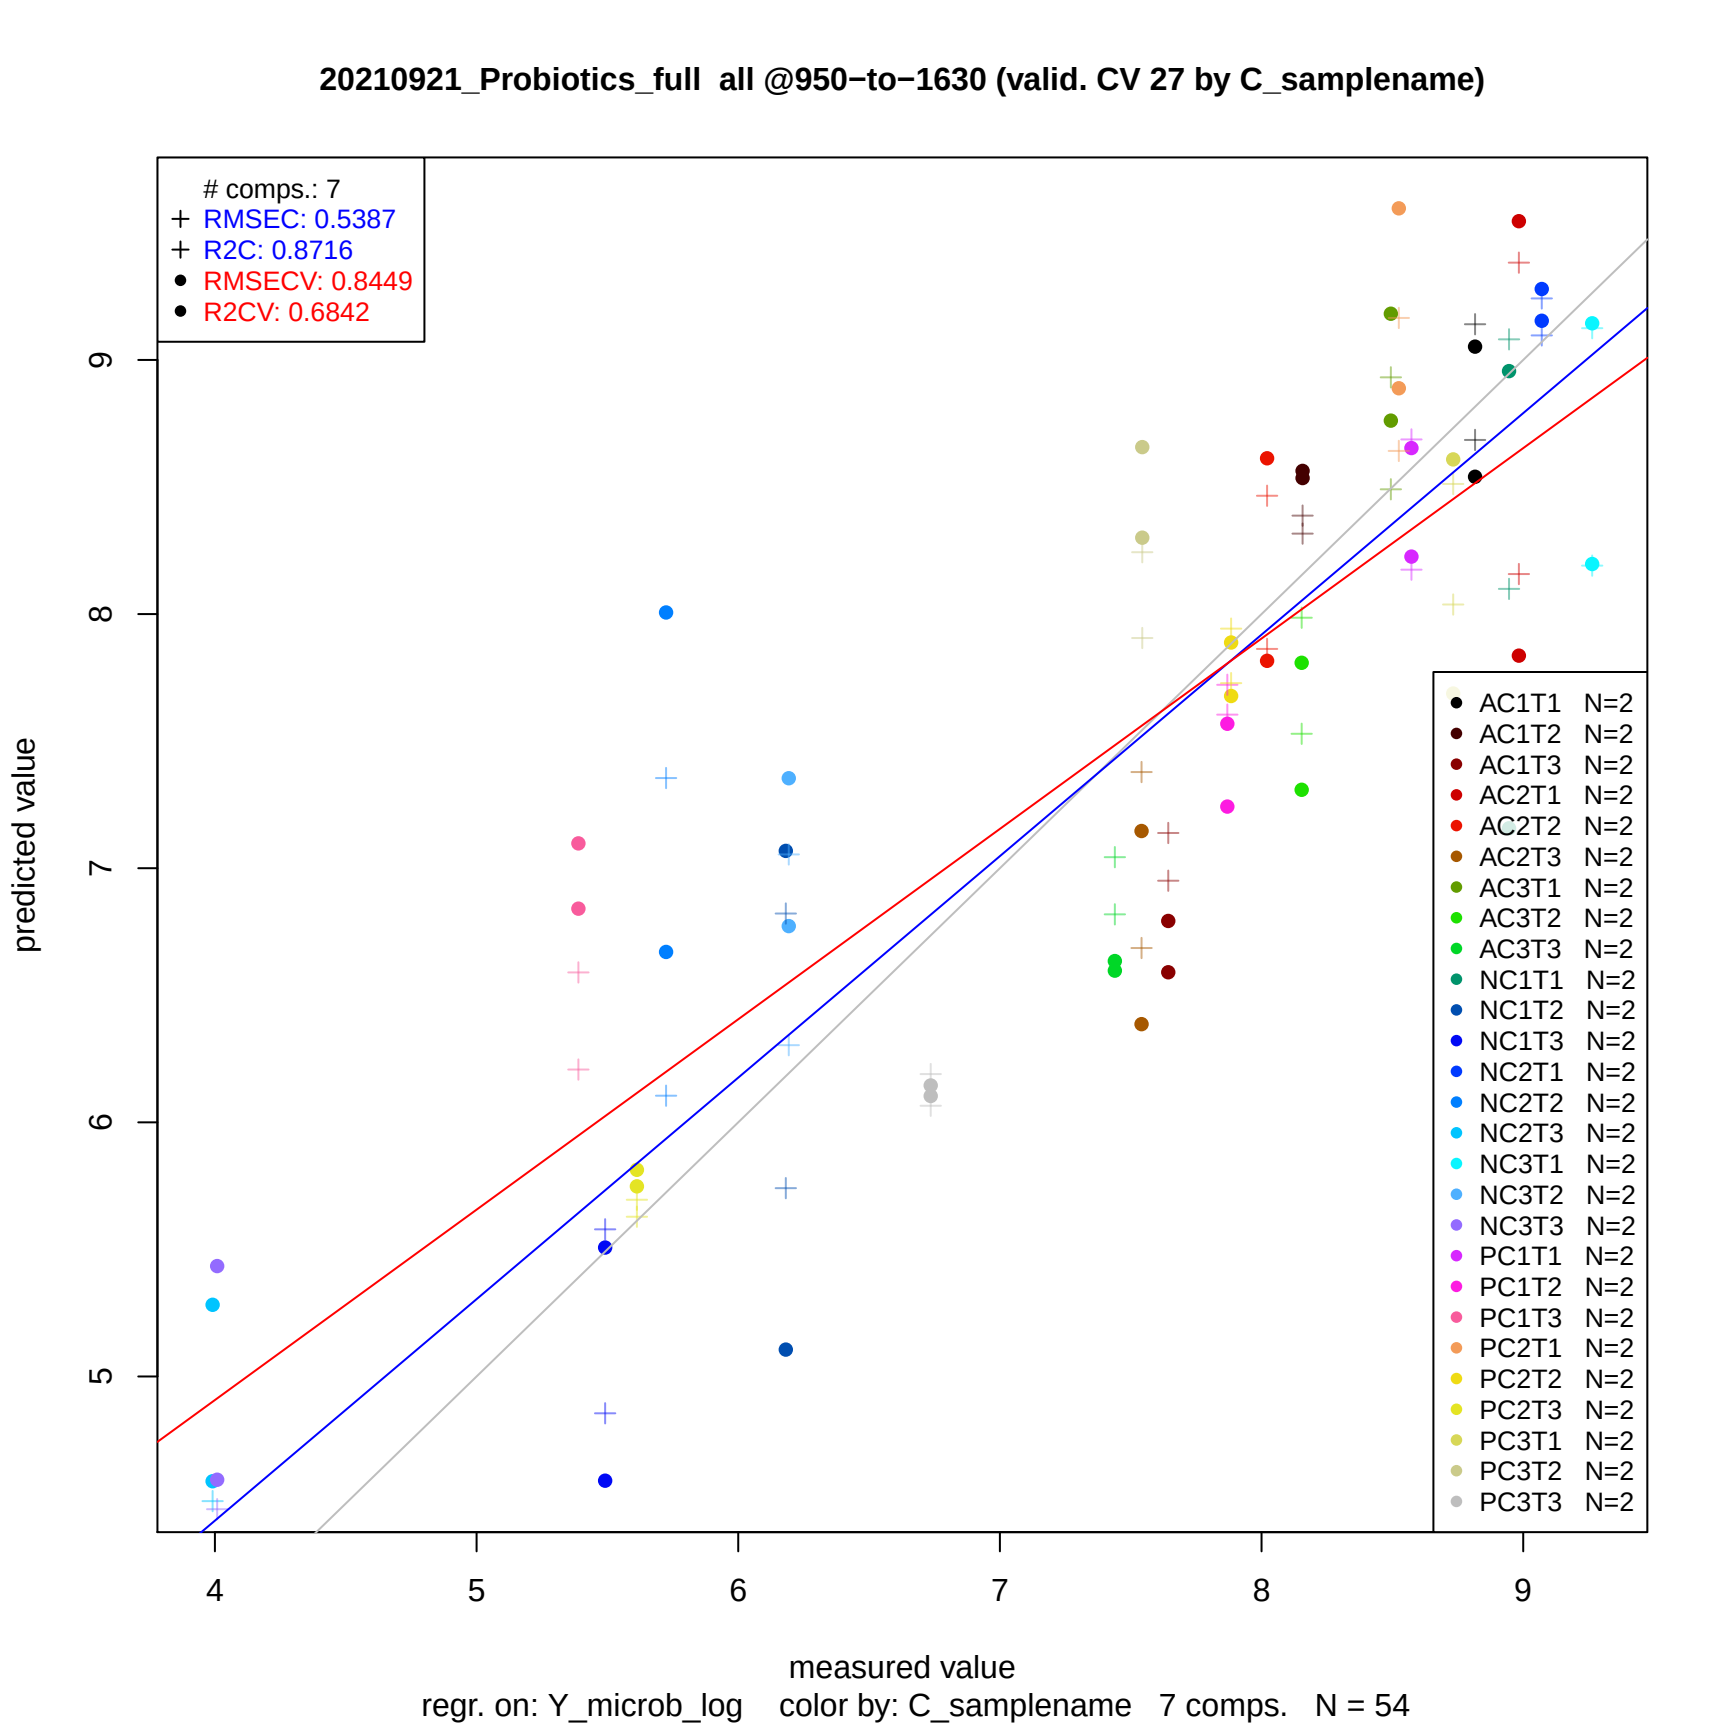
20210921_Probiotics_full all @950−to−1630 (valid. CV 27 by C_samplename)
# comps.: 7
RMSEC: 0.5387
R2C: 0.8716
RMSECV: 0.8449
R2CV: 0.6842
AC1T1 N=2
AC1T2 N=2
AC1T3 N=2
AC2T1 N=2
AC2T2 N=2
AC2T3 N=2
AC3T1 N=2
AC3T2 N=2
AC3T3 N=2
NC1T1 N=2
NC1T2 N=2
NC1T3 N=2
NC2T1 N=2
NC2T2 N=2
NC2T3 N=2
NC3T1 N=2
NC3T2 N=2
NC3T3 N=2
PC1T1 N=2
PC1T2 N=2
PC1T3 N=2
PC2T1 N=2
PC2T2 N=2
PC2T3 N=2
PC3T1 N=2
PC3T2 N=2
PC3T3 N=2
predicted value
measured value
regr. on: Y_microb_log color by: C_samplename 7 comps. N = 54

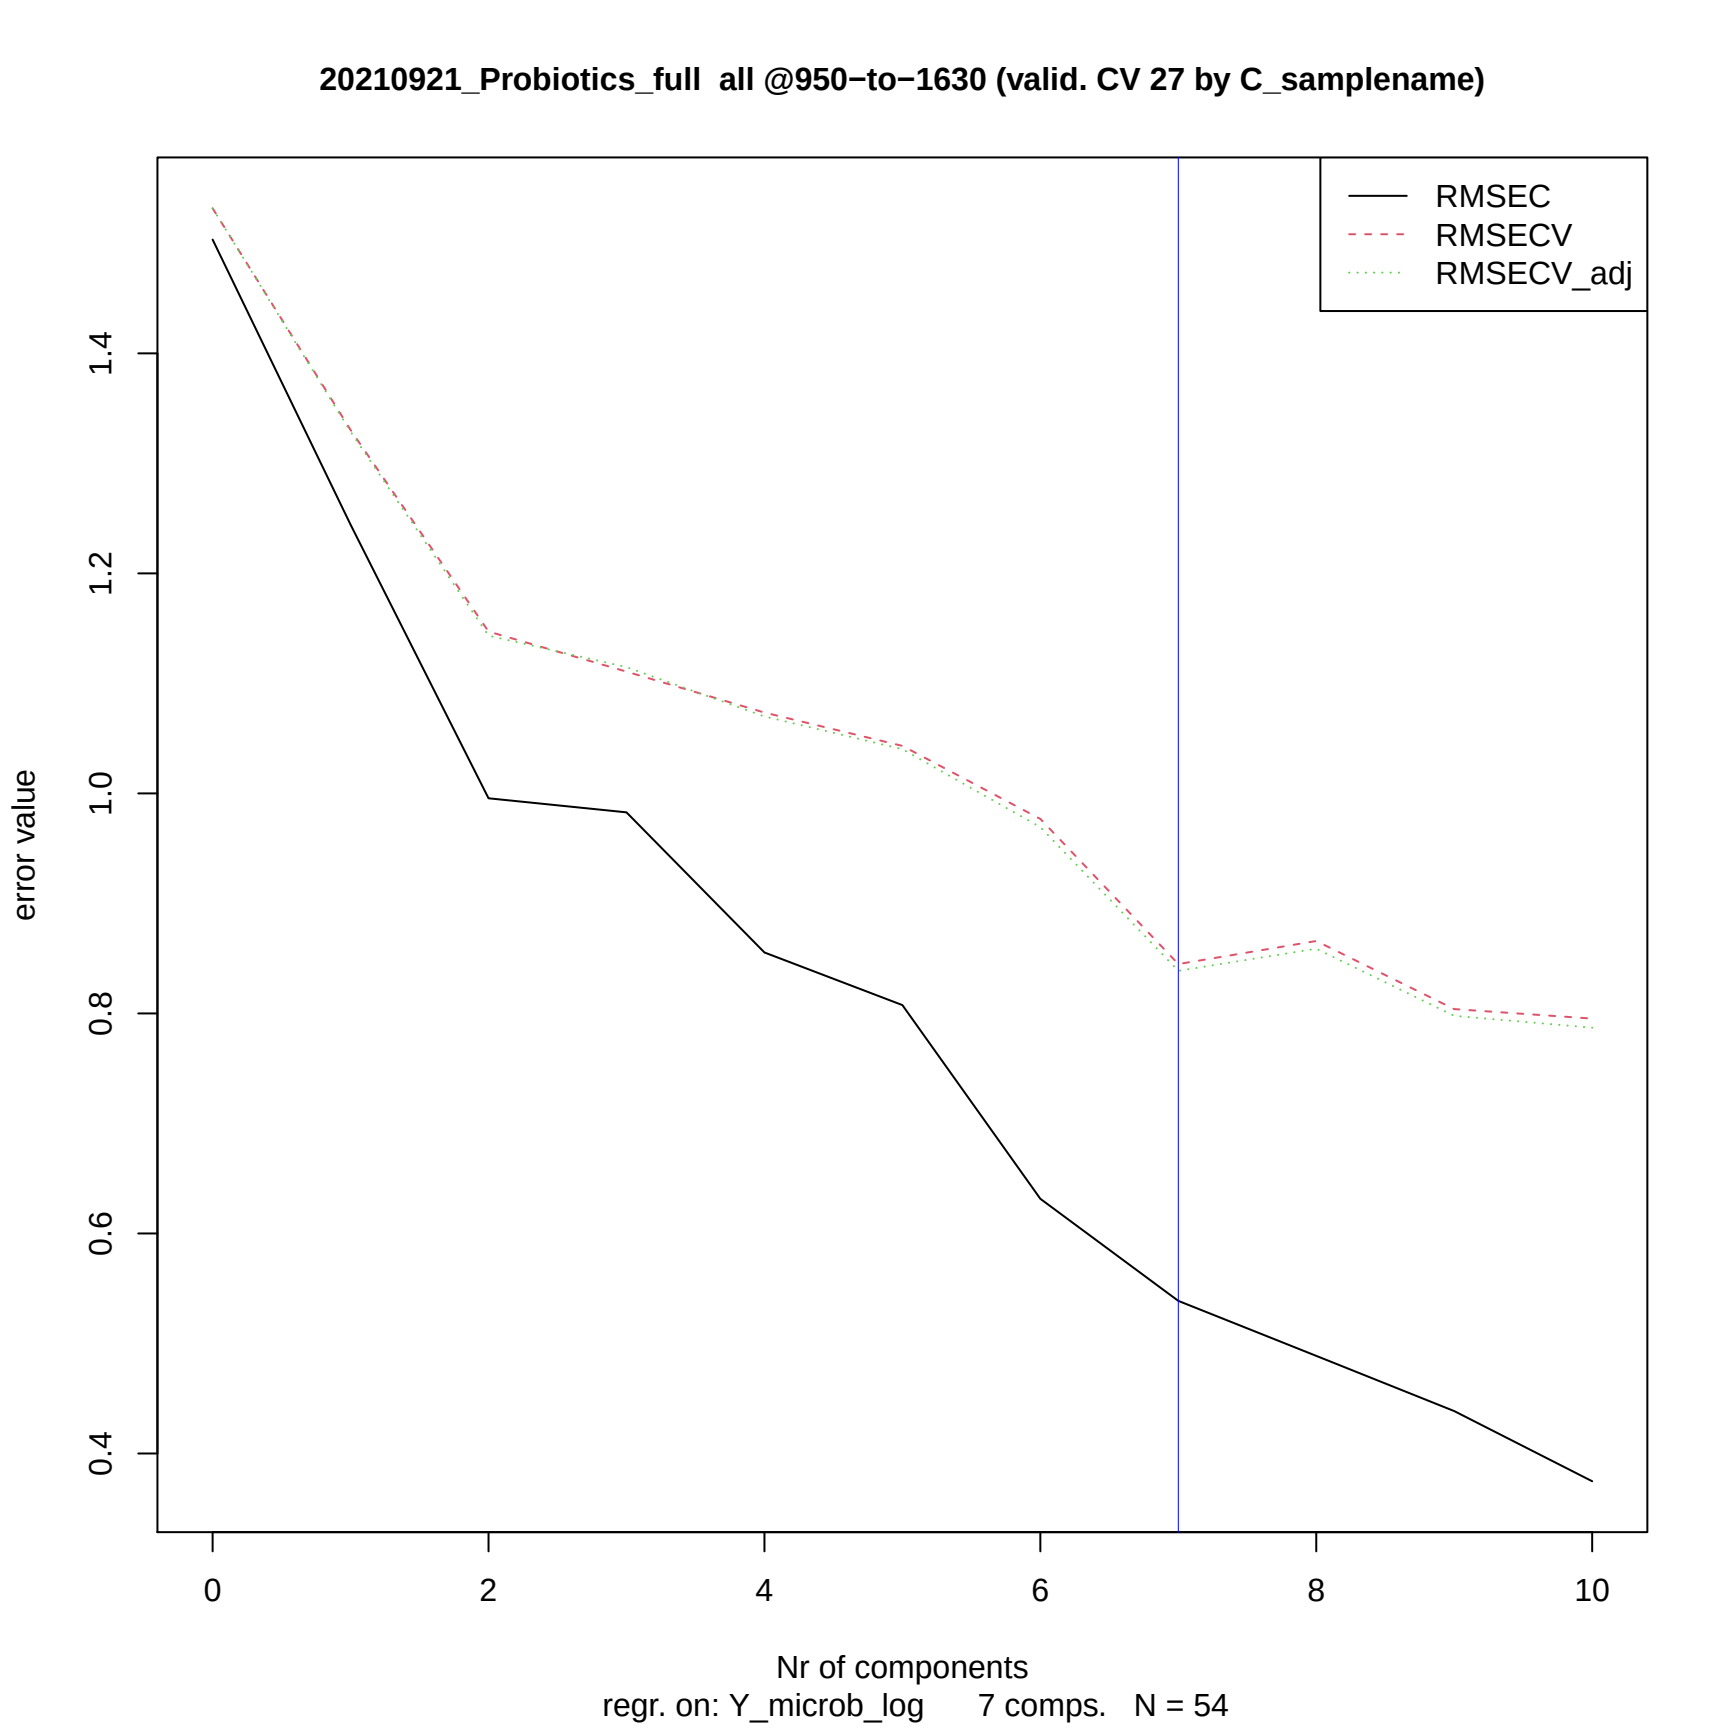
20210921_Probiotics_full all @950−to−1630 (valid. CV 27 by C_samplename)
RMSEC
RMSECV
RMSECV_adj
error value
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
0
2
4
6
8
10
Nr of components
regr. on: Y_microb_log 7 comps. N = 54