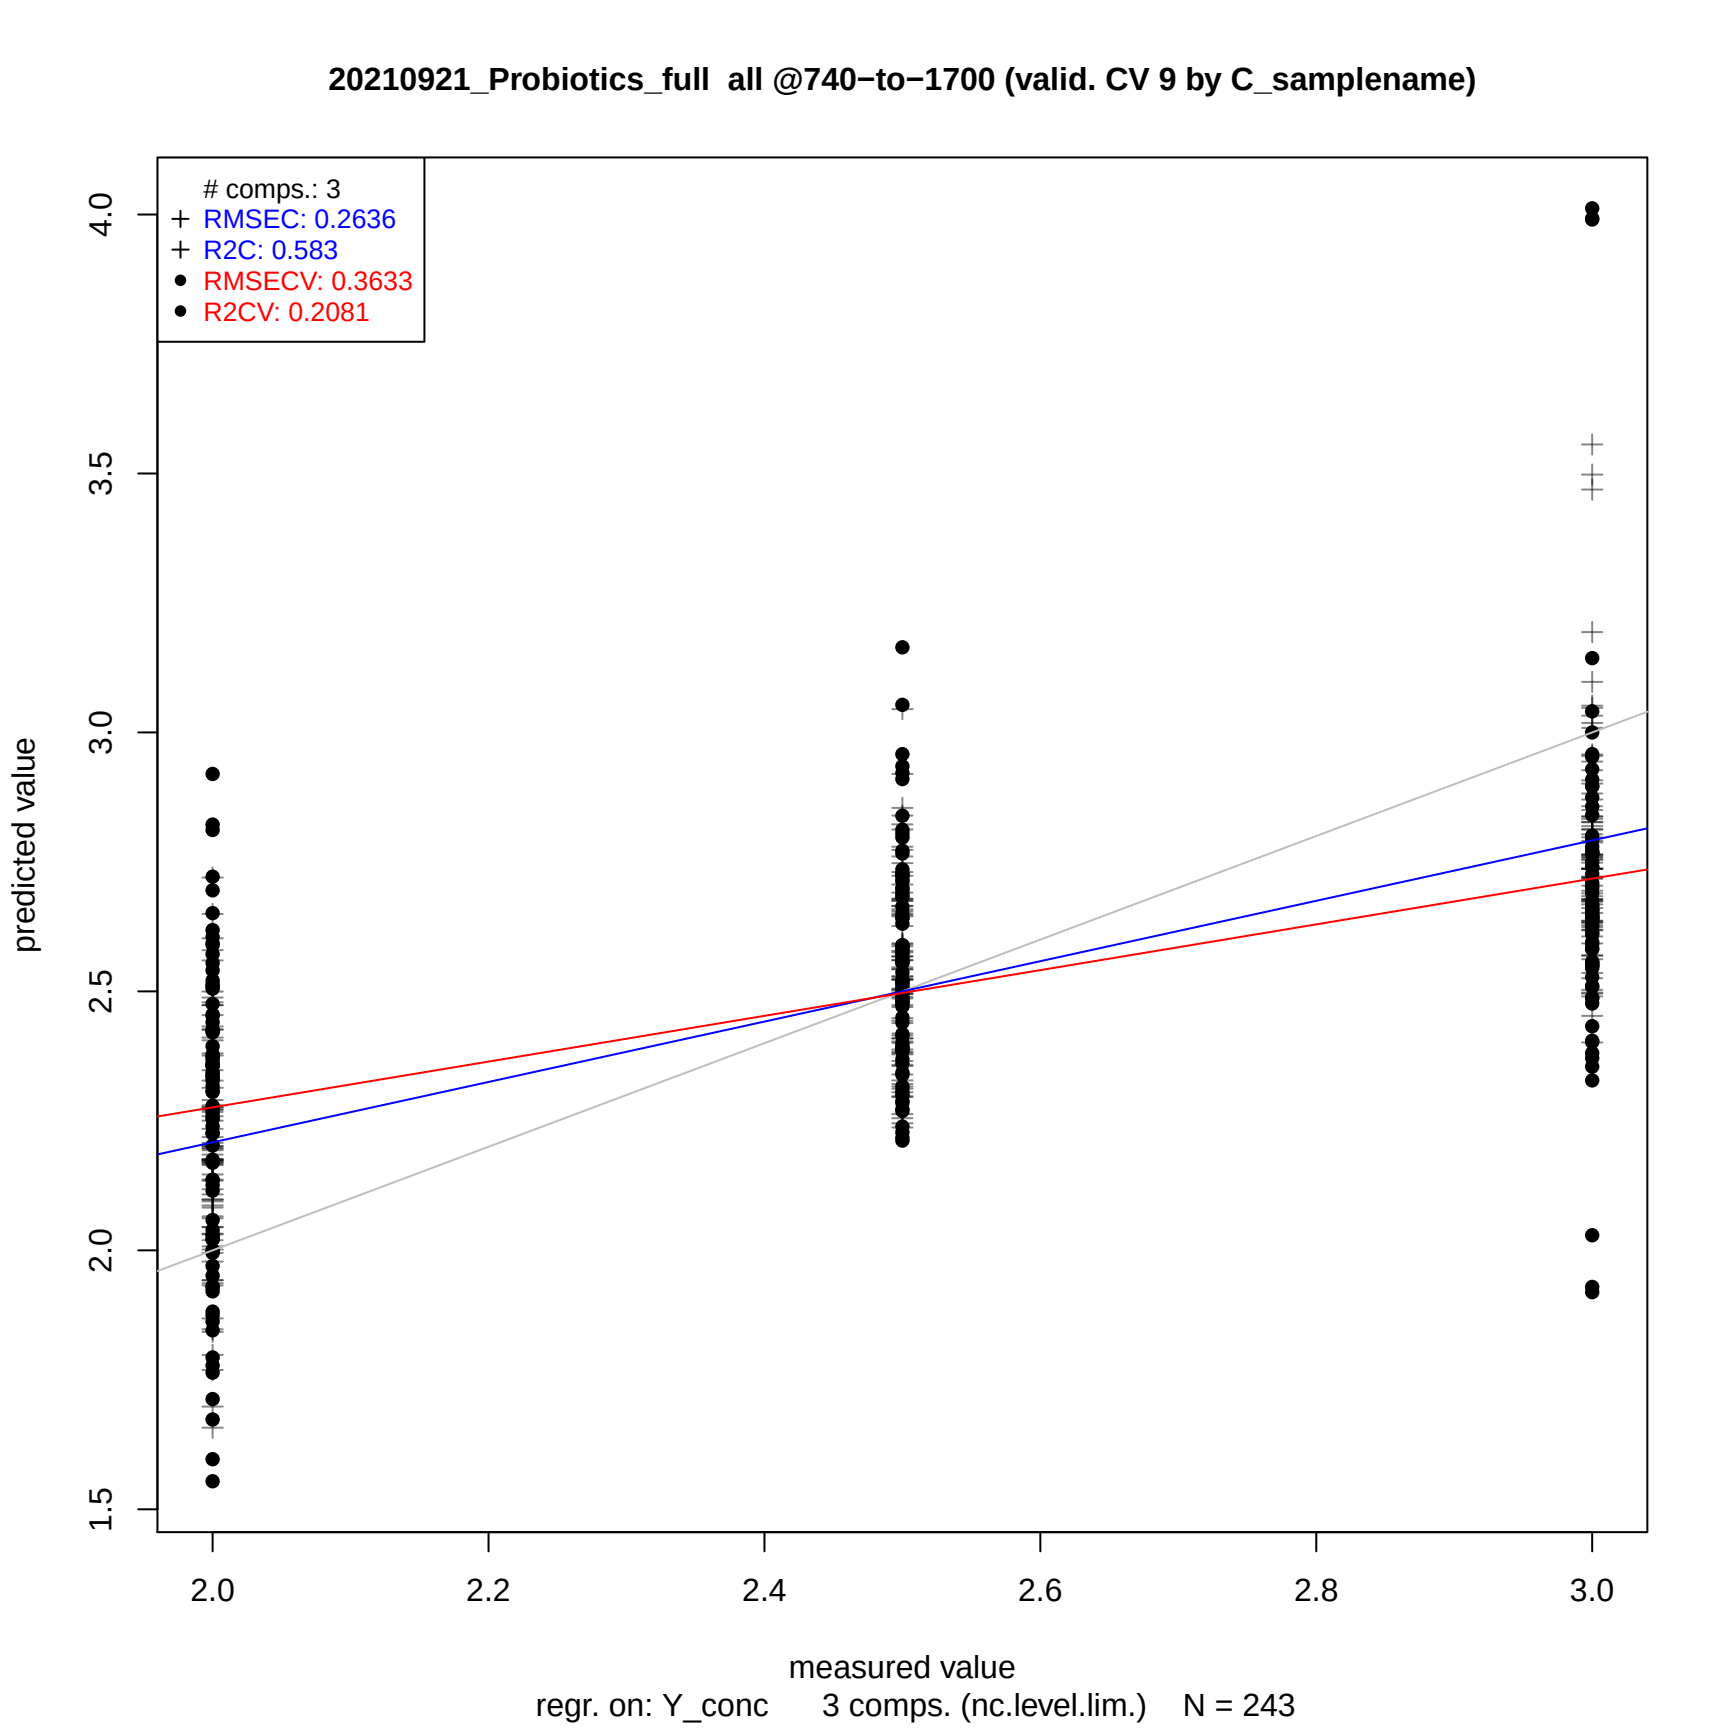
20210921_Probiotics_full all @740−to−1700 (valid. CV 9 by C_samplename)
comps.: 3
RMSEC: 0.2636
R2C: 0.583
RMSECV: 0.3633
R2CV: 0.2081
predicted value
measured value
regr. on: Y_conc 3 comps. (nc.level.lim.) N = 243

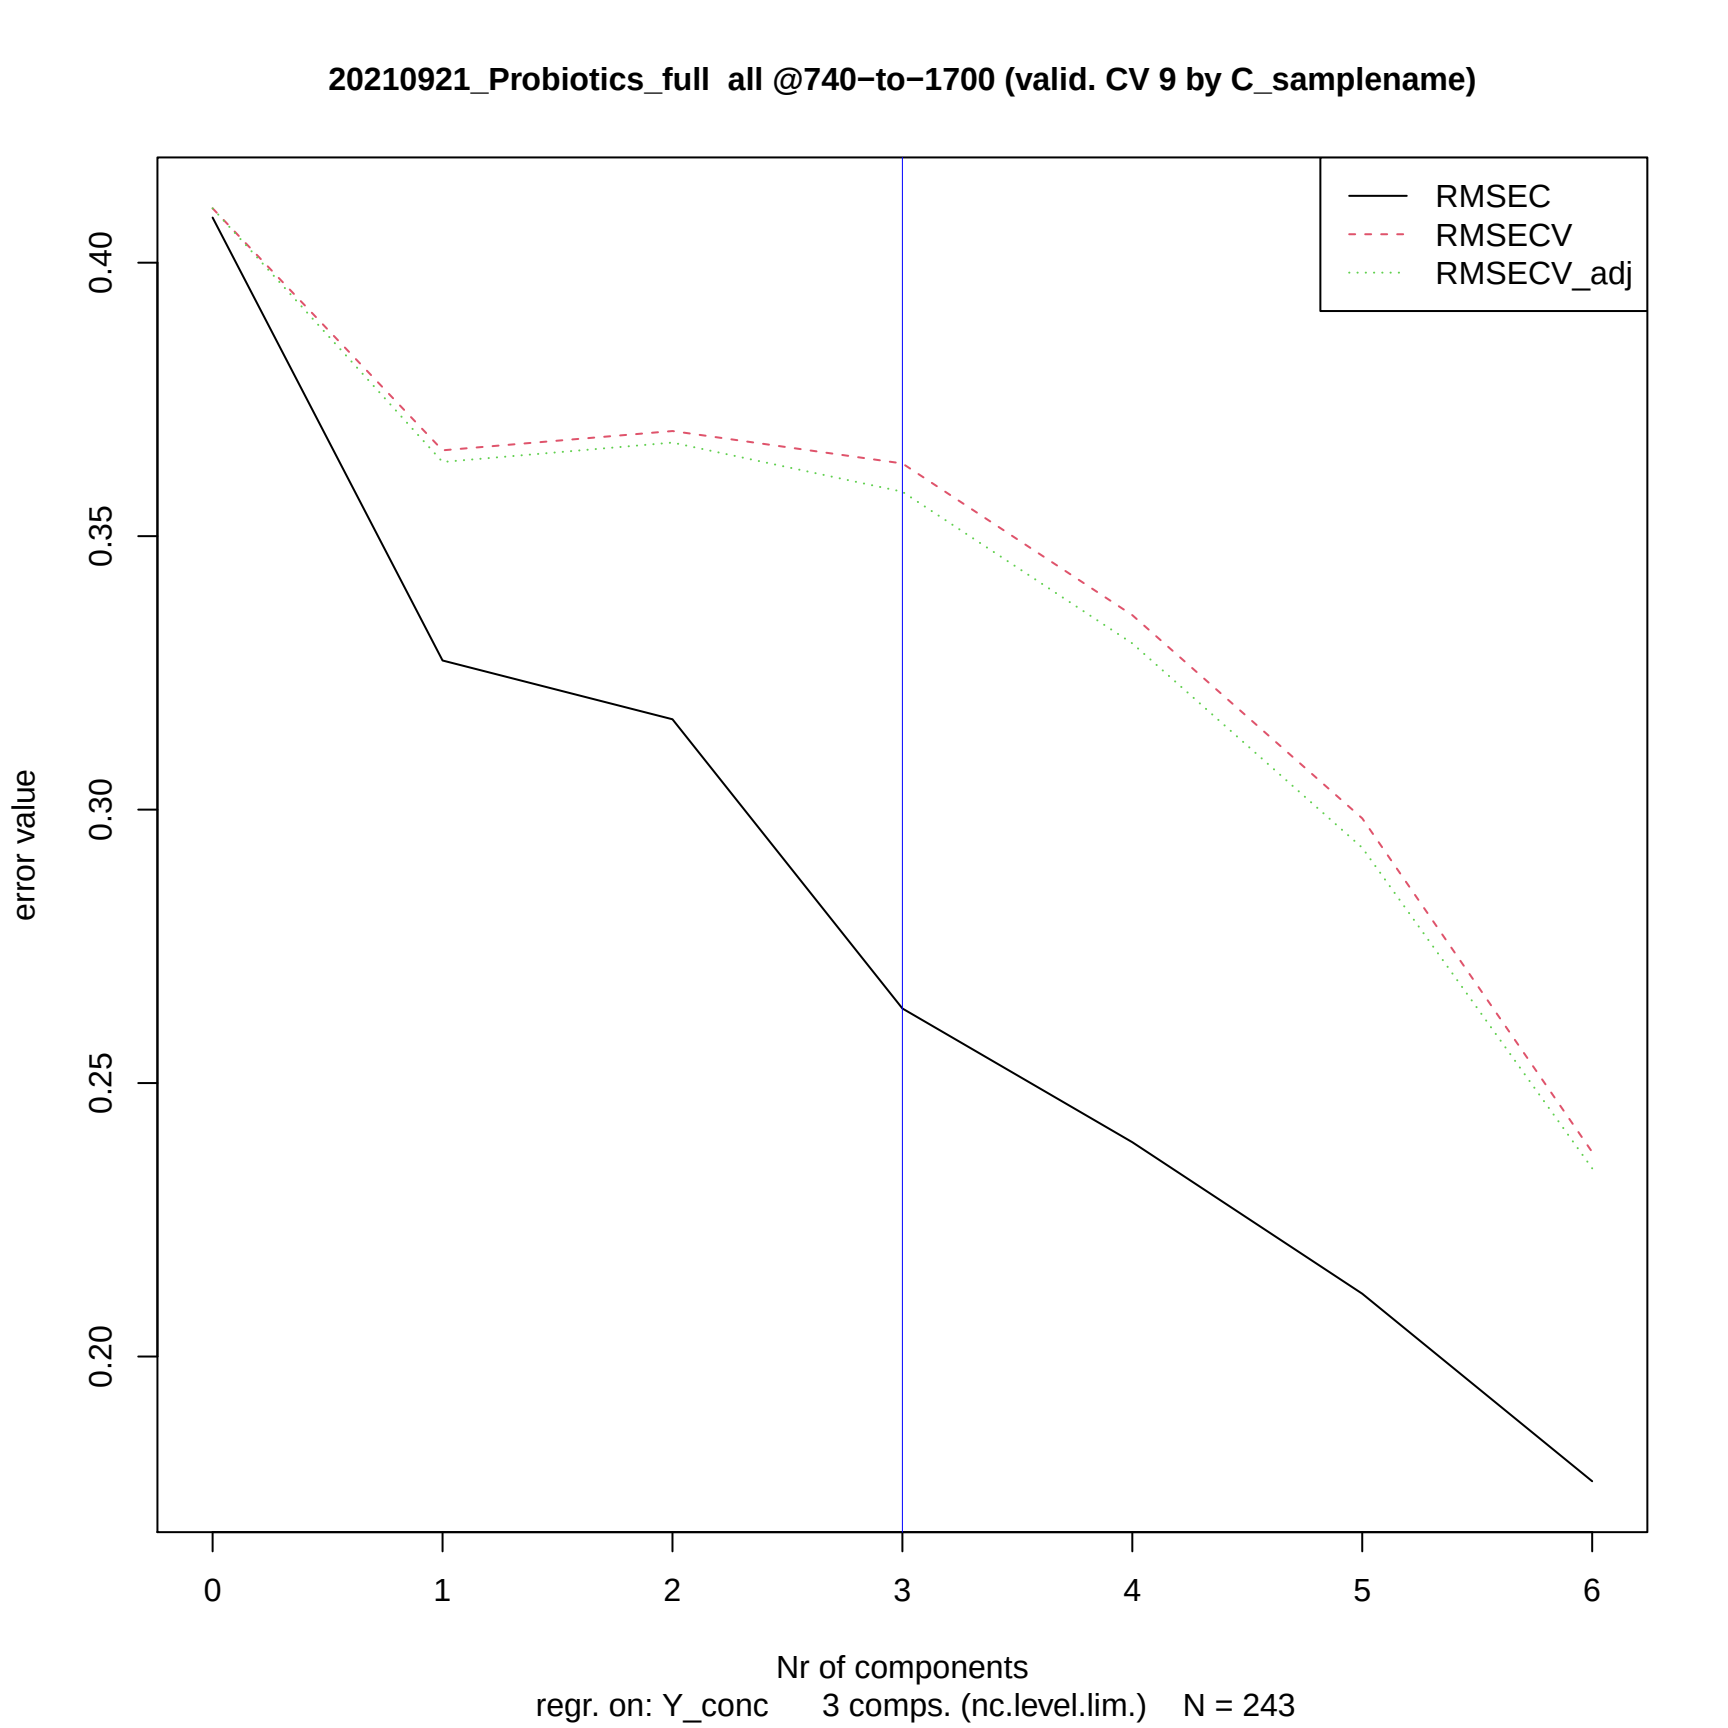
20210921_Probiotics_full all @740−to−1700 (valid. CV 9 by C_samplename)
RMSEC
RMSECV
RMSECV_adj
error value
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0
1
2
3
4
5
6
Nr of components
regr. on: Y_conc 3 comps. (nc.level.lim.) N = 243

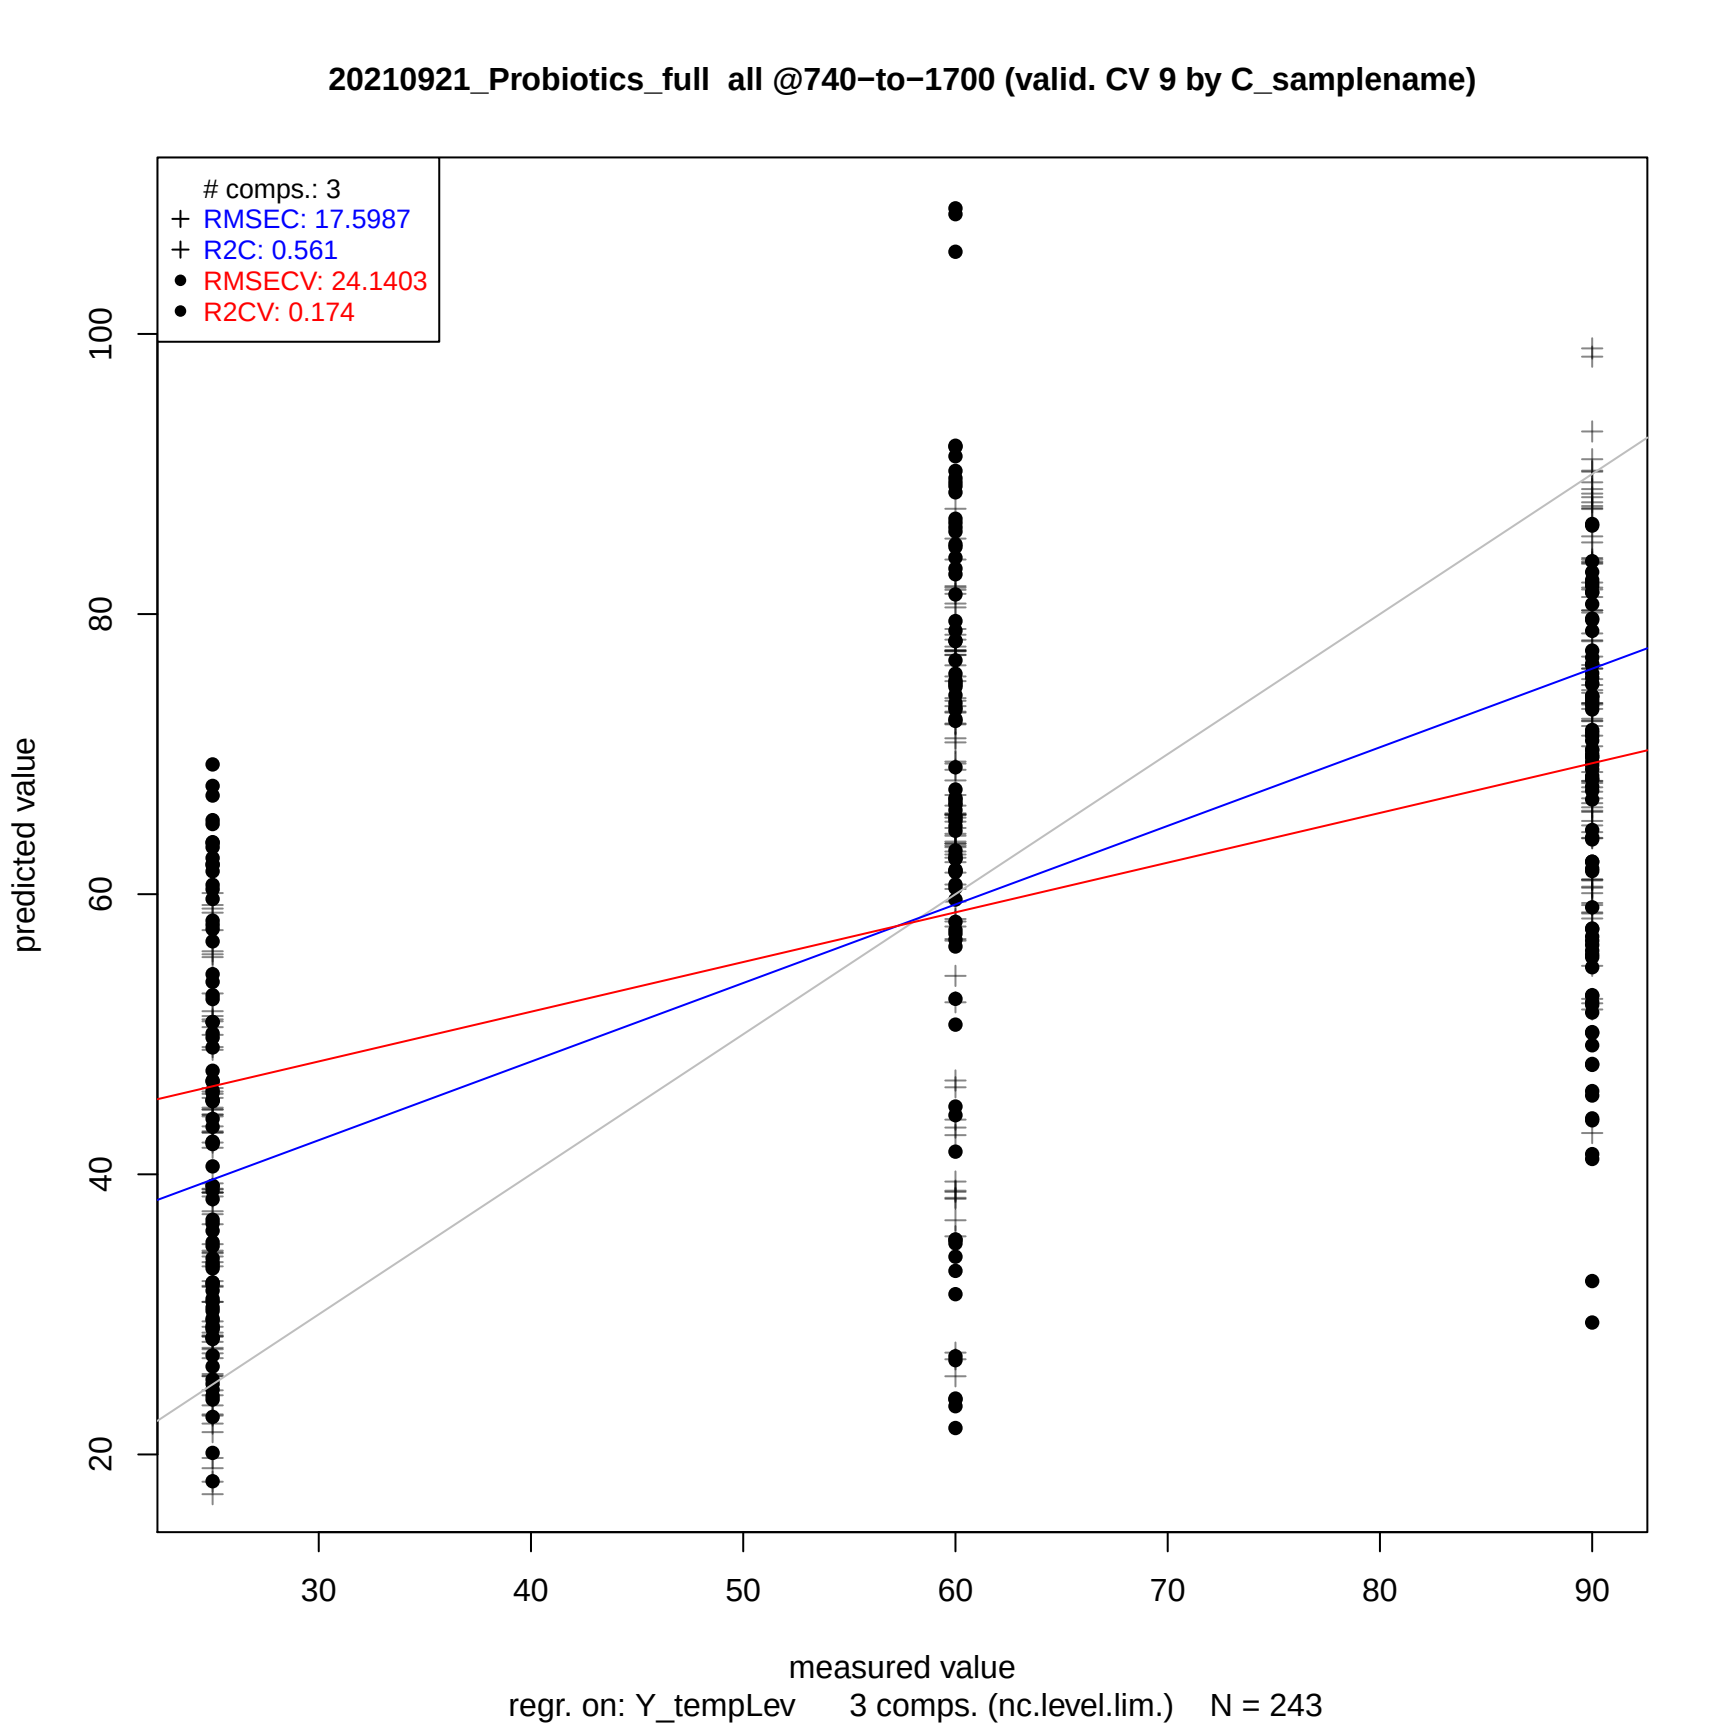
20210921_Probiotics_full all @740−to−1700 (valid. CV 9 by C_samplename)
comps.: 3
RMSEC: 17.5987
R2C: 0.561
RMSECV: 24.1403
R2CV: 0.174
predicted value
20
40
60
80
100
30
40
50
60
70
80
90
measured value
regr. on: Y_tempLev 3 comps. (nc.level.lim.) N = 243

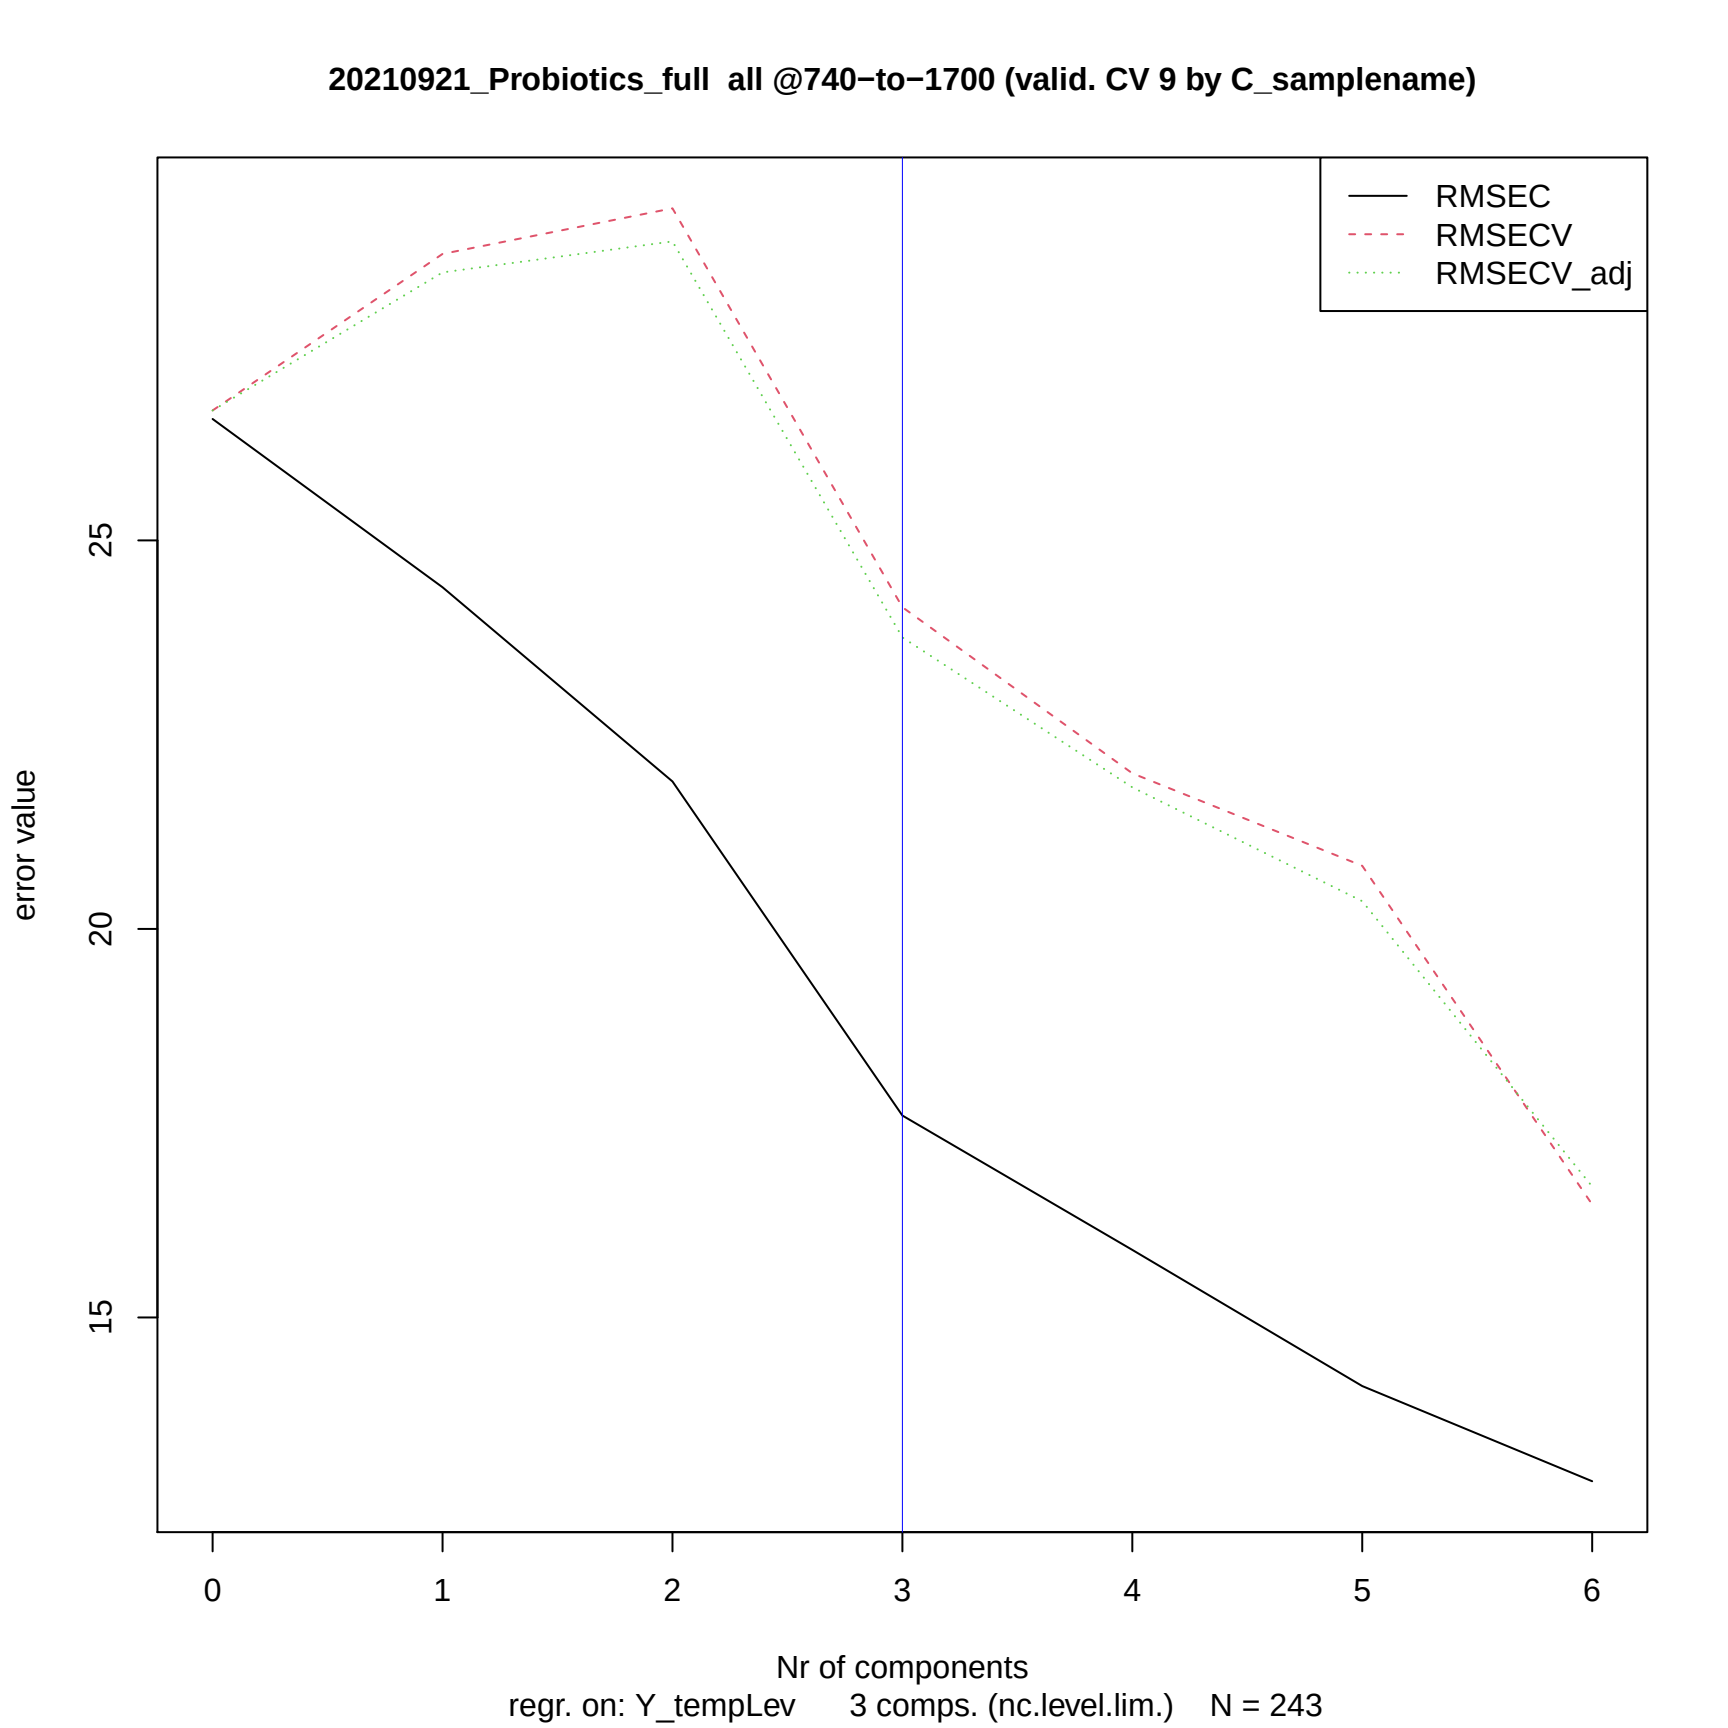
20210921_Probiotics_full all @740−to−1700 (valid. CV 9 by C_samplename)
RMSEC
RMSECV
RMSECV_adj
error value
25
20
15
0
1
2
3
4
5
6
Nr of components
regr. on: Y_tempLev 3 comps. (nc.level.lim.) N = 243