


Calibrazione 137Cs

04.03.2025 14:30

Conteggi

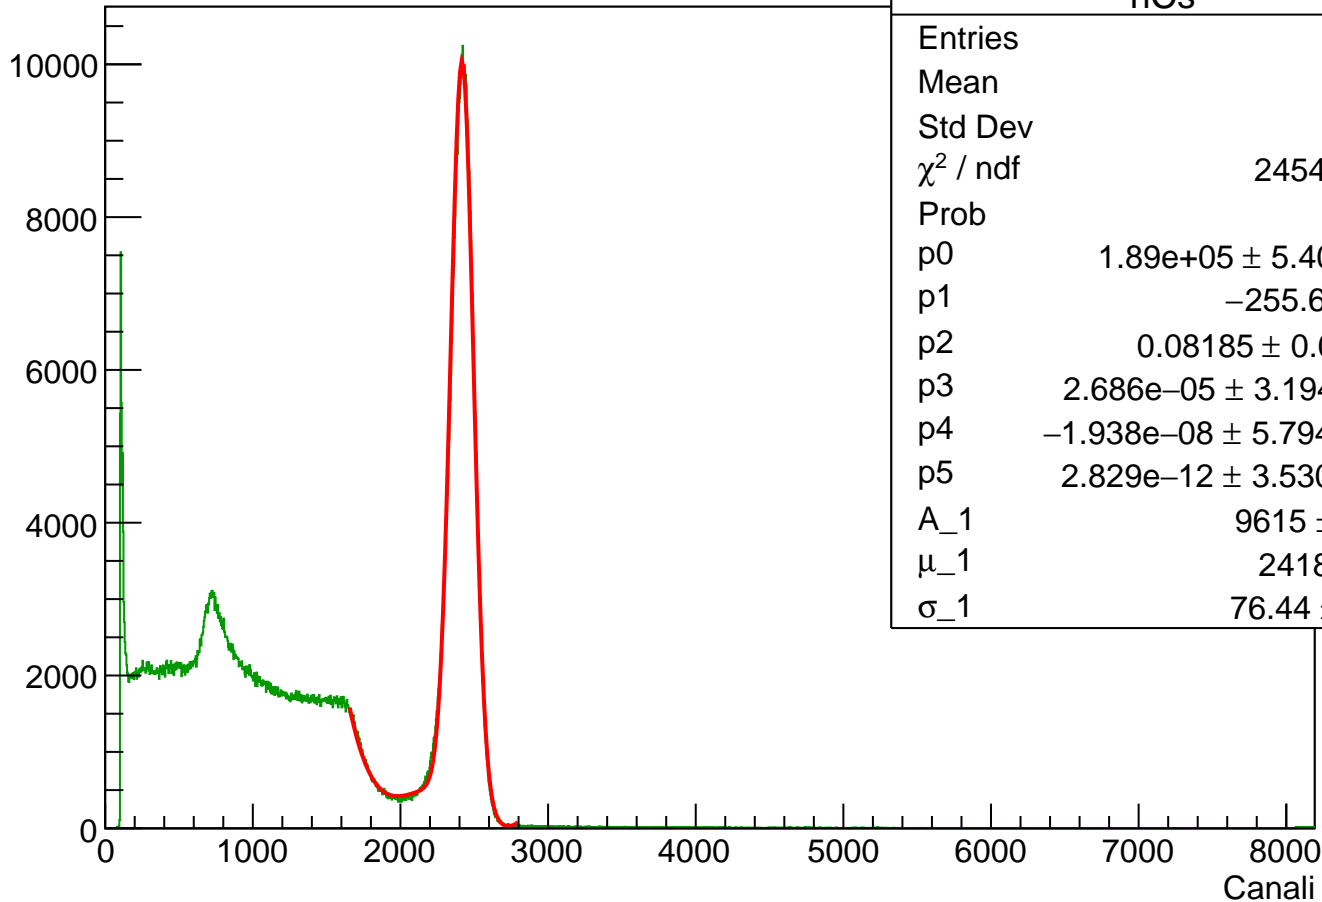

hCs

Entries	8192
Mean	1469
Std Dev	856.5
χ^2 / ndf	2454 / 279
Prob	0
p0	$1.89\text{e}+05 \pm 5.40\text{e}+00$
p1	-255.6 ± 0.0
p2	0.08185 ± 0.00000
p3	$2.686\text{e}-05 \pm 3.194\text{e}-10$
p4	$-1.938\text{e}-08 \pm 5.794\text{e}-14$
p5	$2.829\text{e}-12 \pm 3.530\text{e}-18$
A_1	9615 ± 23.5
μ_1	2418 ± 0.1
σ_1	76.44 ± 0.11