


Calibrazione 60Co

05.03.2025 18:05

Conteggi

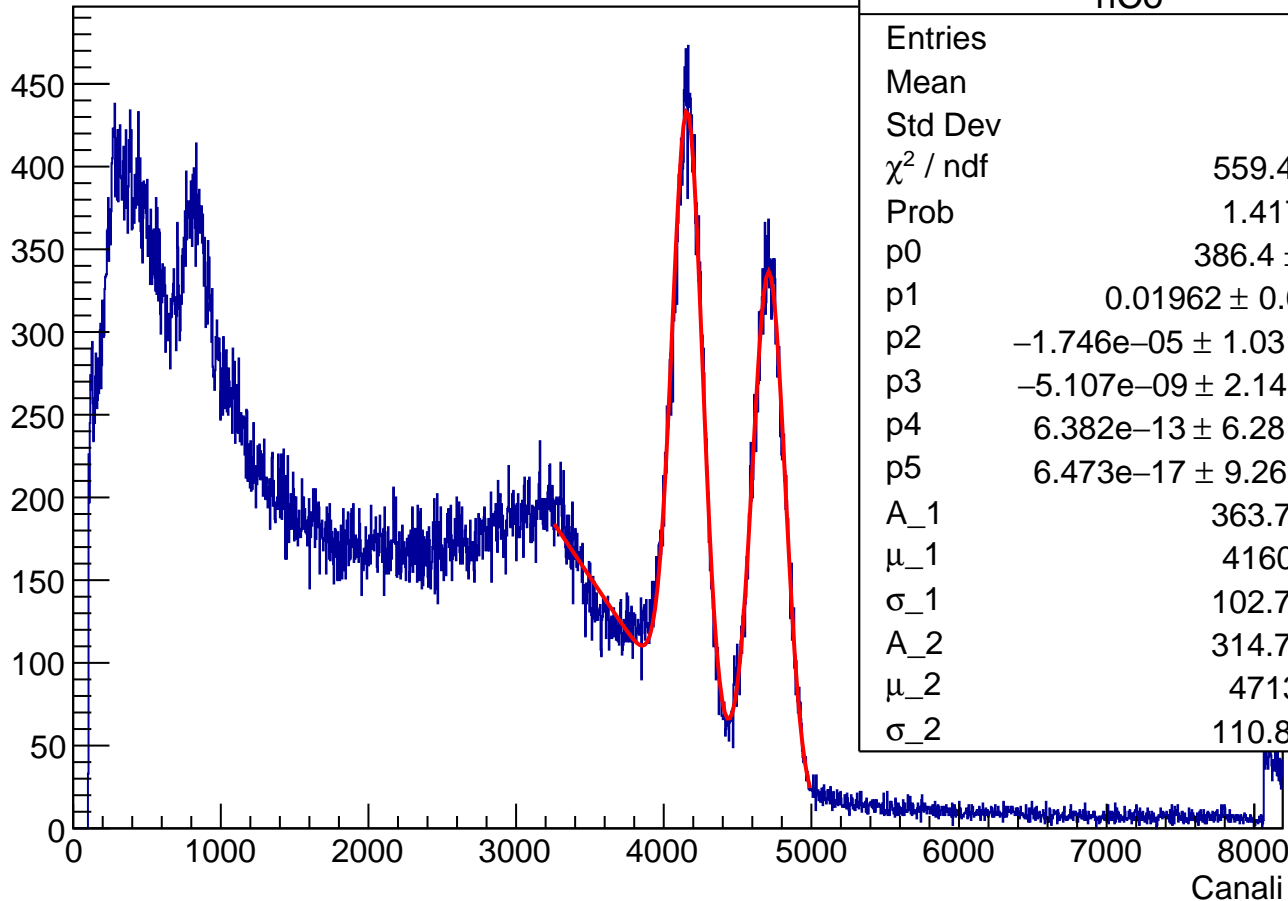

hCo

Entries	8192
Mean	2404
Std Dev	1659
χ^2 / ndf	559.4 / 426
Prob	1.417e-05
p0	386.4 ± 15.6
p1	0.01962 ± 0.00097
p2	$-1.746\text{e-}05 \pm 1.031\text{e-}06$
p3	$-5.107\text{e-}09 \pm 2.149\text{e-}10$
p4	$6.382\text{e-}13 \pm 6.281\text{e-}14$
p5	$6.473\text{e-}17 \pm 9.269\text{e-}19$
A_1	363.7 ± 3.6
μ_1	4160 ± 0.9
σ_1	102.7 ± 1.2
A_2	314.7 ± 2.9
μ_2	4713 ± 1.1
σ_2	110.8 ± 1.4