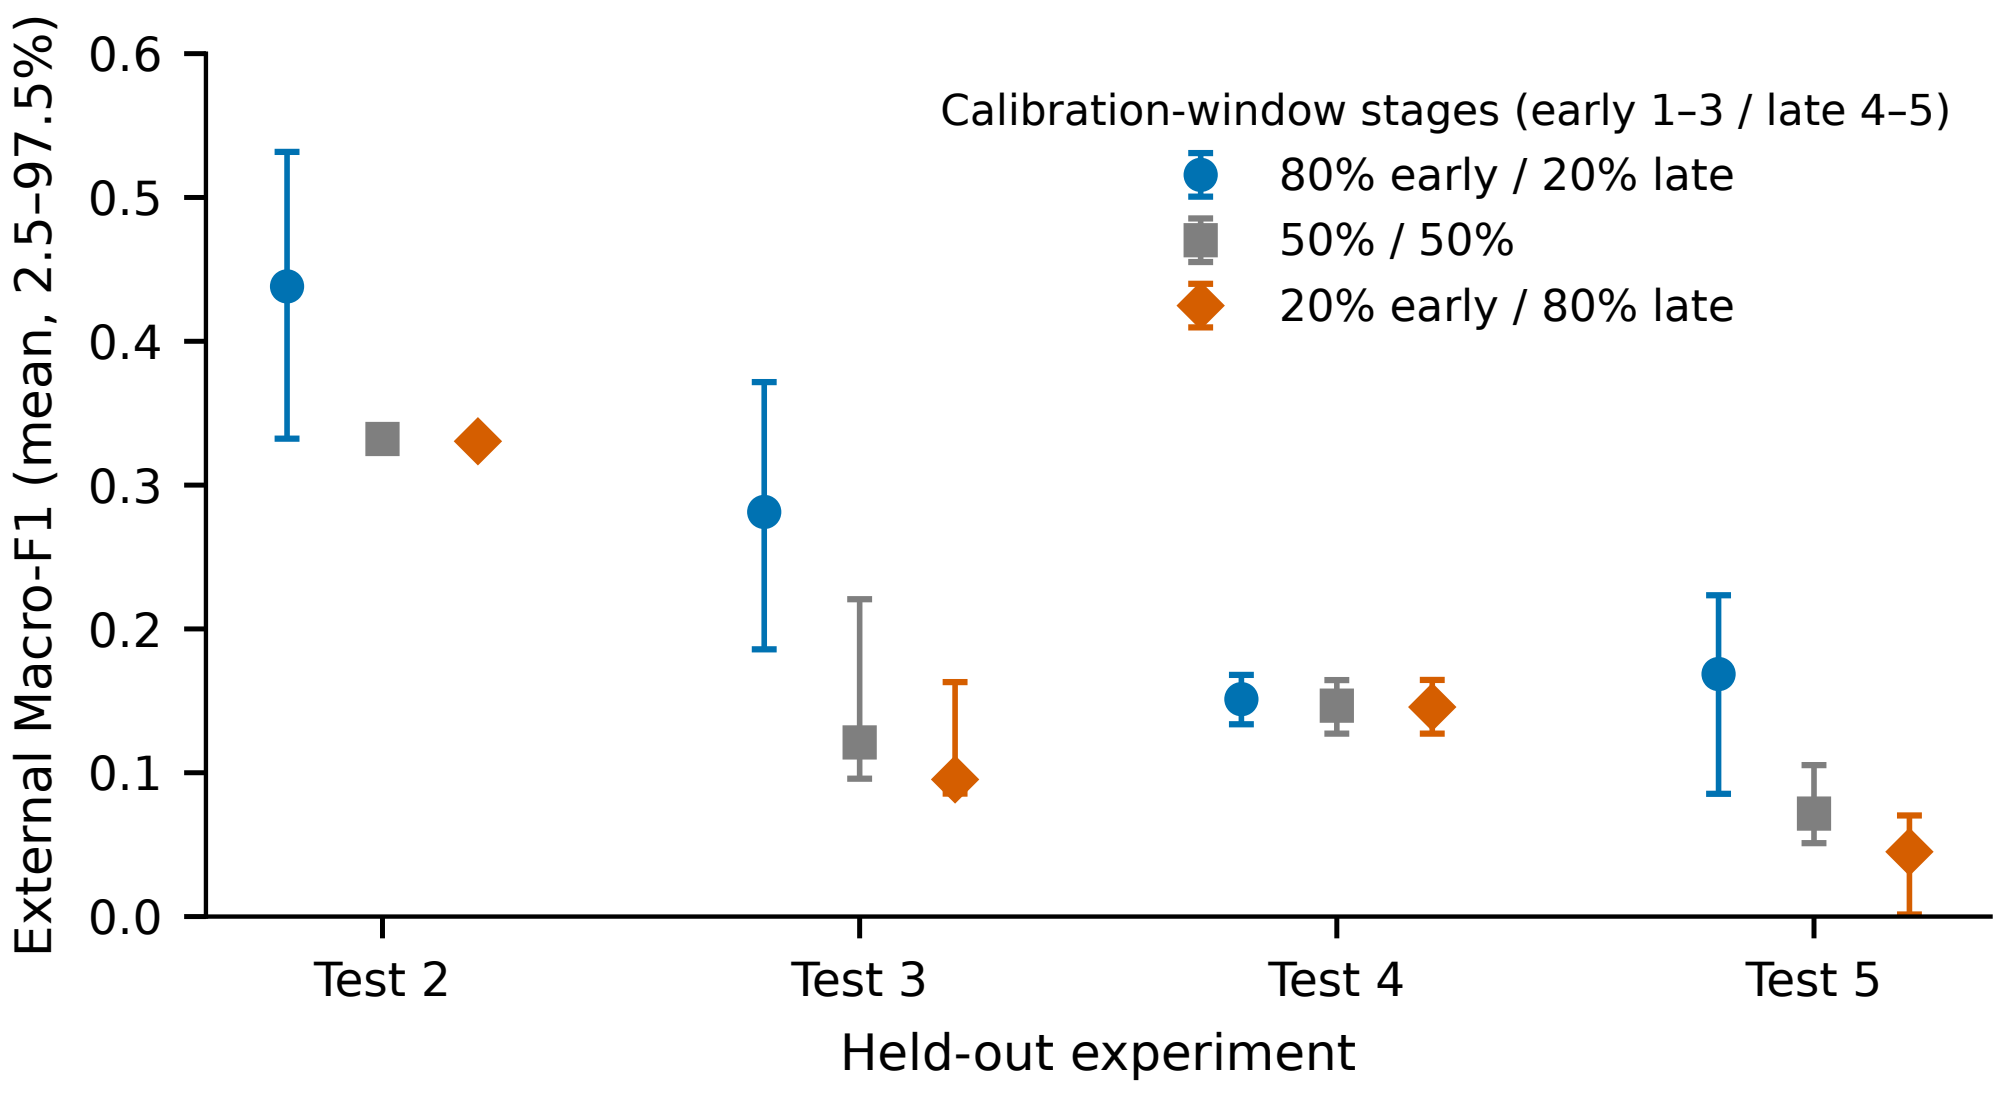
External Macro-F1 (mean, 2.5–97.5%)
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Calibration-window stages (early 1–3 / late 4–5)
80% early / 20% late
50% / 50%
20% early / 80% late
Test 2
Test 3
Test 4
Test 5
Held-out experiment