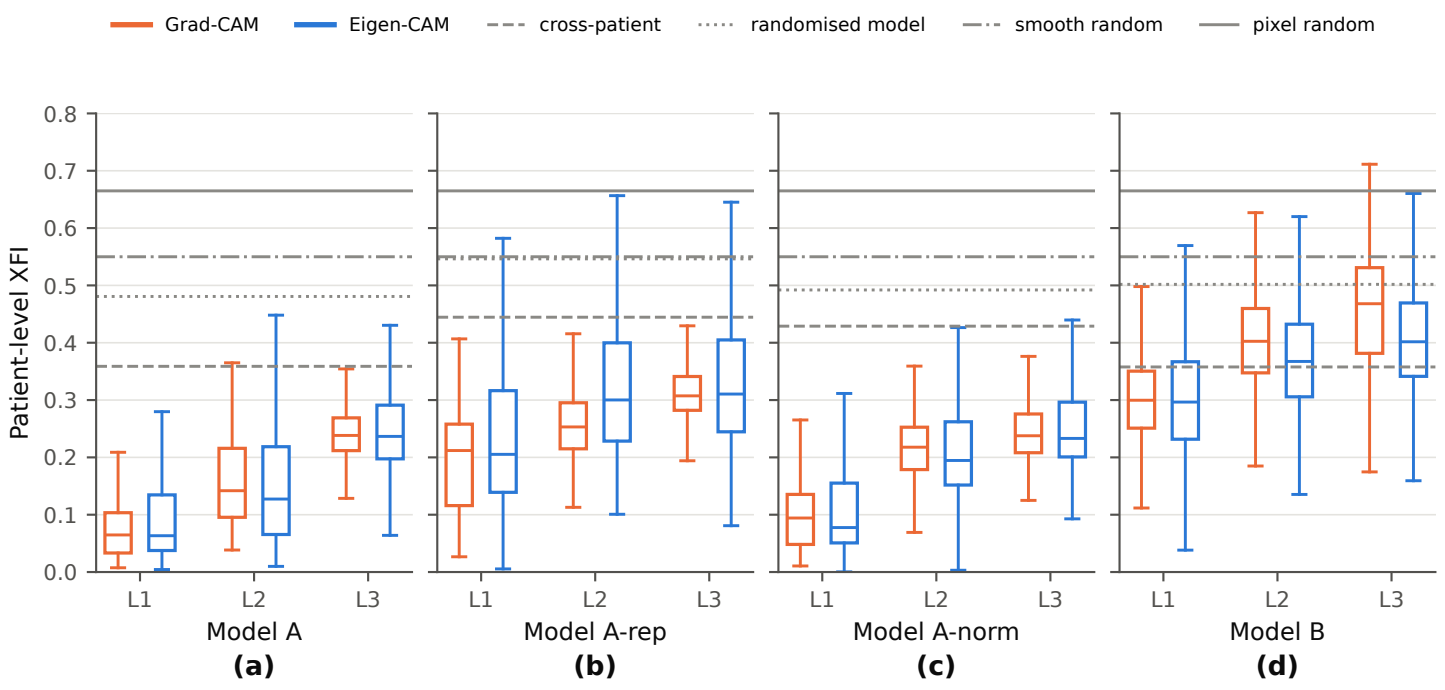
Grad-CAM
Eigen-CAM
cross-patient
randomised model
smooth random
pixel random
Patient-level XFI
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
L1
L2
L3
Model A
(a)
Model A-rep
(b)
Model A-norm
(c)
Model B
(d)