VERITAS™ Advanced Infusion Pack - REF VRT-AI
VERITAS™ Advanced Fluidics Pack - REF VRT-AF

Z311979E B
11/2025

EN VERITAS™ Advanced Infusion Pack - REF VRT-AI VERITAS™ Advanced Fluidics Pack - REF VRT-AF 3

DA VERITAS™ Advanced Infusion-pakke - REF VRT-AI VERITAS™ Advanced Fluidics-pakke - REF VRT-AF 5

NL VERITAS™ geavanceerd infuuspakket - REF VRT-AI VERITAS™-pakket voor geavanceerd vochtbeheer - REF VRT-AF 7

FI VERITAS™ kehittynyt infuusiosarja – REF VRT-AI VERITAS™ kehittynyt nesteenantosarja – REF VRT-AF 9

FR Pack de perfusion avancée VERITAS™ - REF VRT-AI Pack de gestion fluidique avancée VERITAS™ - REF VRT-AF 11

DE VERITAS™ Fortschrittliches Infusions-Pack - REF VRT-FI VERITAS™ Fortschrittliches Fluidik-Pack - REF VRT-FF 13

IT Cassetta per infusione avanzata VERITAS™ - REF VRT-AI Cassetta per gestione fluidi avanzata VERITAS™ - REF VRT-AF 15

NO VERITAS™ avansert infusjonspakke – REF VRT-AI VERITAS™ avansert fluidikkpakke – REF VRT-AF 17

PT Cartucho de Infusão Avançada VERITAS™ – REF VRT-AI Cartucho de Fluidos Avançados VERITAS™ – REF VRT-AF 19

ES Paquete de perfusión avanzada VERITAS™ - REF VRT-AI Paquete de gestión avanzada de fluidos VERITAS™ - REF VRT-AF 21

SV VERITAS™ Advanced Infusion-paket – REF VRT-AI VERITAS™ Advanced Fluidics-paket – REF VRT-AF 23

ET Täiustatud infusioonikomplekt VERITAS™ – REF VRT-AI Täiustatud vedelikutasakaalu komplekt VERITAS™ – REF VRT-AF 25

ZH VERITAS™ 先进灌注包 - REF VRT-AI VERITAS™ 先进液流包 - REF VRT-AF 27

KO VERITAS™ 고급형 주입 팩 - REF VRT-AI VERITAS™ 고급형 유체 팩 - REF VRT-AF 29

ZH VERITAS™ 先進注入組件 - REF VRT-AI VERITAS™ 先進流體組件 - REF VRT-AF 31

JA VERITAS™ Advanced Infusion パック - REF VRT-AI VERITAS™ Advanced Fluidics パック - REF VRT-AF 33

PL Zaawansowany zestaw do infuzji VERITAS™ – REF VRT-AI Zaawansowany zestaw do zarządzania płynami VERITAS™ – REF VRT-AF 35

RU Комплект VERITAS™ для усовершенствованной инфузии — REF VRT-AI
Комплект VERITAS™ для усовершенствованного переливания жидкостей — REF VRT-AF 37

BG Комплект VERITAS™ Advanced Infusion - REF VRT-AI Комплект VERITAS™ Advanced Fluidics - REF VRT-AF 39

SL Napredni infuzijski komplet VERITAS™ - REF VRT-AI Napredni fluidični komplet VERITAS™ - REF VRT-AF 41

CS Rozšířená infuzní sada VERITAS™ – REF VRT-AI Rozšířená kapalinová sada VERITAS™ – REF VRT-AF 43

HU VERITAS™ Fejlett infúziós készlet – REF VRT-AI VERITAS™ Fejlett folyadékkezelő készlet – REF VRT-AF 45

LV VERITAS™ uzlabotu infūziju šķīdumu pakete - REF VRT-AI VERITAS™ uzlabotu šķidrumu pakete - REF VRT-AF 47

LT „VERITAS™ Advanced Infusion Pack“ – REF VRT-AI „VERITAS™ Advanced Fluidics Pack“ - REF VRT-AF 49

SK Pokročilá infúzna súprava VERITAS™ – REF VRT-AI Súprava VERITAS™ na pokročilý manažment tekutín – REF VRT-AF 51

RO VERITAS™ Pachet de perfuzie avansată - REF VRT-AI VERITAS™ Pachet pentru gestionarea avansată a fluidelor - REF VRT-AF 53

TR VERITAS™ Gelişmiş İnfüzyon Paketi - REF VRT-AI VERITAS™ Gelişmiş Flüidik Paketi - REF VRT-AF 55

2025-12-31

This document is valid only on the date printed. If unsure of the print date, please re-print to ensure use of the latest revision of the IFU (available at www.e-ifu.com). The onus resides with the user to ensure that the most up-to-date IFU is used.

Johnson & Johnson VISION

© Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2025

HR Pakiranje za naprednu infuziju VERITAS™ – REF VRT-AI Pakiranje za napredno upravljanje tekućinama VERITAS™ – REF VRT-AF 57

EL Προηγμένο πακέτο έγχυσης VERITAS™ - REF VRT-AI Προηγμένο πακέτο διαχείρισης υγρών VERITAS™ - REF VRT-AF 59

SR Napredni infuzioni komplet VERITAS™ – REF VRT-AI Napredni komplet za fluidiku VERITAS™ – REF VRT-AF 61

PT(BR) Pacote de infusão avançado VERITAS™ - REF VRT-AI Pacote de fluidos avançado VERITAS™ - REF VRT-AF 63

UK Покращений інфузійний набір VERITAS™ — REF VRT-AI Покращений набір для переливання рідин VERITAS™ — REF VRT-AF 65

This document is valid only on the date printed. If unsure of the print date, please re-print to ensure use of the latest revision of the IFU (available at www.e-ifu.com). The onus resides with the user to ensure that the most up-to-date IFU is used.

Johnson & Johnson VISION

© Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2025

℞ only

Introduction/Description:

The VERITAS Advanced Infusion Pack or VERITAS Advanced Fluidics Pack is a DUAL PUMP Pack that provides all tubing and accessories necessary to perform an irrigation and aspiration procedure or a phacoemulsification procedure. The VERITAS Advanced Infusion Pack contains an additional tubing line to provide pressurized air to the irrigation solution source. Each Pack consists of the following items:

1. Cassette and Tubing Assembly
2. Monitor Drape Cover
3. Mayo Stand Drape Cover
4. Test Chamber

Intended Purpose:

The VERITAS Advanced Infusion Pack or VERITAS Advanced Fluidics Pack contains the Cassette and Tubing Assembly and is intended to perform irrigation and aspiration during anterior segment cataract surgery. It is used with the VERITAS™ Vision System. The Test Chamber is intended to verify the correct connectivity and functionality of the irrigation/aspiration function prior to the surgical procedure.

Product Drawings:

VERITAS Advanced Fluidics Pack

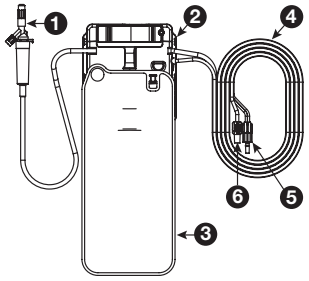

VERITAS Advanced Infusion Pack



1. Irrigation Spike (To Irrigation Source)
2. Cassette
3. Drainage Bag
4. I/A Tubing Set (To Handpiece)
5. Irrigation Luer Lock Fitting
6. Aspiration Fitting

VERITAS Advanced Infusion Pack Only:

7. Infusion Line
8. Infusion Connector (To Console)

Indications/Contraindications/Intended Patient/Intended User:

All relevant information for Indications/Contraindications/Intended Patient/Intended User is described in the Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Phacoemulsification System Operator's Manual ("Operator's Manual"). Contraindications: Any pre-existing patient condition/s that the health care provider determines to be a contraindication to cataract surgery. Intended patients include adult patients with cataracts or adult patients undergoing anterior segment ophthalmic surgery (e.g., removal of the crystalline lens). Note: Pregnant, nursing women, or children were not included in the clinical trial(s) conducted. The Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Phacoemulsification System is intended for use by an ophthalmologist and support staff operating under direction of the surgeon.

Clinical Benefits/Undesirable Side Effects/Adverse Effects:

All relevant information for Clinical Benefits/Undesirable Side Effects/Adverse Effects is described in the Operator's Manual. Clinical benefits of the Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Phacoemulsification System include the following: Rapid visual rehabilitation, Early resumption of daily activities, Minimal ocular inflammation, Minimal postoperative astigmatism, Reduced potential for ocular complications. Complications that may be associated with the Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Phacoemulsification System include broken capsule, corneal burn, infection/inflammation, and corneal edema.

Instructions for Use:

Please refer to the following instructions for how to properly install the VERITAS Pack. The VERITAS Advanced Infusion Pack has one extra step as noted below. To use the VERITAS Advanced Infusion Pack, Advanced Infusion must be selected in Program Settings prior to surgery. For additional instructions, refer to the Operator's Manual. Prior to use, visually inspect the product tray for breaches of package integrity. Do not use the product if package integrity has been compromised.

1. After sterile removal of all contents from product tray sealed with lid, hand off CASSETTE and IRRIGATION SPIKE to the Circulator (Nurse) while retaining the I/A TUBING SET in the sterile field.
2. Place Monitor Drape Cover over monitor on the VERITAS Vision System.
3. Place hands in Mayo Stand Drape Cover according to the guide markings on the drape and cover the VERITAS Vision System tray arm.
4. Insert the CASSETTE into the fluidics panel of the VERITAS Vision System.
5. Push the CASSETTE until the system activates the latch mechanism to retain the CASSETTE.
6. Prepare the irrigating solution source.
7. Remove the protector from the tip of the IRRIGATION SPIKE.
8. With the source upright, insert the IRRIGATION SPIKE straight into the center of the rubber source stopper without twisting.
9. Hang the source on the I/V pole and then squeeze and release the drip chamber until it is 1/2 to 3/4 full.
10. For VERITAS Advanced Infusion Pack only: The INFUSION LINE has a black INFUSION CONNECTOR at the free end. Insert the INFUSION CONNECTOR into the side panel of the VERITAS Vision System and then twist it clockwise until it clicks when fully connected.
11. For handpieces without a locking irrigation port, retract collar on the IRRIGATION LUER LOCK FITTING. Connect the luer fittings of the I/A TUBING SET to the handpiece. For handpieces equipped with a locking irrigation port, turn the collar on the IRRIGATION LUER LOCK FITTING clockwise to lock fitting to handpiece.
12. Attach tip and irrigation sleeve to the handpiece per assembly instructions.
13. From the PRIME/TUNE screen on the VERITAS Vision System, activate Continuous Irrigation with the handpiece tip facing downwards inside a test chamber not sealed against the irrigation sleeve.
14. Fill the test chamber with fluid eliminating all air and insert the test chamber straight and centered over the tip and irrigation sleeve until sealed.
15. Deactivate Continuous Irrigation and perform prime sequence according to the Operator's Manual.

General:

The device does not contain Phthalates.

The Pack is sterilized using ethylene oxide and is designed for single use.

Store product in a cool, dry place.

Precautions:

- Do not use product after its expiration date marked on product's packaging labels.
- Contents are sterile when product tray is sealed with lid and undamaged.
- If product performance becomes compromised during use, discontinue use and perform the appropriate tests as detailed in the Operator's Manual of the System. If results are not satisfactory, replace the Pack according to instructions defined in the Operator's Manual.
- When using VERITAS Advanced Infusion Pack, the effective total height of the irrigation source cannot go lower than 30 cm when Advanced Infusion is activated.

This document is valid only on the date printed. If unsure of the print date, please re-print to ensure use of the latest revision of the IFU (available at www.e-ifu.com). The onus resides with the user to ensure that the most up-to-date IFU is used.

- VERITAS Advanced Infusion Pack may be used with irrigation solution in a bottle or bag after a successful Prime/Tune has been completed. Not all bags may successfully complete Prime which may result in treatment delay.

Warning:

Single use only. Do not re-sterilize, reprocess, or reuse this device.

Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. single use medical devices are labeled with instructions for use and handling to minimize exposure to conditions which may compromise the product, patient, or the user. The resterilization/reprocessing of Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. single use medical devices may result in physical damage to the medical device, failure of the medical device to perform as intended, and patient illness or injury due to infection, inflammation, and/or illness due to product contamination, transmission of infection and lack of product sterility.

Disposal:

Any VERITAS Pack that has been contaminated by blood, tissue, and/or bodily fluids/matter shall be handled as biohazardous medical waste according to healthcare facility protocol and applicable local requirements.

If the VERITAS Pack is received in an unsatisfactory condition, please contact your local Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Sales Office immediately. Each VERITAS Pack is identified by a lot number on the product's packaging labels and this should be included in any correspondence or discussions.

In the U.S.A. telephone: toll free 1-877-266-4543.

Serious Incident Reporting:

Contact your local representative to report all product complaints and/or adverse events to Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. If the product is received in an unsatisfactory condition, please contact your local Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Sales Office immediately. Each component is identified by a lot number and this should be included in any correspondence or discussions. In the U.S.A. telephone: Toll free 1-877-266-4543.

Serious Incident Reporting (EU):

For a patient/user/third party in the European Union and in countries with identical regulatory regime; if, during the use of this device or as a result of its use, a serious incident has occurred, please report it to Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. and/or its authorised representative and to the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Symbol/Title (Explanation):

SYMBOL	TITLE (EXPLANATION)
	Consult instructions for use or consult electronic instructions for use
	Do not re-use
STERILE EO	Sterilized using ethylene oxide
REF	Catalogue number
LOT	Batch code
	Use-by date
	Manufacturer
EC REP	Authorized representative in the European Community/ European Union
	Do not resterilize
	Importer
UDI	Unique device identifier
CH REP	Authorized representative in Switzerland
	Date of manufacture
	Do not use if package is damaged and consult instructions for use
EC	European Community/European Union
CH	Switzerland
	Packaging unit
	Caution
	Single sterile barrier system
Rx only	Caution: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed healthcare practitioner.
	Open here
MD	Medical device
	Fragile, handle with care
	Keep dry
	This way up

Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Product of Mexico

Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
31 Technology Drive, Suite 200,
Irvine, CA 92618 USA

CE 2797

EC REP
EC
AMO Ireland
Block B
Liffey Valley Office Campus
Quarryvale, Co. Dublin, Ireland

CH REP
CH
AMO Switzerland GmbH
Gubelstrasse 34
6300 Zug
Switzerland

This document is valid only on the date printed. If unsure of the print date, please re-print to ensure use of the latest revision of the IFU (available at www.e-ifu.com). The onus resides with the user to ensure that the most up-to-date IFU is used.

℞ only

Introduktion/beskrivelse:
VERITAS Advanced Infusion-pakke eller VERITAS Advanced Fluidics-pakke er en DOBBELTPUMPE-pakke, der indeholder alle slangesæt og alt nødvendigt tilbehør til at foretage et indgreb med irrigation/aspiration (I/A) eller phacoemulsifikation. VERITAS Advanced Infusion-pakke indeholder en ekstra slange til at levere luft under tryk til kilden med irrigationsvæske. Hver pakke indeholder følgende:

1. Kassette- og slangeenhed
2. Afdækningsstykke til monitor
3. Afdækningsstykke til Mayo-stativ
4. Testkammer

Tilsigtet formål:
VERITAS Advanced Infusion-pakke eller VERITAS Advanced Fluidics-pakke indeholder kassette- og slangeenheden og er beregnet til at udføre irrigation/aspiration ved kataraktkirurgi i det anteriore segment. Den bruges sammen med VERITAS™ Vision-systemet. Testkammeret er beregnet til at verificere korrekt tilslutning og funktionalitet af irrigations-/aspirationsfunktionen inden det kirurgiske indgreb.

Produkttegninger:

VERITAS Advanced Fluidics-pakke

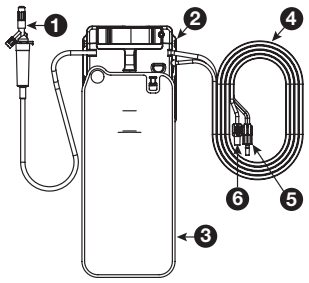

VERITAS Advanced Infusion-pakke



1. Irrigationsspids (til irrigationskilde)
2. Kassette
3. Dræningspose
4. I/A-slangesæt (til håndstykke)
5. Irrigations-Luer-Lock-kobling
6. Aspirationskobling

Kun VERITAS Advanced Infusion-pakke:
7. Infusionsslange
8. Infusionskonnektor (til konsol)

Indikationer/kontraindikationer/tilsigtet patient/tilsigtet bruger:
Alle relevante oplysninger vedrørende indikationer/kontraindikationer/tilsigtet patient/tilsigtet bruger er beskrevet i brugervejledningen til Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. phacoemulsifikationssystem ("brugervejledningen"). Kontraindikationer: Alle forudeksisterende forhold hos patienten, som lægen vurderer at være en kontraindikation for kataraktkirurgi. Tilsigtede patienter omfatter patienter med katarakter, som skal gennemgå øjenkirurgi i det anteriore segment (f.eks. fjernelse af den krystallinske linse). Bemærk: Gravide, ammende kvinder eller børn blev ikke medtaget i udførte kliniske forsøg. Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. phacoemulsifikationssystem er beregnet til at blive anvendt af en øjenlæge og understøttende personale, der arbejder under kirurgens ledelse.

Kliniske fordele/uønskede komplikationer/bivirkninger:
Alle relevante oplysninger om kliniske fordele/uønskede komplikationer/bivirkninger er beskrevet i brugervejledningen. De kliniske fordele ved Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. phacoemulsifikationssystem omfatter følgende: Hurtig rehabilitering af synet, tidlig genoptagelse af daglige aktiviteter, minimal okulær inflammation, minimal postoperativ astigmatisme, nedsat potentiale for okulære komplikationer. Komplikationer, der kan være forbundet med Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. phacoemulsifikationssystem, omfatter ødelagt kapsel, corneaforbrænding, infektion/inflammation og corneaødem.

Brugsanvisning:
Se anvisningerne nedenfor for oplysninger om korrekt montering af VERITAS-pakken. VERITAS Advanced Infusion-pakken har et ekstra trin som nævnt nedenfor. VERITAS Advanced Infusion-pakken kan kun bruges, hvis Avanceret infusion er valgt i programindstillinger inden operationen. For yderligere anvisninger henvises til brugervejledningen. Inden brug skal produktbakken inspiceres visuelt for brud på pakkens integritet. Brug ikke produktet, hvis pakkens integritet er kompromitteret.

1. Efter steril udtagning af alt indhold fra produktbakken forseglet med låg gives KASSETTEN og IRRIGATIONSSPIDSEN til den usterile sygeplejerske, og I/A-SLANGESÆTTET bevares i det sterile felt.
2. Læg afdækningsstykket til monitoren over monitoren på VERITAS Vision-systemet.
3. Placer hænderne i afdækningsstykket til Mayo-stativet i henhold til vejledningsmærkerne på afdækningen, og dæk VERITAS Vision-systemets bakkearm.
4. Indsæt KASSETTEN i VERITAS Vision-systemets væskepanel.
5. Skub KASSETTEN, indtil systemets låsemekanisme aktiveres, og KASSETTEN sidder helt fast.
6. Klargør kilden med irrigationsvæske.
7. Fjern beskyttelseshætten fra spidsen af IRRIGATIONSSPIDSEN.
8. Hold kilden lodret, og indfør IRRIGATIONSSPIDSEN i midten af gummiproppen uden at dreje den.
9. Hæng kilden op på dropstativet, og klem og slip derefter dråbekammeret, indtil det er 1/2 til 3/4 fuldt.
10. Kun for VERITAS Advanced Infusion-pakken: INFUSIONSSLANGEN har en sort INFUSIONSKONNEKTOR i den frie ende. Indsæt INFUSIONSKONNEKTOREN i sidepanelet på VERITAS Vision-systemet, og drej den derefter med uret, indtil den klikker, når den er helt tilsluttet.
11. For håndstykker uden en låsende irrigationsport skal kraven på IRRIGATIONS-LUER-LOCK-KOBLINGEN trækkes tilbage. Tilslut I/A-SLANGESÆTTETS Luer-koblinger til håndstykket. For håndstykker, der er udstyret med en låsende irrigationsport, skal kraven på IRRIGATIONS-LUER-LOCK-KOBLINGEN drejes med uret for at låse koblingen til håndstykket.
12. Fastgør spidsen og irrigationsmanchetten til håndstykket i henhold til monteringsvejledningen.
13. På PRIME/INDSTIL-skærmen på VERITAS Vision-systemet aktiveres kontinuerlig irrigation med håndstykkets spids nedad i et testkammer, der ikke er forseglet mod irrigationsmanchetten.
14. Fyld testkammeret med væske, indtil al luft er elimineret, og anbring testkammeret direkte og centreret over spidsen og irrigationsmanchetten, indtil det er forseglet.
15. Deaktiver kontinuerlig irrigation, og udfør primingsekvensen i henhold til brugervejledningen.

Generelt:
Enheden indeholder ikke ftalater.

Pakken er steriliseret med ethylenoxid og er designet til engangsbrug.

Produktet opbevares tørt og køligt.

Forholdsregler:
- Produktet må ikke anvendes efter den udløbsdato, der er angivet på produktets emballagemærkater.
- Indholdet er sterilt, når produktbakken er forseglet med låg og ubeskadiget.
- Hvis produktets ydeevne kompromitteres under brug, skal brugen stoppes og passende test udføres som beskrevet i systemets brugervejledning. Hvis resultaterne ikke er tilfredsstillende, udskiftes pakken i henhold til anvisningerne i brugervejledningen.

Dette dokument er kun gyldigt på den dato, det er udskrevet. Hvis der er usikkerhed om datoen for udskrivning, skal dokumentet udskrives igen for at sikre brug af den nyeste revision af brugsanvisningen (fås på www.e-ifu.com).
Det er brugerens ansvar at sikre, at den mest opdaterede brugsanvisning bruges.
Johnson & Johnson VISION

- Ved brug af VERITAS Advanced Infusion-pakke kan den effektive samlede højde af irrigationskilden ikke gå lavere end 30 cm, når Avanceret infusion er aktiveret.
- VERITAS Advanced Infusion-pakke kan bruges sammen med irrigationsvæske i en flaske eller pose, når en vellykket Prime/Indstil er fuldført. Det er ikke sikkert, at alle poser fuldfører Prime, hvilket kan medføre behandlingsforsinkelse.

Advarsel:

Kun til engangsbrug. Undgå at resterilisere, genklargøre eller genbruge dette udstyr.

Medicinsk udstyr til engangsbrug fra Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. er mærket med brugs- og håndteringsanvisninger for at minimere eksponering for forhold, der kan skade produktet, patienten eller brugeren. Resterilisering/genklargøring af medicinsk udstyr til engangsbrug fra Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. kan medføre fysiske skader på det medicinske udstyr, gøre at det medicinske udstyr ikke fungerer efter hensigten og påføre sygdom eller skader på patienten som følge af infektion, inflammation og/eller sygdom på grund af produktkontamination, overførsel af infektion og manglende produktsterilitet.

Bortskaffelse:

Alle VERITAS-pakker, der er kontamineret med blod, væv og/eller kropsvæsker/-materiale, skal håndteres som biofarligt medicinsk affald i henhold til sundhedsinstitutionens protokol og gældende lokale krav.

Hvis VERITAS-pakken modtages i utilfredsstillende stand, skal salgsafdelingen hos den lokale afdeling af Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. kontaktes omgående. Hver VERITAS-pakke har et lotnummer på produktets emballagemærkning, som skal inkluderes i al korrespondance og alle samtaler.

Telefonnummer i USA: gratisnummer 1-877-266-4543.

Rapportering af alvorlig hændelse:

Kontakt den lokale repræsentant for at indberette alle produktklager og/eller utilsigtede hændelser til Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Hvis produktet modtages i utilfredsstillende stand, skal du kontakte salgsafdelingen hos den lokale afdeling af Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. med det samme. Hver komponent har et lotnummer, som skal oplyses ved al korrespondance eller diskussion. Telefonnummer i USA: gratisnummer 1-877-266-4543.

Rapportering af alvorlig hændelse (EU):

For en patient/bruger/tredjepart i Den Europæiske Union og i lande med identiske regler: Hvis der under brugen af denne enhed eller som et resultat af dens anvendelse opstår en alvorlig hændelse, skal du rapportere den til Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. og/eller dennes autoriserede repræsentant og til den kompetente myndighed i medlemsstaten, hvor brugeren og/eller patienten er bosiddende.

Symbol/titel (forklaring):

SYMBOL	TITEL (FORKLARING)
	Se brugsanvisningen eller den elektroniske brugsanvisning
	Må ikke genbruges
	Steriliseret med ethylenoxid
	Katalognummer
	Batchkode
	Sidste anvendelsesdato
	Producent
	Autoriseret repræsentant i Det Europæiske Fællesskab/Den Europæiske Union

SYMBOL	TITEL (FORKLARING)
	Må ikke resteriliseres
	Importør
	Unikt udstyrs-id
	Autoriseret repræsentant i Schweiz
	Fremstillingsdato
	Må ikke bruges, hvis emballagen er beskadiget. Se brugsanvisningen
	Det Europæiske Fællesskab/Den Europæiske Union
	Schweiz
	Emballageenhed
	Forsigtig
	Enkelt sterilt barrieresystem
	Forsigtig: Ifølge amerikansk lovgivning må dette udstyr kun sælges af en læge eller efter lægeordination.
	Åbnes her
	Medicinsk udstyr
	Skrøbelig, skal håndteres med forsigtighed
	Skal holdes tør
	Denne side op

Forsigtig: Ifølge amerikansk lovgivning må dette udstyr kun sælges af en læge eller efter lægeordination.

Fremstillet i Mexico

Dette dokument er kun gyldigt på den dato, det er udskrevet. Hvis der er usikkerhed om datoen for udskrivning, skal dokumentet udskrives igen for at sikre brug af den nyeste revision af brugsanvisningen (fås på www.e-ifu.com).
Det er brugerens ansvar at sikre, at den mest opdaterede brugsanvisning bruges.

Johnson & Johnson VISION

℞ only

Inleiding/beschrijving:
Het VERITAS geavanceerd infuuspakket of VERITAS-pakket voor geavanceerd vochtbeheer is een DUBBELPOMP-pakket dat alle slangen en accessoires bevat die nodig zijn voor het uitvoeren van een irrigatie- en aspiratieprocedure of een faco-emulsificatieprocedure. Het VERITAS geavanceerd infuuspakket bevat een extra slang om perslucht naar de irrigatieoplossing te voeren. Elk pakket bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Cassette- en buiseenheid
2. Afdekdoek voor monitor
3. Afdekdoek voor Mayo-standaard
4. Testkamer

Beoogd doel:
Het VERITAS geavanceerd infuuspakket of VERITAS-pakket voor geavanceerd vochtbeheer bevat de cassette en slangassemblage en is bedoeld voor het uitvoeren van irrigatie en aspiratie tijdens een cataractoperatie van het voorsegment. Het wordt gebruikt met het VERITAS™ Vision-systeem. De testkamer is bedoeld om voorafgaand aan de chirurgische ingreep de juiste connectiviteit en functionaliteit van de irrigatie-/aspiratiefunctie te controleren.

Producttekeningen:

VERITAS-pakket voor geavanceerd vochtbeheer

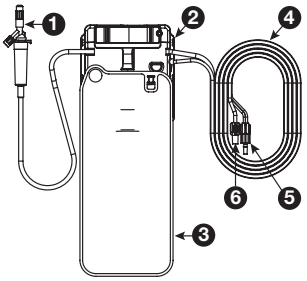

VERITAS geavanceerd infuuspakket

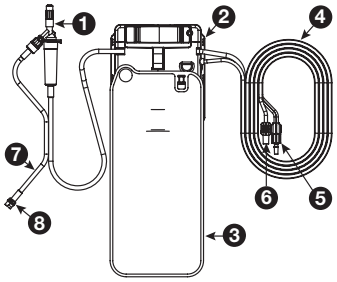

1. Irrigatiespike (naar irrigatiebron)
2. Cassette
3. Drainagezak
4. I/A-slang (naar handstuk)
5. Luer lock-fitting voor irrigatie
6. Aspiratiefitting

Alleen VERITAS geavanceerd infuuspakket:
7. Infuuslijn
8. Infuusconnector (naar console)

Indicaties/contra-indicaties/beoogde patiënt/beoogde gebruiker:
Alle relevante informatie met betrekking tot indicaties/contra-indicaties/beoogde patiënt/beoogde gebruiker is te vinden in de gebruikershandleiding voor het faco-emulsificatiesysteem van Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. ('Gebruikershandleiding'). Contra-indicaties: Eventuele bestaande aandoeningen van de patiënt die door de zorgverlener als contra-indicaties voor de cataractoperatie worden beschouwd. Tot de beoogde patiënten behoren volwassen patiënten met cataract en volwassen patiënten die een oogheelkundige operatie van het voorste oogsegment ondergaan (bijv. verwijdering van de natuurlijke lens). Opmerking: Er waren geen zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en kinderen ingesloten in de uitgevoerde klinische onderzoeken. Het faco-emulsificatiesysteem van Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. is bestemd voor gebruik door een oftalmoloog en ondersteunend personeel dat opereert onder leiding van de chirurg.

Klinische voordelen/ongewenste bijwerkingen/nadelige effecten:
Alle relevante informatie over klinische voordelen/ongewenste bijwerkingen/nadelige effecten is opgenomen in de gebruikershandleiding. Klinische voordelen van het faco-emulsificatiesysteem van Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. omvatten het volgende: snelle visuele revalidatie, vroegtijdige hervatting van dagelijkse activiteiten, minimale oogontsteking, minimaal postoperatief astigmatisme, verminderde kans op oogcomplicaties. Complicaties die mogelijk verband houden met het faco-emulsificatiesysteem van Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. zijn gebroken kapsel, verbranding van het hoornvlies, infectie/ontsteking en hoornvliesoedeem.

Gebruiksaanwijzing:
Lees onderstaande instructies voor de juiste installatie van het VERITAS-pakket. Het VERITAS geavanceerd infuuspakket heeft één extra stap, zoals hieronder aangegeven. Om het VERITAS geavanceerd infuuspakket te gebruiken, moet voorafgaand aan de operatie Geavanceerde infusie worden geselecteerd in Programma-instellingen. Zie de gebruikershandleiding voor aanvullende instructies. Controleer voor gebruik visueel of de productverpakking intact is. Gebruik het product niet als de verpakking beschadigd is.

1. Nadat alle inhoud steriel is verwijderd uit de met deksel afgesloten producttray, moet u de CASSETTE en de IRREGATIESPIKE aan de omloopverpleegkundige geven, terwijl u de I/A-SLANG in het steriele veld houdt.
2. Plaats de afdekdoek voor de monitor over de monitor op het VERITAS Vision-systeem.
3. Plaats uw handen in het afdekdoek voor de Mayo-standaard volgens de markeringen op het doek en bedek de arm van het VERITAS Vision-systeem.
4. Plaats de CASSETTE in het fluïdische paneel van het VERITAS Vision System.
5. Duw tegen de CASSETTE totdat het systeem het vergrendelingsmechanisme activeert om de CASSETTE vast te houden.
6. Bereid de bron van de irrigatieoplossing voor.
7. Verwijder de bescherming van de punt van de IRRIGATIESPIKE.
8. Houd de oplossing rechtop en steek de IRRIGATIESPIKE recht in het midden van de rubberen oplossingstop zonder te draaien.
9. Hang de oplossing aan de infuusstandaard en vul vervolgens de druppelkamer voor de helft tot driekwart door afwisselend te knijpen en los te laten.
10. Alleen voor VERITAS geavanceerd infuuspakket: De INFUSIELIJN heeft een zwarte INFUSIECONNECTOR aan het vrije uiteinde. Steek de INFUSIECONNECTOR in het zijpaneel van het VERITAS Vision-systeem en draai deze vervolgens met de klok mee totdat hij vastklikt wanneer hij volledig is aangesloten.
11. Voor handstukken zonder vergrendelende irrigatiepoort trekt u de kraag van de FITTING van de IRRIGATIE-LUERLOCK terug. Sluit de luer-fittingen van de I/A-SLANG aan op het handstuk. Bij handstukken die zijn uitgerust met een vergrendelende irrigatiepoort draait u de kraag op de FITTING van de IRRIGATIE-LUERLOCK met de klok mee om de aansluiting op het handstuk te vergrendelen.
12. Bevestig de tip en het irrigatiemanchet aan het handstuk volgens de montage-instructies.
13. Activeer continue irrigatie vanuit het scherm PRIMEN/TUNEN op het VERITAS Vision-systeem, terwijl u de tip van het handstuk naar beneden houdt gericht in een testkamer die niet tegen het irrigatiemanchet is afgedicht.
14. Vul de testkamer met vloeistof en verwijder alle lucht. Plaats de testkamer recht en gecentreerd over de tip en het irrigatiemanchet totdat deze is afgedicht.
15. Schakel Continue irrigatie uit en voer de primeprocedure uit volgens de gebruikershandleiding.

Algemeen:
Het hulpmiddel bevat geen ftalaten.

Het pakket is gesteriliseerd met ethyleenoxide en is ontworpen voor eenmalig gebruik.

Bewaar het product op een koele, droge plaats.

Dit document is alleen geldig op de afdrukdatum. Maak opnieuw een afdruk als de afdrukdatum niet duidelijk is, zodat u zeker weet dat u de laatste revisie van de gebruiksaanwijzing gebruikt (beschikbaar op www.e-ifu.com). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker dat gebruik wordt gemaakt van de meest recente versie van de gebruiksaanwijzing.

Johnson & Johnson VISION

Voorzorgsmaatregelen:

- Gebruik het product niet meer na de vervaldatum die op de etiketten van het product staat vermeld.
- De inhoud is steriel zolang de producttray afgesloten is met een deksel en onbeschadigd is.
- Als de productprestaties verminderen tijdens het gebruik, mag het systeem niet verder worden gebruikt en moeten de gepaste tests worden uitgevoerd, zoals beschreven in de gebruikershandleiding van het systeem. Als de resultaten niet voldoen, moet het pakket worden vervangen volgens de instructies in de gebruikershandleiding.
- Bij gebruik van het VERITAS geavanceerd infuuspakket mag de effectieve totale hoogte van de irrigatiebron niet lager zijn dan 30 cm wanneer geavanceerde infusie is geactiveerd.
- VERITAS geavanceerd infuuspakket kan worden gebruikt met irrigatieoplossing in een fles of zak nadat primen/tunen is voltooid. Niet alle zakken kunnen Primen met succes voltooien, wat kan leiden tot vertraging in de behandeling.

Waarschuwing:

Uitsluitend voor eenmalig gebruik. U mag dit hulpmiddel niet hersteriliseren, herverwerken of hergebruiken.

De medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik van Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. zijn voorzien van gebruiks- en hanteringsinstructies, waardoor de kans op blootstelling aan omstandigheden die nadelige gevolgen kunnen hebben voor het product, de patiënt of de gebruiker tot een minimum wordt beperkt. Het hersteriliseren/herverwerken van medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik van Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. kan leiden tot fysieke schade aan het medische hulpmiddel, het niet naar behoren functioneren van het medische hulpmiddel, ziekte van of letsel bij de patiënt als gevolg van infectie, ontsteking en/of ziekte als gevolg van productcontaminatie, overdraging van een infectie en onvoldoende sterilisatie van het product.

Afvoeren:

Een VERITAS-pakket dat is verontreinigd door bloed, weefsel en/of lichaamsvloeistoffen/-materie moet worden behandeld als risicohoudend medisch afval volgens het protocol van de medische instelling en de geldende lokale voorschriften.

Neem onmiddellijk contact op met de lokale verkoopvestiging van Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. als het VERITAS-pakket bij ontvangst niet in goede staat verkeert. Elk VERITAS-pakket wordt geïdentificeerd door een partijnummer op de verpakkingsetiketten van het product en moet bij alle correspondentie en in alle discussies worden vermeld.

Gratis telefoonnummer in de Verenigde Staten: 1-877-266-4543.

Melding van ernstige incidenten:

Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger om alle klachten en/of bijwerkingen van het product te melden bij Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Neem onmiddellijk contact op met de lokale verkoopafdeling van Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. als het product niet in goede staat is ontvangen. Elk onderdeel wordt geïdentificeerd door een partijnummer. Dit nummer moet bij alle correspondentie en in alle discussies worden vermeld. Gratis telefoonnummer in de Verenigde Staten: 1-877-266-4543.

Melding van ernstige incidenten (EU):

Patiënten/gebruikers/derden in de Europese Unie en landen waarin een identieke regelgeving wordt gehandhaafd, moeten ernstige incidenten die tijdens of als resultaat van het gebruik van dit hulpmiddel optreden rapporteren aan Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. en/of de bevoegde vertegenwoordiger en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

Symbool/Titel (uitleg):

SYMBOOL	TITEL (UITLEG)
	Raadpleeg de (elektronische) gebruiksaanwijzing
	Niet hergebruiken
	Gesteriliseerd met ethyleenoxide
	Catalogusnummer
	Partijnummer
	Vervaldatum
	Fabrikant
	Gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap/Europese Unie
	Niet opnieuw steriliseren
	Importeur
	Unieke hulpmiddelidentificatie
	Gemachtigde vertegenwoordiger in Zwitserland
	Fabricagedatum
	Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd en raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Europese Gemeenschap/Europese Unie
	Zwitserland
	Verpakkingseenheid
	Let op
	Enkel systeem met steriele barrière
	Let op: Volgens de Amerikaanse federale wetgeving mag dit hulpmiddel uitsluitend door of op voorschrift van een bevoegde zorgverlener worden verkocht.
	Hier openen
	Medisch hulpmiddel
	Breekbaar, voorzichtig hanteren
	Droog houden
	Deze kant omhoog

Let op: Krachtens de federale wetgeving van de Verenigde Staten mag dit hulpmiddel uitsluitend door of op voorschrift van een arts worden verkocht.

Product uit Mexico

Dit document is alleen geldig op de afdrukdatum. Maak opnieuw een afdruk als de afdrukdatum niet duidelijk is, zodat u zeker weet dat u de laatste revisie van de gebruiksaanwijzing gebruikt (beschikbaar op www.e-ifu.com). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker dat gebruik wordt gemaakt van de meest recente versie van de gebruiksaanwijzing.

Johnson & Johnson VISION

℞ only

Johdanto/kuvaus:
VERITAS kehittynyt infuusiosarja ja VERITAS kehittynyt nesteenantosarja ovat KAKSOISPUMPPUsarjoja, jotka sisältävät kaikki letkusarjat ja lisävarusteet, joita tarvitaan huuhtelu- ja aspiraatiotoimenpiteeseen tai fakoemulsifikaatiotoimenpiteeseen. VERITAS kehittynyt infuusiosarja sisältää lisäksi paineilman syöttöletkun huuhtelunestelähdettä varten. Kumpikin sarja sisältää seuraavat tarvikkeet:

1. kasetti ja letkukokoonpano
2. monitorin peiteliina
3. Mayo-telineen peiteliina
4. testikammio.

Käyttötarkoitus:
VERITAS kehittynyt infuusiosarja ja VERITAS kehittynyt nesteenantosarja sisältävät kasetin ja letkukokoonpanon. Nämä tuotteet on tarkoitettu huuhteluun ja aspiraatioon silmän etuosan kaihileikkauksessa. Niitä käytetään VERITAS™ Vision -järjestelmän kanssa. Testikammio on tarkoitettu huuhtelu-/aspiraatiotoiminnon asianmukaisten liitäntöjen ja oikeanlaisen toiminnan varmistamiseen ennen leikkausta.

Tuotepiirustukset:

VERITAS kehittynyt nesteenantosarja

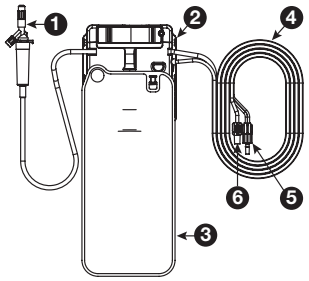

VERITAS kehittynyt infuusiosarja

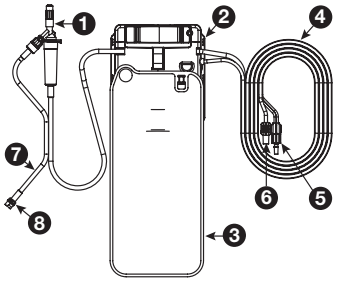

1. Huuhtelupiikki (huuhtelulähteeseen)
2. Kasetti
3. Dreenipussi
4. Huuhtelu- ja aspiraatioletkut (käsikappaleeseen)
5. Huuhtelu-luer-lock-liitin
6. Aspiraatioliitin

Koskee vain VERITAS kehittynyttä infuusiosarjaa:
7. Infuusioletku
8. Infuusioliitin (konsoliin)

Käyttöaiheet / vasta-aiheet / suunniteltu potilas / suunniteltu käyttäjä:
Kaikki käyttöaiheita / vasta-aiheita / suunniteltua potilasta / suunniteltua käyttäjää koskevat merkitykselliset tiedot on annettu Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. -yhtiön fakoemulsifikaatiojärjestelmän käyttöoppaassa (”käyttöopas”). Vasta-aiheet: Vasta-aiheita ovat kaikki potilaan olemassa olevat sairaudet, jotka terveydenhuoltopalvelujen tarjoaja katsoo kaihileikkauksen vasta-aiheiksi. Suunniteltuja potilaita ovat aikuispotilaat, joilla on kaihi tai joille tehdään silmän etuosan leikkaus (esim. mykiön poisto). Huomautus: Tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa ei ollut mukana raskaana olevia tai imettäviä naisia eikä lapsia. Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. -yhtiön fakoemulsifikaatiojärjestelmä on tarkoitettu kirurgin ohjauksessa toimivan silmälääkärin ja tukihenkilökunnan käyttöön.

Kliiniset hyödyt / ei-toivotut sivuvaikutukset / haittavaikutukset:
Kaikki kliinisiä hyötyjä/ei-toivottuja sivuvaikutuksia/haittavaikutuksia koskevat merkitykselliset tiedot on annettu käyttöoppaassa. Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. -yhtiön fakoemulsifikaatiojärjestelmällä on seuraavia kliinisiä hyötyjä: näkökyvyn nopea palautuminen, nopea paluu päivittäisiin toimiin, minimaalinen silmätulehdus, minimaalinen toimenpiteen jälkeinen hajataitto sekä pienentynyt silmäkomplikaatioiden riski. Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. -yhtiön fakoemulsifikaatiojärjestelmään mahdollisesti liittyviä komplikaatioita ovat kapselin rikkoutuminen, sarveiskalvon palovamma, infektio/tulehdus ja sarveiskalvon turvotus.

Käyttöohjeet:
Katso seuraavista ohjeista, kuinka VERITAS-sarja asennetaan oikein. VERITAS kehittyneen infuusiosarjan käytössä on yksi ylimääräinen vaihe, joka on kuvattu jäljempänä. Jotta VERITAS kehittynyttä infuusiosarjaa voi käyttää, ohjelma-asetuksista on valittava ennen leikkausta kohta Kehittynyt infuusio. Lisätietoja on käyttöoppaassa. Tarkasta tuotetarjotin silmämääräisesti ennen käyttöä pakkauksen eheyden vaarantumisen varalta. Älä käytä tuotetta, jos pakkauksen eheys on vaarantunut.

1. Kun olet ottanut steriilisti kaikki tarvikkeet kannella suljetulta tuotetarjottimelta, ojenna KASETTI ja HUUHTELUPIIKKI valvovalle hoitajalle siten, että HUUHTELU- JA ASPIRAATIOLETKUT pysyvät steriilillä alueella.
2. Peitä VERITAS Vision -järjestelmän monitori monitorin peiteliinalla.
3. Aseta kädet Mayo-telineen peiteliinan sisään siinä olevien ohjausmerkkien mukaan ja peitä VERITAS Vision -järjestelmän tarjottimen varsi.
4. Työnnä KASETTI VERITAS Vision -järjestelmän nestepaneeliin.
5. Työnnä KASETTIA, kunnes järjestelmän salpamekanismi aktivoituu pitämään KASETIN paikoillaan.
6. Valmistele huuhtelunestelähde.
7. Poista HUUHTELUPIIKIN kärkisuojus.
8. Pidä lähde pystysuorassa ja työnnä HUUHTELUPIIKKI lähteen kumitulpan keskeltä sisään ilman kiertoliikettä.
9. Ripusta lähde tippatelineeseen ja puristele tippakammiota, kunnes 1/2–3/4 siitä on täyttynyt.
10. Koskee vain VERITAS kehittynyttä infuusiosarjaa: INFUUSIOLETKUN vapaassa päässä on musta INFUUSIOLIITIN. Työnnä INFUUSIOLIITIN VERITAS Vision -järjestelmän sivupaneeliin ja kierrä sitä sitten myötäpäivään, kunnes se naksahtaa merkiksi siitä, että se on kunnolla liitetty.
11. Jos käsikappaleessa ei ole lukittuvaa huuhteluliitäntää, vedä HUUHTELU-LUER-LOCK-LIITTIMEN laippaa taaksepäin. Liitä HUUHTELU- JA ASPIRAATIOLETKUN luer-liittimet käsikappaleeseen. Jos käsikappaleessa on lukittuva huuhteluliitäntä, lukitse lukitusliitin käsikappaleeseen kääntämällä HUUHTELU-LUER-LOCK-LIITTIMEN laippaa myötäpäivään.
12. Kiinnitä kärki ja huuhteluholkki käsikappaleeseen kokoamisohjeiden mukaan.
13. Aktivoi VERITAS Vision -järjestelmän ESITÄYTTÖ/VIRITYS-näytöstä kohta Jatkuva huuhtelu. Pidä käsikappaletta siten, että sen kärki osoittaa alaspäin testikammiossa, joka on auki huuhteluholkin suuntaan.
14. Täytä testikammio nesteellä niin, että se syrjäyttää kaiken ilman. Työnnä testikammio suoraan keskitetysti kärjen ja huuhteluholkin päälle, kunnes liitos on tiivis.
15. Ota jatkuva huuhtelu pois käytöstä ja suorita esitäyttö käyttöoppaan ohjeiden mukaan.

Yleistä:
Tämä laite ei sisällä ftalaatteja.

Tämä kertakäyttöön tarkoitettu sarja on steriloitu etyleenioksidilla.

Säilytä tuotetta viileässä ja kuivassa paikassa.

Varotoimet:
- Älä käytä tuotetta sen myyntipäällykseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
- Sisältö on steriiliä, kun tuotetarjotin on suljettu kannella ja ehjä.
- Jos tuotteen suorituskyky vaarantuu käytön aikana, lopeta käyttö ja tee asianmukaiset testit järjestelmän käyttöoppaassa kuvatulla tavalla. Jos tulokset eivät ole tyydyttäviä, vaihda sarja käyttöoppaan ohjeiden mukaan.
- Kun VERITAS kehittynyttä infuusiosarjaa käytetään Kehittynyt infuusio -valinta aktivoituna, huuhtelulähteen tehollisen kokonaiskorkeuden on oltava vähintään 30 cm.
- VERITAS kehittynyttä infuusiosarjaa saa käyttää pulloon tai pussiin pakatun huuhtelunesteen kanssa sen jälkeen, kun esitäyttö/viritys on saatettu onnistuneesti loppuun. Kaikkien pussien esitäyttö ei ehkä onnistu, jolloin hoito voi viivästyä.

Tämä asiakirja on voimassa vain tulostuspäivämääränä. Jos et ole varma tulostuspäivämäärästä, tulosta asiakirja uudelleen, jotta käytät varmasti käyttöohjeiden uusinta versiota (saatavilla sivustosta www.e-ifu.com). Käyttäjä vastaa siitä, että käytössä on käyttöohjeiden ajantasaisin versio.

Johnson & Johnson VISION

Varoitus:
Vain kertakäyttöön. Tätä laitetta ei saa steriloida, käsitellä tai käyttää uudestaan.

Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. -yhtiön kertakäyttöisiin lääkinnällisiin laitteisiin on merkitty käyttö- ja käsittelyohjeet, joilla pyritään minimoimaan altistuminen olosuhteille, jotka voivat vaarantaa tuotteen, potilaan tai käyttäjän. Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. -yhtiön kertakäyttöisten lääkinnällisten laitteiden uudelleensterilointi/-käsittely voi aiheuttaa laitteelle vaurioita tai toimintahäiriöitä tai potilaalle infektiosta tai tulehduksesta johtuvan sairauden tai vamman ja/tai tuotteen kontaminoitumisesta, infektiotartunnasta ja/tai tuotteen puutteellisesta steriiliydestä johtuvan sairauden.

Hävittäminen:
Veren, kudoksen ja/tai ruumiinnesteiden/-aineksen kontaminoimaa VERITAS-sarjaa on käsiteltävä biovaarallisena lääkinnällisenä jätteenä terveydenhuoltolaitoksen käytännön ja sovellettavien paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Jos VERITAS-sarja toimitetaan epätyydyttävässä kunnossa, ota heti yhteys Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. -yhtiön paikalliseen myyntitoimistoon. Kunkin VERITAS-sarjan myyntipäällykseen on merkitty eränumero, joka on ilmoitettava aina kirjeenvaihdon tai keskustelun yhteydessä.

Puhelinnumero Yhdysvalloissa: 1-877-266-4543 (maksuton).

Vakavasta vaaratilanteesta ilmoittaminen:
Ilmoita kaikki tuotevalitukset ja/tai haittatapahtumat Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. -yhtiön paikalliselle edustajalle. Jos tuote toimitetaan epätyydyttävässä kunnossa, ota heti yhteyttä Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. -yhtiön paikalliseen myyntitoimistoon. Kuhunkin osaan on merkitty eränumero, joka on ilmoitettava aina kirjeenvaihdon tai keskustelun yhteydessä. Puhelinnumero Yhdysvalloissa: 1-877-266-4543 (maksuton).

Vakavasta vaaratilanteesta ilmoittaminen (EU):
Potilaat / käyttäjät / kolmannet osapuolet Euroopan unionissa ja maissa, joissa on identtinen sääntelyjärjestelmä: jos tämän laitteen käytön aikana tai sen seurauksena ilmenee vakava vaaratilanne, ilmoita siitä Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. -yhtiölle ja/tai sen valtuutetulle edustajalle sekä sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on käyttäjän ja/tai potilaan asuinmaa.

Symboli/merkitys (selite):

SYMBOLI	MERKITYS (SELITE)
	Tutustu käyttöohjeisiin tai tutustu sähköisiin käyttöohjeisiin
	Ei saa käyttää uudelleen
STERILE EO	Steriloitu etyleenioksidilla
REF	Luettelonumero
LOT	Eräkoodi
	Viimeinen käyttöpäivämäärä
	Valmistaja
EC REP	Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä / Euroopan unionissa
	Ei saa steriloida uudelleen
	Maahantuoja
UDI	Yksilöllinen laitetunniste
CH REP	Valtuutettu edustaja Sveitsissä

SYMBOLI	MERKITYS (SELITE)
	Valmistuspäivämäärä
	Ei saa käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut. Katso käyttöohjeet.
EC	Euroopan yhteisö / Euroopan unioni
CH	Sveitsi
	Pakkausyksikkö
	Huomio
	Yksinkertainen steriilisulkujärjestelmä
Rx only	Huomio: Yhdysvaltain liittovaltion laki sallii tämän laitteen myynnin vain laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta tai määräyksestä.
	Avaa tästä
MD	Lääkinnällinen laite
	Särkyvä, käsittele varoen
	Pidä kuivana
	Tämä puoli ylöspäin

Huomio: Yhdysvaltain liittovaltion laki sallii tämän laitteen myynnin vain lääkärin toimesta tai määräyksestä.

Valmistettu Meksikossa

Tämä asiakirja on voimassa vain tulostuspäivämääränä. Jos et ole varma tulostuspäivämäärästä, tulosta asiakirja uudelleen, jotta käytät varmasti käyttöohjeiden uusinta versiota (saatavilla sivustosta www.e-ifu.com). Käyttäjä vastaa siitä, että käytössä on käyttöohjeiden ajantasaisin versio.

℞ only

Introduction/description :
Le pack de perfusion avancée VERITAS ou le pack de gestion fluidique avancée VERITAS est un pack DOUBLE POMPE qui fournit toutes les tubulures et les accessoires nécessaires pour réaliser une procédure d'irrigation et d'aspiration ou une procédure de phacoémulsification. Le pack de perfusion avancée VERITAS contient une ligne de tubulure supplémentaire pour injecter de l'air comprimé dans la source de solution d'irrigation. Chaque pack comprend les éléments suivants :

1. Ensemble cassette et tubulures
2. Champ stérile du moniteur
3. Champ stérile du support de Mayo
4. Chambre de test

Usage prévu :
Le pack de perfusion avancée VERITAS ou le pack de gestion fluidique avancée VERITAS contient l'ensemble cassette et tubulures et il a pour fonction d'assurer l'irrigation et l'aspiration durant la chirurgie de la cataracte réparatrice du segment antérieur. Il est utilisé avec le système VERITAS™ Vision. La chambre de test est destinée à vérifier la connectivité et la fonctionnalité adéquates de la fonction d'irrigation/d'aspiration avant l'intervention chirurgicale.

Schémas du produit :

Pack de gestion fluidique avancée VERITAS

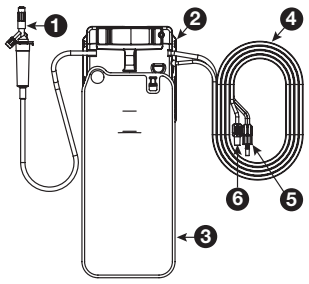

Pack de perfusion avancée VERITAS



1. Perforateur d'irrigation (vers la source d'irrigation)
2. Cassette
3. Poche de drainage
4. Jeu de tubulures I/A (vers la pièce à main)
5. Raccord Luer Lock d'irrigation
6. Raccord d'aspiration

Pour le pack de perfusion avancée VERITAS uniquement :

7. Ligne de perfusion
8. Raccord de perfusion (vers la console)

Indications/Contre-indications/Patient ciblé/Utilisateur ciblé :
Toutes les informations pertinentes relatives aux indications/contre-indications/patient ciblé/utilisateur ciblé sont décrites dans le manuel d'utilisation du système de phacoémulsification (« Manuel d'utilisation ») de Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Contre-indications : toutes les pathologies préexistantes du patient que le professionnel de santé détermine comme étant des contre-indications à la chirurgie de la cataracte. Les patients ciblés incluent les patients adultes présentant des cataractes ou subissant une chirurgie ophtalmique du segment antérieur (p. ex., ablation du cristallin). Remarque : aucune femme enceinte ou allaitante ni aucun enfant n'a été inclus dans le ou les essais cliniques conduits. Le système de phacoémulsification Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. est destiné à être utilisé par un ophtalmologiste et ses aides opératoires sous la houlette du chirurgien.

Bénéfices cliniques/Effets secondaires indésirables/Effets indésirables :
Toutes les informations pertinentes relatives aux bénéfices cliniques/effets secondaires indésirables/effets indésirables sont décrites dans le manuel d'utilisation. Les bénéfices cliniques du système de phacoémulsification Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. sont les suivants : rééducation visuelle rapide, reprise rapide des activités quotidiennes, inflammation oculaire minime, astigmatisme postopératoire minime, diminution potentielle des complications oculaires. Les complications susceptibles d'être associées au système de phacoémulsification Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. comprennent la rupture de la capsule, des brûlures de la cornée, une infection/inflammation et un œdème cornéen.

Mode d'emploi :
Veuillez vous référer aux instructions suivantes pour savoir comment installer correctement le pack VERITAS. Le pack de perfusion avancée VERITAS comporte une étape supplémentaire, comme indiqué ci-dessous. Pour pouvoir utiliser le pack de perfusion avancée VERITAS, sélectionner Perfusion avancée dans les paramètres du programme avant la chirurgie. Pour plus d'instructions, consulter le manuel d'utilisation. Avant utilisation, inspecter visuellement le plateau du produit pour vérifier l'intégrité de l'emballage. Ne pas utiliser le produit si l'intégrité de l'emballage a été altérée.

1. Après avoir retiré dans des conditions stériles l'intégralité du contenu du plateau de produit scellé par un couvercle, remettre la CASSETTE et le PERFORATEUR D'IRRIGATION à l'infirmière instrumentiste tout en conservant le JEU DE TUBULURES D'IRRIGATION ET D'ASPIRATION (I/A) dans le champ stérile.
2. Placer le champ stérile du moniteur sur le moniteur du système VERITAS Vision.
3. Placer les mains dans le champ stérile du support Mayo en suivant les repères sur le champ et recouvrir le bras du plateau du système VERITAS Vision.
4. Insérer la CASSETTE dans le panneau de solutions fluidiques du système VERITAS Vision.
5. Pousser la CASSETTE jusqu'à ce que le système active le mécanisme de verrouillage permettant de maintenir la CASSETTE.
6. Préparer la source de solution d'irrigation.
7. Retirer la protection de la pointe du PERFORATEUR D'IRRIGATION.
8. En plaçant la source à la verticale, insérer le PERFORATEUR D'IRRIGATION directement au centre du bouchon en caoutchouc de la source, sans le tourner.
9. Accrocher le flacon à la potence pour intraveineuse, puis serrer et relâcher la chambre compte-gouttes jusqu'à ce qu'elle soit remplie à moitié ou aux trois quarts.
10. Pour le pack de perfusion avancée VERITAS uniquement : La LIGNE DE PERFUSION est munie d'un RACCORD DE PERFUSION noir à son extrémité libre. Introduire le RACCORD DE PERFUSION dans le panneau latéral du système VERITAS Vision avant de le tourner dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'encliquette une fois parfaitement raccordé.
11. Pour les pièces à main sans orifice d'irrigation verrouillable, rétracter le collier sur le RACCORD LUER LOCK D'IRRIGATION. Relier les raccords Luer du JEU DE TUBULURES I/A à la pièce à main. Pour les pièces à main équipées d'un orifice d'irrigation verrouillable, tourner le collier sur le RACCORD LUER LOCK D'IRRIGATION dans le sens horaire pour verrouiller le raccord sur la pièce à main.
12. Fixer l'embout et le manchon d'irrigation à la pièce à main conformément aux instructions d'assemblage.
13. Depuis l'écran AMORÇAGE/RÉGLAGE du système VERITAS Vision, activer Irrigation continue avec l'embout de la pièce à main orienté vers le bas dans une chambre de test non scellée, contre le manchon d'irrigation.
14. Remplir la chambre de test de liquide en éliminant tout l'air et l'insérer en ligne droite et centrée sur l'embout et le manchon d'irrigation jusqu'à ce qu'elle soit étanche.
15. Désactiver l'irrigation continue et exécuter la séquence d'amorçage conformément au manuel d'utilisation.

Généralités :
Le dispositif ne contient pas de phtalates.

Conçu pour un usage unique, le pack est stérilisé à l'oxyde d'éthylène.

Conserver le produit dans un endroit frais et sec.

Ce document n'est valable qu'à sa date d'impression. Si vous n'êtes pas certain de la date d'impression, réimprimez le document pour vous assurer d'utiliser la dernière révision du mode d'emploi (disponible sur le site www.e-ifu.com). Il revient à l'utilisateur de s'assurer qu'il utilise la dernière version du mode d'emploi.

Johnson & Johnson VISION

Z311979E B

Précautions :

- Ne pas utiliser le produit après la date d'expiration indiquée sur les étiquettes d'emballage du produit.
- Le contenu est stérile lorsque le plateau est scellé et intact.
- Si la performance du produit est compromise pendant l'utilisation, cesser de l'utiliser et procéder aux tests appropriés selon les indications du manuel d'utilisation du système. Si les résultats ne sont pas satisfaisants, remplacer le pack selon les instructions définies dans le manuel d'utilisation.
- Lors de l'utilisation du pack de perfusion avancée VERITAS, la hauteur effective de la source d'irrigation ne peut pas être inférieure à 30 cm une fois la fonction Perfusion avancée activée.
- Le pack de perfusion avancée VERITAS ne peut être utilisé qu'avec un flacon ou une poche de solution d'irrigation après la réussite d'un cycle d'amorçage/de réglage. Il se peut que certaines poches ne parviennent pas à effectuer correctement la phase d'amorçage, ce qui peut entraîner un retard de traitement.

Avertissement :
À usage unique. Ne pas restériliser, retraiter ou réutiliser ce dispositif.

L'étiquette apposée sur les dispositifs médicaux à usage unique Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. contient des instructions d'emploi et de manipulation destinées à réduire l'exposition à toute condition susceptible de compromettre le produit, le patient ou l'utilisateur. La restérilisation ou le retraitement des dispositifs médicaux à usage unique de Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. peut provoquer la détérioration physique du dispositif médical, l'incapacité du dispositif médical à fonctionner comme prévu et une maladie ou une blessure du patient dues à une infection, une inflammation et/ou une maladie consécutives à une contamination du produit, la transmission d'infections et un manque de stérilité du produit.

Mise au rebut :
Les packs VERITAS qui ont été contaminés par du sang, des tissus et/ou des fluides/matières biologiques doivent être traités comme des déchets d'activités de soins à risques infectieux conformément au protocole de l'établissement de santé et aux exigences locales applicables.

Si l'état du pack VERITAS réceptionné n'est pas satisfaisant, veuillez contacter immédiatement le bureau commercial Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. local. Chaque pack VERITAS est identifié par un numéro de lot sur les étiquettes d'emballage du produit, qui doit être mentionné dans toute correspondance ou conversation.

Aux États-Unis, numéro de téléphone gratuit : 1-877-266-4543.

Déclaration d'incidents graves :
Contacter votre représentant local pour signaler à Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. toute réclamation concernant le produit et/ou tout événement indésirable lié au produit. Si le produit est reçu dans un état non satisfaisant, contacter immédiatement le revendeur Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. local. Chacun des composants est identifié par un numéro de lot qui doit être cité en référence dans toute correspondance ou conversation. Aux États-Unis, numéro de téléphone gratuit : 1-877-266-4543.

Signalement des incidents graves (UE) :
Pour un patient, un utilisateur ou une tierce personne dans l'Union européenne et dans les pays dotés d'un régime de réglementation identique : si, au cours de l'utilisation de ce dispositif ou en raison de son utilisation, un incident grave s'est produit, le signaler à Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. et/ou à son représentant autorisé ainsi qu'aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient sont établis.

Symbole/Titre (explication) :

SYMBOLE	TITRE (EXPLICATION)
	Consulter le mode d'emploi ou consulter le mode d'emploi électronique
	Ne pas réutiliser
	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
	Référence catalogue
	Code de lot
	Date limite d'utilisation
	Fabricant
	Représentant agréé au sein de la Communauté/l'Union européenne
	Ne pas restériliser
	Importateur
	Identifiant unique du dispositif
	Représentant agréé en Suisse
	Date de fabrication
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et consulter le mode d'emploi
	Communauté européenne/Union européenne
	Suisse
	Unité de conditionnement
	Attention
	Système de barrière stérile unique
	Attention : selon la législation fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu que par un médecin ou sur ordonnance médicale délivrée par un praticien agréé.
	Ouvrir ici
	Dispositif médical
	Fragile, manipuler avec précaution
	Conserver au sec
	Vers le haut

Attention : la loi fédérale (États-Unis) limite l'achat de ce dispositif par ou sur prescription d'un médecin.

Produit du Mexique

Ce document n'est valable qu'à sa date d'impression. Si vous n'êtes pas certain de la date d'impression, réimprimez le document pour vous assurer d'utiliser la dernière révision du mode d'emploi (disponible sur le site www.e-ifu.com). Il revient à l'utilisateur de s'assurer qu'il utilise la dernière version du mode d'emploi.

℞ only

Einleitung/Beschreibung:
Das VERITAS Fortschrittliche Infusions-Pack oder VERITAS Fortschrittliche Fluidik-Pack ist ein DOPPELPUMPEN-Pack, das alle Schläuche und Zubehörteile enthält, die für die Durchführung eines Irrigations- und Aspirationsverfahrens oder einer Phakoemulsifikation erforderlich sind. Das VERITAS Fortschrittliche Infusions-Pack enthält eine zusätzliche Schlauchleitung, um die Quelle der Irrigationslösung mit Druckluft zu versorgen. Jedes Pack besteht aus folgenden Komponenten:

1. Kassetten- und Schlauch-Baugruppe
2. Monitorabdecktuch
3. Abdecktuch für Mayo-Beistelltisch
4. Testkammer

Verwendungszweck:
Das VERITAS Fortschrittliche Infusions-Pack oder VERITAS Fortschrittliche Fluidik-Pack enthält die Kassetten- und Schlauch-Baugruppe und ist für die Irrigation und Aspiration bei operativen Eingriffen am vorderen Augenabschnitt (Katarakt) vorgesehen. Es wird mit dem VERITAS™ Vision System verwendet. Die Testkammer dient dazu, vor dem chirurgischen Eingriff die korrekte Konnektivität und Funktionalität der Irrigations-/Aspirationsfunktion zu überprüfen.

Produktzeichnungen:

VERITAS Fortschrittliches Fluidik-Pack

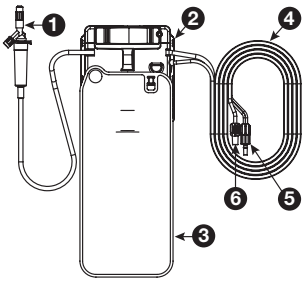

VERITAS Fortschrittliches Infusions-Pack



1. Irrigationsdorn (Zur Irrigationsquelle)
2. Kassette
3. Drainagebeutel
4. Irrigations-/Aspirations-Schlauchset (zum Handstück)
5. Spül-Luer-Lock-Anschluss
6. Aspirationsanschluss

Nur für das VERITAS Fortschrittliche Infusions-Pack:
7. Infusionsschlauch
8. Infusionsanschluss (Zur Konsole)

Indikationen/Kontraindikationen/vorgesehene Patienten/vorgesehene Anwender:
Alle relevanten Informationen zu Indikationen/Kontraindikationen/vorgesehener Patientenpopulation/vorgesehenen Anwendern sind dem Bedienerhandbuch zum Phakoemulsifikationssystem von Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. („Bedienerhandbuch“) zu entnehmen. Kontraindikationen: Jegliche bereits bestehende Erkrankungen beim Patienten, aufgrund derer nach ärztlichem Ermessen eine Kataraktoperation kontraindiziert ist. Zur Patientenzielgruppe gehören erwachsene Patienten mit Katarakt oder erwachsene Patienten, die sich einer ophthalmologischen Vordersegment-Operation (z. B. Linsenentfernung) unterziehen. Hinweis: Es wurden keine klinischen Studien bei schwangeren oder stillenden Frauen und bei Kindern durchgeführt. Das Phakoemulsifikationssystem von Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. ist für die Verwendung durch Augenärzte und Hilfspersonal vorgesehen, das unter Anleitung des Chirurgen operiert.

Klinischer Nutzen/Unerwünschte Nebenwirkungen/Unerwünschte Wirkungen:
Alle relevanten Informationen zum klinischen Nutzen/unerwünschten Nebenwirkungen/unerwünschten Wirkungen sind im Benutzerhandbuch beschrieben. Zum klinischen Nutzen des Phakoemulsifikationssystems von Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. gehören: rasche visuelle Rehabilitation, frühzeitige Wiederaufnahme der Alltagsaktivitäten, minimale okuläre Entzündung, minimaler postoperativer Astigmatismus, geringeres Risiko für okuläre Komplikationen. Zu den möglicherweise in Zusammenhang mit dem Phakoemulsifikationssystem von Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. auftretenden Komplikationen gehören: Kapselschädigung, Verbrennung der Hornhaut, Infektion/Entzündung, Hornhautödem.

Gebrauchsanweisung:
Beachten Sie die folgenden Anweisungen für die sachgemäße Installation des VERITAS-Packs. Das VERITAS Fortschrittliche Infusions-Pack hat einen zusätzlichen Schritt, wie unten beschrieben. Um das VERITAS Fortschrittliche Infusions-Pack verwenden zu können, muss die Option „Erweiterte Infusion“ in den Programmeinstellungen vor der Operation ausgewählt werden. Weitere Informationen finden Sie im Bedienerhandbuch. Vor dem Gebrauch die Produktschale auf Unversehrtheit der Verpackung überprüfen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist.

1. Geben Sie nach der sterilen Entnahme des gesamten Inhalts aus der mit einem Deckel versiegelten Produktschale die KASSETTE und den IRRIGIATIONSDORN an die OP-Schwester/den OP-Pfleger und achten Sie darauf, dass die IRRIGATIONS-/ASPIRATIONSCHLÄUCHE dabei im sterilen Feld bleiben.
2. Platzieren Sie das Monitorabdecktuch über dem Monitor des VERITAS Vision Systems.
3. Positionieren Sie die Hände gemäß den Führungsmarkierungen auf der Abdeckung auf dem Abdecktuch für den Mayo-Beistelltisch und bedecken Sie den Tray-Arm des VERITAS Vision Systems.
4. Setzen Sie die KASSETTE in das Flüssigkeitsfach des VERITAS Vision Systems ein.
5. Schieben Sie die KASSETTE hinein, bis das System den Verschlussmechanismus aktiviert, um die KASSETTE zu halten.
6. Bereiten Sie die Quelle der Irrigationslösung vor.
7. Entfernen Sie den Schutz von der Spitze des IRRIGATIONSDORNS.
8. Stechen Sie bei aufrecht gehaltener Quelle den IRRIGATIONSDORN in die Mitte des Gummistopfens, ohne ihn zu drehen.
9. Hängen Sie die Quelle an die IV-Stange, drücken Sie dann die Tropfkammer zusammen und lassen Sie sie los, bis sie zu 1/2 bis 3/4 gefüllt ist.
10. Nur für das VERITAS Fortschrittliche Infusions-Pack: Der INFUSIONSSCHLAUCH hat am freien Ende einen schwarzen INFUSIONSANSCHLUSS. Setzen Sie den INFUSIONSANSCHLUSS in die Seitenwand des VERITAS Vision Systems ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
11. Bei Handstücken ohne verriegelbaren Spülanschluss die Manschette des SPÜL-LUER-LOCK-Anschlusses zurückziehen. Schließen Sie die Luer-Anschlüsse der IRRIGATIONS-/ASPIRATIONSSCHLÄUCHE an das Handstück an. Bei Handstücken, die mit einem verriegelbaren Spülanschluss ausgestattet sind, die Manschette am SPÜL-LUER-LOCK-ANSCHLUSS im Uhrzeigersinn drehen, um den Anschluss am Handstück zu arretieren.
12. Die Nadel und die Irrigationshülse gemäß den Anweisungen zum Zusammenbau am Handstück befestigen.
13. Aktivieren Sie auf dem Bildschirm FÜLLEN/ABSTIMMEN des VERITAS Vision Systems die Option „Kontinuierliche Irrigation“. Die Handstückspitze zeigt dabei nach unten in eine Testkammer, die nicht gegen die Irrigationshülse abgedichtet ist.
14. Füllen Sie die Testkammer, sodass die Flüssigkeit alle Luft verdrängt, und führen Sie die Testkammer gerade und mittig über die Spitze und den Irrigationsschlauch ein, bis sie dicht verschlossen ist.
15. Deaktivieren Sie die Kontinuierliche Irrigation und führen Sie die Füllsequenz gemäß dem Bedienerhandbuch durch.

Allgemein:
Das Produkt enthält keine Phtalate.

Dieses Dokument ist nur am Druckdatum gültig. Bei Fragen zum Druckdatum drucken Sie das Dokument bitte erneut aus, um sicherzustellen, dass die neueste Version der Gebrauchsanweisung verwendet wird (verfügbar unter www.e-ifu.com). Der Benutzer ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die aktuellste Version der Gebrauchsanweisung verwendet wird.

Das Pack ist mit Ethylenoxid sterilisiert und für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

Das Produkt kühl und trocken lagern.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des auf den Verpackungsetiketten des Produkts angegebenen Verfallsdatums.
- Inhalte sind steril, wenn die Produktschale versiegelt und unbeschädigt ist.
- Wenn die Produktleistung während des Gebrauchs abfällt, unterbrechen Sie die Anwendung, und führen Sie die entsprechenden Tests durch, die im Bedienerhandbuch des Systems aufgeführt sind. Wenn die Ergebnisse nicht zufriedenstellend sind, ersetzen Sie das Pack entsprechend den Anweisungen im Bedienerhandbuch.
- Bei Verwendung des VERITAS Fortschrittlichen Infusions-Packs darf die effektive Gesamthöhe der Spülquelle bei aktivierter Erweiterter Infusion nicht weniger als 30 cm betragen.
- Das VERITAS Fortschrittliche Infusions-Pack kann mit einer Irrigationslösung in einer Flasche oder einem Beutel verwendet werden, nachdem das Füllen/Abstimmen erfolgreich abgeschlossen wurde. Der Vorgang des Füllens kann unter Umständen nicht mit allen Beuteln erfolgreich abgeschlossen werden, was zu einer Verzögerung der Behandlung führen kann.

Warnung:

Nur für den Einmalgebrauch. Dieses Produkt nicht erneut sterilisieren, wiederaufbereiten oder wiederverwenden.

Einweg-Medizinprodukte von Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. sind mit Anweisungen für deren Gebrauch und Handhabung versehen, um das Auftreten von Situationen zu minimieren, die das Produkt, den Patienten oder den Anwender beeinträchtigen oder gefährden können. Die Resterilisation/Wiederaufbereitung von Einweg-Medizinprodukten von Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. kann zu Schäden am Medizinprodukt, zu unerwünschten Funktionsweisen des Medizinprodukts und zur Erkrankung oder Verletzung des Patienten aufgrund von Infektionen oder Entzündungen und/oder zur Erkrankung aufgrund von Produktverunreinigung, Infektionsübertragung und mangelnder Produktsterilität führen.

Entsorgung:

Jedes VERITAS-Pack, das durch Blut, Gewebe und/oder Körperflüssigkeiten/-substanzen kontaminiert wurde, muss als biologisch gefährlicher medizinischer Abfall gemäß dem Protokoll der Gesundheitseinrichtung und den geltenden örtlichen Anforderungen behandelt werden.

Wenn das VERITAS-Pack nicht in einwandfreiem Zustand geliefert wurde, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihre örtlichen Vertriebspartner von Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Jedes VERITAS-Pack ist durch eine Chargennummer auf den Verpackungsetiketten des Produkts gekennzeichnet, die bei jeder Korrespondenz oder Besprechung angegeben werden sollte.

In den USA: Gebührenfrei 1-877-266-4543.

Meldungen schwerwiegender Vorfälle:

Wenden Sie sich an Ihre Vertretung vor Ort, um Produktbeschwerden und/oder unerwünschten Ereignisse an Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. zu melden. Wenn das Produkt nicht in einwandfreiem Zustand geliefert wurde, setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem örtlichen Vertriebskontakt bei Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. in Verbindung. Jede Komponente ist mit einer Chargennummer gekennzeichnet, die bei jeder schriftlichen oder mündlichen Korrespondenz anzugeben ist. In den USA: Gebührenfrei 1-877-266-4543.

Meldungen schwerwiegender Vorfälle (EU):

Für Patienten/Anwender/Dritte in der Europäischen Union und in Ländern mit gleichen Regulierungsbedingungen gilt: Wenn sich während der Verwendung dieses Produktes oder infolge der Verwendung dieses Produktes ein schwerwiegender Vorfall ereignet, melden Sie diesen bitte Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. und/oder deren autorisierter Vertretung sowie der zuständigen Behörde in dem Land, in dem der Anwender und/oder der Patient ansässig sind.

Symbol/Titel (Erklärung):

SYMBOL	TITEL (ERKLÄRUNG)
	Gebrauchsanweisung oder elektronische Gebrauchsanweisung beachten
	Nicht wiederverwenden
STERILE EO	Mit Ethylenoxid sterilisiert
REF	Katalognummer
LOT	Chargennummer
	Verfallsdatum
	Hersteller
EC REP	Autorisierte Vertretung in der Europäischen Gemeinschaft/ Europäischen Union
	Nicht erneut sterilisieren
	Importeur
UDI	Eindeutige Produktkennung
CH REP	Autorisierte Vertretung in der Schweiz
	Herstellungsdatum
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist, und die Gebrauchsanweisung konsultieren
EC	Europäische Gemeinschaft/Europäische Union
CH	Schweiz
	Verpackungseinheit
	Vorsicht
	Einzelnes Sterilbarrieresystem
Rx only	Vorsicht: Die US-amerikanische Bundesgesetzgebung sieht vor, dass dieses Gerät ausschließlich durch einen zugelassenen Arzt bzw. im Auftrag eines zugelassenen Arztes erworben werden darf.
	Hier öffnen
MD	Medizinprodukt
	Zerbrechlich, mit Vorsicht handhaben
	Trocken halten
	Diese Seite nach oben

Vorsicht: Gemäß dem US-amerikanischen Bundesgesetz darf diese Vorrichtung nur an einen Arzt oder auf dessen Anordnung verkauft werden.

Hergestellt in Mexiko

Dieses Dokument ist nur am Druckdatum gültig. Bei Fragen zum Druckdatum drucken Sie das Dokument bitte erneut aus, um sicherzustellen, dass die neueste Version der Gebrauchsanweisung verwendet wird (verfügbar unter www.e-ifu.com). Der Benutzer ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die aktuellste Version der Gebrauchsanweisung verwendet wird.

Johnson & Johnson VISION

℞ only

Introduzione/Descrizione

La cassetta per infusione avanzata VERITAS o la cassetta per gestione fluidi avanzata VERITAS è una cassetta a DOPPIA POMPA che fornisce tutti i tubi e gli accessori necessari per eseguire una procedura di irrigazione e aspirazione o una procedura di facoemulsificazione. La cassetta per infusione avanzata VERITAS contiene un tubo aggiuntivo per fornire aria pressurizzata al flacone della soluzione di irrigazione. Ogni cassetta comprende i seguenti componenti:

1. Gruppo cassetta e tubi
2. Telo di copertura per monitor
3. Telo di copertura per tavolo Mayo
4. Camera di test

Scopo previsto

La cassetta per infusione avanzata VERITAS o la cassetta per gestione fluidi avanzata VERITAS contiene il gruppo cassetta e tubi ed è intesa per eseguire l'irrigazione e l'aspirazione durante l'intervento chirurgico della cataratta del segmento anteriore. Viene utilizzata con il sistema VERITAS™ Vision. La camera di test ha lo scopo di verificare la corretta connettività e funzionalità della funzione di irrigazione/aspirazione prima dell'intervento chirurgico.

Disegni del prodotto:

Cassetta per gestione fluidi avanzata VERITAS

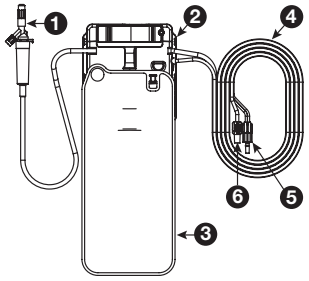

1. Ago del flacone (al flacone di irrigazione)
2. Cassetta
3. Sacca di drenaggio
4. Set di tubi di irrigazione/ aspirazione (al manipolo)
5. Raccordo luer-lock di irrigazione
6. Raccordo di aspirazione

Cassetta per infusione avanzata VERITAS



Solo cassetta per infusione avanzata VERITAS:

7. Linea di infusione
8. Connettore per infusione (alla console)

Indicazioni/Controindicazioni/Paziente previsto/Utente previsto

Tutte le informazioni relative a indicazioni/controindicazioni/ paziente previsto/utente previsto sono descritte nel Manuale d'uso del sistema di facoemulsificazione Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. ("Manuale d'uso"). Controindicazioni: qualsiasi condizione preesistente del paziente che, a giudizio dell'operatore sanitario, costituisce una controindicazione all'intervento chirurgico della cataratta. Tra i pazienti previsti figurano pazienti adulti con cataratta o pazienti adulti sottoposti a chirurgia oftalmica del segmento anteriore (ad es. rimozione del cristallino). Nota: le donne in gravidanza o in allattamento e i bambini non sono stati inclusi negli studi clinici condotti. Il sistema di facoemulsificazione Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. è destinato all'uso da parte di un oculista e del personale di supporto che opera sotto la direzione del chirurgo.

Vantaggi clinici/Effetti collaterali indesiderati/Eventi avversi

Tutte le informazioni relative a vantaggi clinici/effetti collaterali indesiderati/eventi avversi sono descritte nel Manuale d'uso. Tra i vantaggi clinici del sistema di facoemulsificazione Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. figurano: rapida riabilitazione visiva, ripresa precoce delle attività quotidiane, minima infiammazione oculare, minimo astigmatismo postoperatorio, ridotta probabilità di complicanze oculari. Tra le possibili complicanze associate al sistema di facoemulsificazione Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. figurano: rottura della capsula, ustione corneale, infezione/infiammazione ed edema corneale.

Istruzioni per l'uso

Fare riferimento alle seguenti istruzioni per installare correttamente la cassetta VERITAS. Per la cassetta per infusione avanzata VERITAS è previsto un passaggio aggiuntivo, come indicato di seguito. Per utilizzare la cassetta per infusione avanzata VERITAS, occorre selezionare Infusione avanzata in Impostazioni programma prima dell'intervento chirurgico. Per ulteriori istruzioni, consultare il Manuale d'uso. Prima dell'uso, ispezionare visivamente il vassoio del prodotto per verificare l'integrità della confezione. Non utilizzare il prodotto se l'integrità della confezione è stata compromessa.

1. Dopo la rimozione in modo sterile di tutto il contenuto dal vassoio del prodotto sigillato con coperchio, consegnare la CASSETTA e l'AGO DEL FLACONE allo strumentista (all'infermiere), lasciando il SET DI TUBI DI IRRIGAZIONE/ASPIRAZIONE nel campo sterile.
2. Posizionare l'apposito telo di copertura sul monitor del sistema VERITAS Vision.
3. Porre le mani nel telo di copertura per tavolo Mayo secondo i contrassegni di riferimento presenti sul telo e coprire il braccio del tavolo del sistema VERITAS Vision.
4. Inserire la CASSETTA nel pannello dell'impianto dei fluidi del sistema VERITAS Vision.
5. Premere la CASSETTA finché il sistema non attiva il meccanismo di blocco per trattenere la CASSETTA.
6. Preparare il flacone della soluzione di irrigazione.
7. Rimuovere la protezione dalla punta dell'AGO DEL FLACONE.
8. Con il flacone in posizione verticale, inserire l'AGO DEL FLACONE in linea retta al centro del tappo in gomma del flacone stesso, senza ruotare.
9. Appendere il flacone all'asta per fleboclisi, quindi stringere e rilasciare la camera di gocciolamento finché non è piena per 1/2 o 3/4.
10. Solo per la cassetta per infusione avanzata VERITAS: sull'estremità libera della LINEA DI INFUSIONE è presente un CONNETTORE DI INFUSIONE di colore nero. Inserire il CONNETTORE DI INFUSIONE nel pannello laterale del sistema VERITAS Vision, quindi ruotarlo in senso orario finché non scatta quando è completamente collegato.
11. Per i manipoli senza una porta di irrigazione con blocco, ritrarre il collare sul RACCORDO LUER-LOCK DI IRRIGAZIONE. Collegare al manipolo i raccordi luer del SET di TUBI DI IRRIGAZIONE/ASPIRAZIONE. Per i manipoli dotati di una porta di irrigazione con blocco, ruotare il collare sul RACCORDO LUER-LOCK DI IRRIGAZIONE in senso orario per bloccare il raccordo sul manipolo.
12. Collegare la punta e il manicotto di irrigazione al manipolo come da istruzioni di montaggio.
13. Dalla schermata PRIMING/TUNING sul sistema VERITAS Vision, attivare Irrigazione continua con la punta del manipolo rivolta verso il basso, all'interno di una camera di test non sigillata nei confronti del manicotto di irrigazione.
14. Riempire di fluido la camera di test eliminando tutta l'aria presente e inserire la camera di test in linea retta e centrata sulla punta e sul manicotto di irrigazione, finché non risultano sigillati.
15. Disattivare l'irrigazione continua ed eseguire la sequenza di priming secondo quanto indicato nel Manuale d'uso.

Generale

Il dispositivo non contiene ftalati.

La cassetta è sterilizzata con ossido di etilene ed è esclusivamente monouso.

Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto.

Precauzioni

- Non usare il prodotto oltre la sua data di scadenza, marcata sulle etichette della confezione del prodotto stesso.
- Il contenuto è sterile se il vassoio del prodotto è sigillato con coperchio e non danneggiato.

Questo documento è valido soltanto dalla data di stampa. In caso di dubbio riguardo a tale data, effettuare una nuova stampa per essere certi di utilizzare la revisione più recente delle IFU (disponibile sul sito www.e-ifu.com). Spetta all'utente assicurarsi che le IFU impiegate siano le più recenti.

Johnson & Johnson VISION

- Se le prestazioni del prodotto risultano compromesse durante l'uso, interromperne l'uso ed eseguire i test del caso, come indicato nel Manuale d'uso del sistema. Se i risultati non sono soddisfacenti, sostituire la cassetta seguendo le istruzioni indicate nel Manuale d'uso.
- Quando si utilizza la cassetta per infusione avanzata VERITAS, l'altezza totale effettiva del flacone di irrigazione non può essere inferiore a 30 cm quando l'infusione avanzata è attivata.
- La cassetta per infusione avanzata VERITAS può essere utilizzata solo con la soluzione di irrigazione in un flacone o in una sacca dopo aver completato correttamente il priming/tuning. Non è possibile completare correttamente la fase di priming con tutte le sacche, il che potrebbe comportare un ritardo nel trattamento.

Avvertenza:

Esclusivamente monouso. Non risterilizzare, ricondizionare o riutilizzare questo dispositivo.

I dispositivi medici monouso Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. sono etichettati con istruzioni per l'uso e la manipolazione allo scopo di ridurre al minimo l'esposizione a condizioni che potrebbero compromettere il prodotto, il paziente o l'utente. Una ripetuta procedura di sterilizzazione/ricondizionamento dei dispositivi medici monouso Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. può provocare danni fisici al dispositivo medico, mancata esecuzione dei procedimenti del dispositivo medico previsti, nonché malattie o lesioni del paziente causate da infezioni, infiammazioni e/o malattie dovute alla contaminazione del prodotto, alla trasmissione di infezioni e alla non sterilità del prodotto.

Smaltimento

Qualsiasi cassetta VERITAS contaminata da sangue, tessuti e/o fluidi/materiali corporei deve essere trattata come rifiuto medico a rischio biologico secondo il protocollo della struttura sanitaria e i requisiti locali applicabili.

Se la cassetta VERITAS viene ricevuta in condizioni insoddisfacenti, rivolgersi immediatamente all'ufficio vendite Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc di zona. Ogni cassetta VERITAS è identificata da un numero di lotto presente sulle etichette della confezione, che deve essere incluso in qualsiasi corrispondenza o conversazione.

Negli Stati Uniti, chiamare il numero verde 1-877-266-4543.

Segnalazione di eventi gravi

Per segnalare reclami e/o eventi avversi relativi al prodotto a Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. rivolgersi al rappresentante di zona; se il prodotto viene ricevuto in condizioni insoddisfacenti, rivolgersi immediatamente all'ufficio vendite Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. di zona. Ogni componente è identificato da un numero di lotto, che deve essere incluso in ogni corrispondenza o conversazione. Negli Stati Uniti, chiamare il numero verde 1-877-266-4543.

Segnalazione di incidenti gravi (UE)

Per pazienti/utenti/terze parti residenti nell'Unione Europea e in Paesi con identico regime normativo; nel caso in cui, durante l'uso di questo dispositivo o a seguito del suo utilizzo, si è verificato un incidente grave, segnalarlo a Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. e/o al suo rappresentante autorizzato nonché all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utente e/o il paziente risiede.

Simbolo/Titolo (spiegazione)

SIMBOLO	TITOLO (SPIEGAZIONE)
	Consultare le istruzioni per l'uso oppure le istruzioni per l'uso in formato elettronico
	Non riutilizzare
	Sterilizzato con ossido di etilene
	Numero di catalogo

SIMBOLO	TITOLO (SPIEGAZIONE)
	Codice lotto
	Data di scadenza
	Fabbricante
	Mandatario nella Comunità Europea/Unione Europea
	Non risterilizzare
	Importatore
	Identificazione unica del dispositivo
	Mandatario in Svizzera
	Data di produzione
	Non usare se la confezione è danneggiata e consultare le istruzioni per l'uso
	Comunità Europea/Unione Europea
	Svizzera
	Unità di imballaggio
	Attenzione
	Sistema di barriera sterile singolo
	Attenzione: la legge federale statunitense limita la vendita di questo dispositivo ai soli medici o dietro prescrizione medica.
	Aprire qui
	Dispositivo medico
	Fragile, maneggiare con cura
	Conservare in luogo asciutto
	Lato alto

Attenzione: la legge federale statunitense limita la vendita di questo dispositivo ai soli medici o dietro prescrizione medica.

Prodotto in Messico

Questo documento è valido soltanto dalla data di stampa. In caso di dubbio riguardo a tale data, effettuare una nuova stampa per essere certi di utilizzare la revisione più recente delle IFU (disponibile sul sito www.e-ifu.com). Spetta all'utente assicurarsi che le IFU impiegate siano le più recenti.

Johnson & Johnson VISION

℞ only

Innledning/Beskrivelse:
VERITAS avansert infusjonspakke eller VERITAS avansert fluidikkpakke er en DOBBEL PUMPEPAKKE som inneholder alle slanger og tilbehør som er nødvendige for å utføre en skylle- og aspirasjonsprosedyre eller en fakoemulsifikasjon. VERITAS avansert infusjonspakke inneholder en ekstra slange som forsyner skyllevæskebeholderen med trykkluft. Hver pakke inneholder følgende artikler:

1. kassett- og slangeenhet
2. skjermduk
3. Mayo-stativduk
4. testkammer

Tiltenkt formål:
VERITAS avansert infusjonspakke eller VERITAS avansert fluidikkpakke inneholder en kassett- og slangeenhet som er beregnet til skylling og aspirasjon under kataraktkirurgi i fremre segment. Den brukes sammen med VERITAS™ Vision-systemet. Testkammeret brukes til å kontrollere at skylle- og aspirasjonsfunksjonen er riktig tilkoblet og fungerer som den skal før det kirurgiske inngrepet.

Produkttegninger:

VERITAS avansert fluidikkpakke

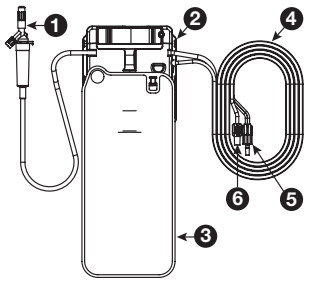

VERITAS avansert infusjonspakke



1. skyllespiss (til skyllebeholder)
2. kassett
3. dreneringspose
4. skylle- og aspirasjonsslangesett (til håndstykke)
5. skylleluerlåskobling
6. aspirasjonskobling

Kun VERITAS avansert infusjonspakke:
7. infusjonsslange
8. infusjonskontakt (til konsollen)

Indikasjoner / kontraindikasjoner / tiltenkt pasient / tiltenkt bruker:
All relevant informasjon for indikasjoner / kontraindikasjoner / tiltenkt pasient / tiltenkt bruker er beskrevet i brukerhåndboken for Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. fakoemulsifikasjonssystem («Brukerhåndbok»). Kontraindikasjoner: Kontraindikasjonene inkluderer alle eksisterende pasienttilstander som helsepersonell fastslår er en kontraindikasjon for kataraktkirurgi. Tiltenkte pasienter inkluderer voksne pasienter med katarakt eller voksne pasienter som skal gjennomgå kirurgi i fremre øyesegment (f.eks. fjerning av krystallinsen). Merk: Gravide, ammende kvinner eller barn var ikke med i de(n) kliniske studien(e) som ble utført. Fakoemulsifikasjonssystemet fra Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. er beregnet for bruk av en øyelege og støttepersonell som opererer under ledelse av kirurgen.

Klinisk nytte / bivirkninger / skadevirkninger:
All relevant informasjon om klinisk nytte / bivirkninger / skadevirkninger beskrives i brukerhåndboken. Klinisk nytte ved Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. fakoemulsifikasjonssystem omfatter følgende: Rask rehabilitering av synet, tidlig gjenopptakelse av daglige aktiviteter, minimal øyebetennelse, minimal postoperativ astigmatisme, redusert potensiale for øyekomplikasjoner. Komplikasjoner som kan være forbundet med fakoemulsifikasjonssystemet fra Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc., omfatter ødelagt kapsel, hornhinneforbrenning, infeksjon/betennelse og hornhinneødem.

Bruksanvisning:
Se instruksjonene nedenfor for informasjon om hvordan du installerer VERITAS-pakken på riktig måte. VERITAS avansert infusjonspakke har ett ekstra trinn, som nevnt nedenfor. For å bruke VERITAS avansert infusjonspakke må du velge Avansert infusjon i Programinnstillinger før operasjonen. Se brukerhåndboken hvis du trenger ytterligere instruksjoner. Før bruk kontrollerer du visuelt at det ikke er skade på emballasjen til produktbrettet. Produktet skal ikke brukes dersom emballasjen er skadet.

1. Etter at du har brukt steril metode til å ta ut alt innholdet fra produktbrettet forseglet med lokk, leveres KASSETTEN og SKYLLESPISSEN til sirkulerende sykepleier mens du lar SKYLLE- OG ASPIRASJONSSLANGESETTET være i det sterile feltet.
2. Plasser skjermduken over skjermen på VERITAS Vision-systemet.
3. Plasser hendene på Mayo-stativduken i henhold til markeringene på duken, og dekk til brettstangen på VERITAS Vision-systemet.
4. Sett KASSETTEN inn i fluidikkpanelet i VERITAS Vision-systemet.
5. Skyv KASSETTEN til systemet aktiverer låsemekanismen for å holde KASSETTEN på plass.
6. Klargjør skyllevæskebeholderen.
7. Fjern beskytteren fra tuppen av SKYLLESPISSEN.
8. Med beholderen i loddrett stilling setter du SKYLLESPISSEN rett inn i midten av gummikorken på beholderen uten å vri.
9. Heng beholderen på IV-stangen, og klem på og slipp deretter dryppkammeret til det er 1/2 til 3/4 fullt.
10. Kun for VERITAS avansert infusjonspakke: INFUSJONSSLANGEN har en svart INFUSJONSKONTAKT i den frie enden. Sett INFUSJONSKONTAKTEN inn i sidepanelet på VERITAS Vision-systemet, og vri den deretter med klokken til du hører et klikk som indikerer at den er helt koblet til.
11. For håndstykker uten en låsbar skylleport trekker du tilbake kragen på SKYLLELUERLÅSKOBLINGEN. Koble luerkoblingene på SKYLLE- OG ASPIRASJONSSLANGESETTET til håndstykket. For håndstykker som er utstyrt med en låsbar skylleport, dreier du kragen på SKYLLELUERLÅSKOBLINGEN med klokken for å låse koblingen til håndstykket.
12. Fest tuppen og skyllehylsen til håndstykket i henhold til monteringsinstruksjonene.
13. Fra skjermbildet PRIME/TUNE på VERITAS Vision-systemet aktiverer du kontinuerlig skylling med tuppen på håndstykket rettet nedover i et testkammer som ikke er forseglet mot skyllehylsen.
14. Deretter fyller du testkammeret med væske, fjerner all luft og setter testkammeret rett inn og midt over spissen og skyllehylsen til det er forseglet.
15. Deaktiver kontinuerlig skylling, og utfør en primesekvens i henhold til brukerhåndboken.

Generelt:
Utstyret inneholder ikke ftalater.

Pakken er sterilisert med etylenoksid og er kun til engangsbruk.

Oppbevar produktet på et kjølig, tørt sted.

Forholdsregler:

- Ikke bruk produktet etter utløpsdatoen som står på etikettene på produktemballasjen.
- Innholdet er sterilt når produktbrettet er forseglet og uskadet.
- Hvis produktytelsen kompromitteres under bruk, avslutter du bruken og utfører egnede tester som beskrevet i systemets brukerhåndbok. Hvis resultatene ikke er tilfredsstillende, bytter du ut pakken i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken.
- Ved bruk av VERITAS avansert infusjonspakke kan den effektive totale høyden på skyllebeholderen ikke være lavere enn 30 cm når avansert infusjon er aktivert.
- VERITAS avansert infusjonspakke kan brukes sammen med skyllevæske i en flaske eller pose etter at prime/tune er fullført. Ikke alle poser kan primes riktig, noe som kan føre til behandlingsforsinkelse.

Dette dokumentet er bare gyldig på trykkedatoen. Hvis du er usikker på trykkedatoen, kan du skrive ut dokumentet på nytt for å være sikker på at du har siste versjon av bruksanvisningen (tilgjengelig på www.e-ifu.com). Det er brukerens ansvar å sikre at den nyeste versjonen av bruksanvisningen brukes.

Johnson & Johnson VISION

Z311979E B

NO

Advarsel:
Kun til engangsbruk. Utstyret må ikke resteriliseres, reprosesseres eller brukes på nytt.

Medisinsk engangsutstyr fra Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. er merket med instruksjoner for bruk og håndtering for å redusere eventuelle situasjoner som kan ha negativ innvirkning på produktet, pasienten eller brukeren. Resterilisering/reprosessering av medisinsk engangsutstyr fra Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. kan føre til at det medisinske utstyret blir fysisk skadet, at det medisinske utstyret ikke fungerer som det skal, at pasienten blir syk eller skadet på grunn av infeksjoner eller betennelser og/eller blir syk på grunn av produktkontaminering, overføring av infeksjoner eller manglende produktsterilitet.

Kassering:
En VERITAS-pakke som har blitt kontaminert av blod, vev og/eller kroppsvæsker/-materie, skal håndteres som biologisk farlig medisinsk avfall i henhold til helseinstitusjonens protokoller og gjeldende lokale krav.

Hvis VERITAS-pakken mottas i utilfredsstillende tilstand, må du straks ta kontakt med det lokale salgskontoret til Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Hver VERITAS-pakke er identifisert med serienummer. Dette nummeret skal oppgis ved hver henvendelse.

I USA kan du ringe gratisnummeret 1-877-266-4543.

Rapportering av alvorlige hendelser:
Ta kontakt med den lokale representanten for å rapportere produktklager og/eller uønskede hendelser til Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Hvis produktet du har mottatt, ikke er i tilfredsstillende stand, kontakter du umiddelbart det lokale salgskontoret for Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Hver komponent er identifisert med serienummer, og dette nummeret skal oppgis ved hver henvendelse. I USA kan du ringe gratisnummeret 1-877-266-4543.

Rapportering av alvorlige hendelser (EU):
For en pasient/bruker/tredjepart i EU og i land med identiske retningslinjer: Dersom det oppstår en alvorlig hendelse under bruk av dette utstyret, eller som et resultat av bruken, må du rapportere dette til Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. og/eller den autoriserte representanten samt til de ansvarlige kompetente myndighetene hvor brukeren og/eller pasienten oppholder seg.

Symbol/tittel (forklaring):

SYMBOL	TITTEL (FORKLARING)
	Se bruksanvisningen eller se den elektroniske bruksanvisningen
	Ikke til gjenbruk
	Sterilisert med etylenoksid
	Katalognummer
	Batchkode
	Utløpsdato
	Produsent
	Autorisert representant i EF/EU
	Skal ikke resteriliseres
	Importør
	Unik enhetsidentifikator
	Autorisert representant i Sveits
	Produksjonsdato

SYMBOL	TITTEL (FORKLARING)
	Må ikke brukes hvis emballasjen er skadet, se bruksanvisningen
	EF/EU
	Sveits
	Emballasjeenhet
	Forsiktig
	Enkelt sterilt barrieresystem
	Forsiktig: Ifølge føderal lovgivning i USA er dette utstyret begrenset til å selges av eller på forordning av autorisert helsepersonell.
	Åpne her
	Medisinsk utstyr
	Skjør, håndteres med forsiktighet
	Må holdes tørr
	Denne siden opp

Forsiktig: Føderal (USA) lovgivning begrenser dette produktet til salg av eller etter forordning fra en lege.

Produsert i Mexico

℞ only

Introdução/descrição:
O Cartucho de Infusão Avançada VERITAS ou o Cartucho de Fluidos Avançados VERITAS é um cartucho de BOMBA DUPLA que fornece todos os tubos e acessórios necessários para realizar um procedimento de irrigação/aspiração ou um procedimento de facoemulsificação. O Cartucho de Infusão Avançada VERITAS contém uma linha de tubos adicional para fornecer ar pressurizado à fonte da solução de irrigação. Cada cartucho é composto pelos seguintes itens:

1. Conjunto da cassete e tubos
2. Cobertura de proteção do monitor
3. Cobertura de proteção do suporte Mayo
4. Câmara de teste

Finalidade prevista:
O Cartucho de Infusão Avançada VERITAS ou Cartucho de Fluidos Avançados VERITAS contém o conjunto da cassete e tubos e destina-se a realizar procedimentos de irrigação e aspiração durante a cirurgia do segmento anterior (cataratas). É utilizado com o sistema VERITAS™ Vision. A câmara de teste destina-se a verificar a conectividade e a funcionalidade corretas da função de irrigação/aspiração antes do procedimento cirúrgico.

Desenhos do produto:

Cartucho de Fluidos Avançados VERITAS

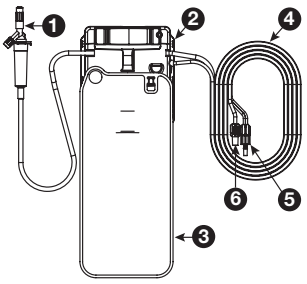

Cartucho de Infusão Avançada VERITAS



1. Espigão de irrigação (para fonte de irrigação)
2. Cassete
3. Saco de drenagem
4. Conjunto de tubos I/A (para peça de mão)
5. Acessório Luer Lock de irrigação
6. Acessório de aspiração

Apenas para o Cartucho de Infusão Avançada VERITAS:
7. Linha de infusão
8. Conector de infusão (para consola)

Indicações/Contraindicações/Doente previsto/Utilizador previsto:
Todas as informações relevantes referentes a Indicações/Contraindicações/Doente previsto/Utilizador previsto estão descritas no Manual do utilizador do sistema de facoemulsificação ("Manual do utilizador") da Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Contraindicações: qualquer condição preexistente do doente que o profissional de saúde determine ser uma contraindicação para a cirurgia às cataratas. Os doentes previstos incluem doentes adultos com cataratas ou doentes adultos submetidos a cirurgia oftálmica do segmento anterior (por exemplo, remoção do cristalino). Nota: não foram incluídas mulheres grávidas, lactantes nem crianças no(s) ensaio(s) clínico(s) realizado(s). O sistema de facoemulsificação da Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. destina-se a ser utilizado por um oftalmologista e uma equipa de apoio a trabalhar sob as instruções do cirurgião.

Benefícios clínicos/Efeitos secundários indesejáveis/Efeitos adversos:
Todas as informações relevantes referentes a Benefícios clínicos/Efeitos secundários indesejáveis/Efeitos adversos são descritas no Manual do utilizador. Os benefícios clínicos do sistema de facoemuslsificação da Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. incluem os seguintes: reabilitação visual rápida, retoma precoce das atividades quotidianas, inflamação ocular mínima, astigmatismo pós-operatório mínimo, redução da potencial ocorrência de complicações oculares. As complicações que poderão estar associadas ao sistema de facoemulsificação da Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. incluem: rutura da cápsula, queimadura da córnea, infeção/inflamação e edema da córnea.

Instruções de utilização:
Consulte as instruções que se seguem relativamente ao procedimento de instalação correto do Cartucho VERITAS. O Cartucho de Infusão Avançada VERITAS tem um passo extra, conforme indicado abaixo. Para utilizar o Cartucho de Infusão Avançada VERITAS, é necessário selecionar "Infusão avançada" em "Definições do programa" antes da cirurgia. Para obter mais instruções, consulte o Manual do utilizador. Antes de utilizar, inspecione visualmente o tabuleiro de produto quanto a falhas na integridade da embalagem. Não utilize o produto se a integridade da embalagem tiver sido comprometida.

1. Após a remoção estéril de todo o conteúdo do tabuleiro do produto selado com tampa, passe a CASSETE e o ESPIGÃO DE IRRIGAÇÃO ao enfermeiro circulante, ao mesmo tempo que retém os CONJUNTO DE TUBOS I/A no campo estéril.
2. Coloque a cobertura de proteção do monitor sobre o monitor no sistema VERITAS Vision.
3. Coloque as mãos na cobertura de proteção do suporte Mayo de acordo com as marcações da guia na cobertura e cubra o braço do tabuleiro do sistema VERITAS Vision.
4. Insira a CASSETE no painel do sistema fluídico do sistema VERITAS Vision.
5. Pressione a CASSETE até o sistema ativar o mecanismo de bloqueio de forma a reter a CASSETE.
6. Prepare fonte da solução de irrigação.
7. Retire o protetor da ponta do ESPIGÃO DE IRRIGAÇÃO.
8. Com a fonte na posição vertical, insira o ESPIGÃO DE IRRIGAÇÃO diretamente no centro da rolha de borracha da fonte, sem rodar.
9. Pendure a fonte no suporte I/V e, em seguida, aperte e solte a câmara de gotejamento até ficar 1/2 a 3/4 cheia.
10. Apenas para o Cartucho de Infusão Avançada VERITAS: a LINHA DE INFUSÃO tem um CONECTOR DE INFUSÃO preto na extremidade livre. Insira o CONECTOR DE INFUSÃO no painel lateral do sistema VERITAS Vision e gire-o para a direita até ouvir um clique, o que significa que está totalmente ligado.
11. Para peças de mão sem uma porta de irrigação com bloqueio, retraia o anel no ACESSÓRIO LUER LOCK DE IRRIGAÇÃO. Ligue os acessórios Luer do CONJUNTO DE TUBOS I/A à peça de mão. Para peças de mão equipadas com uma porta de irrigação com bloqueio, gire o anel no ACESSÓRIO LUER LOCK DE IRRIGAÇÃO para a direita para bloquear o acessório na peça de mão.
12. Fixe a ponta e a manga de irrigação à peça de mão de acordo com as instruções de montagem.
13. No ecrã ENCHER/CALIBRAR no sistema VERITAS Vision, ative a opção "Irrigação contínua" com a ponta da peça de mão virada para baixo no interior de uma câmara de teste não selada contra a manga de irrigação.
14. Encha a câmara de teste com fluido, eliminando qualquer ar presente, e insira a câmara de teste a direito e centrada sobre a ponta e a manga de irrigação até ficar selada.
15. Desative a irrigação contínua e execute a sequência de enchimento de acordo com o Manual do utilizador.

Gerais:
O dispositivo não contém ftalatos.

O cartucho é esterilizado por óxido de etileno e foi concebido para uma utilização única.

Guarde o produto num local fresco e seco.

Este documento apenas é válido na data de impressão. Se não tiver a certeza da data de impressão, volte a imprimir para assegurar a utilização da última revisão das instruções de utilização (disponíveis em www.e-ifu.com).
É da responsabilidade do utilizador assegurar que são utilizadas as instruções de utilização mais recentes.
Johnson & Johnson VISION

Precauções:

- Não utilize o produto após o prazo de validade indicado nos rótulos de embalagem do produto.
- O conteúdo está estéril quando o tabuleiro do produto está selado com uma tampa e intacto.
- Se o desempenho do produto ficar comprometido durante a utilização, interrompa a utilização e realize os testes apropriados, conforme descrito no Manual do utilizador do sistema. Se os resultados não forem satisfatórios, substitua o cartucho de acordo com as instruções definidas no Manual do utilizador.
- Ao utilizar o Cartucho de Infusão Avançada VERITAS, a altura total efetiva da fonte de irrigação não pode ser inferior a 30 cm quando a opção "Infusão avançada" está ativada.
- O Cartucho de Infusão Avançada VERITAS pode ser utilizado com solução de irrigação num frasco ou saco após a conclusão bem-sucedida de Encher/Calibrar. Nem todos os sacos podem concluir o processo de Encher com sucesso, o que pode resultar num atraso do tratamento.

Aviso:

Uma única utilização. Não reesterilize, reprocesse nem reutilize este dispositivo.

Os dispositivos médicos de utilização única da Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. estão rotulados com instruções de utilização e manuseamento de modo a minimizar a exposição a condições que poderiam comprometer o produto, o doente ou o utilizador. A reesterilização/o reprocessamento dos dispositivos médicos de utilização única da Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. pode resultar em danos físicos no dispositivo médico, funcionamento anormal do dispositivo médico e doença ou lesão do doente devido a infeção, inflamação e/ou doença devido a contaminação do produto, transmissão de infeções e ausência de esterilidade do produto.

Eliminação:

Qualquer Cartucho VERITAS que tenha sido contaminado por sangue, tecido e/ou fluidos/matérias corporais deve ser tratado como resíduo médico com risco biológico, de acordo com o protocolo da instituição de cuidados de saúde e os requisitos locais aplicáveis.

Se o Cartucho VERITAS for recebido num estado não satisfatório, contacte imediatamente o Serviço de Vendas da Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. local. Cada Cartucho VERITAS está identificado por um número de lote nos rótulos da embalagem do produto, o qual deverá ser indicado em qualquer correspondência ou conversação.

Nos Estados Unidos ligue: n.º gratuito 1-877-266-4543.

Comunicação de incidentes graves:

Contacte o seu representante local para comunicar todas as reclamações relacionadas com os produtos e/ou acontecimentos adversos à Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Se o produto for recebido num estado não satisfatório, contacte imediatamente o serviço de vendas da Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Cada componente está identificado por um número de lote que deverá ser indicado em qualquer correspondência ou conversação. Nos Estados Unidos ligue: n.º gratuito 1-877-266-4543.

Comunicação de incidente grave (UE):

Para um doente/utilizador/terceiros na União Europeia e em países com um regime regulamentar idêntico; se, durante a utilização deste dispositivo, ou como resultado da sua utilização, ocorrer um incidente grave, notifique o incidente à Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. e/ou ao representante autorizado e à autoridade competente do Estado-Membro onde o utilizador e/ou o doente está estabelecido.

Símbolo/título (explicação):

SÍMBOLO	TÍTULO (EXPLICAÇÃO)
	Consultar as instruções de utilização ou consultar as instruções de utilização eletrónicas
	Não reutilizar
STERILE EO	Esterilizado com óxido de etileno
REF	Número de catálogo
LOT	Código do lote
	Data limite de utilização
	Fabricante
EC REP	Representante autorizado na Comunidade Europeia/União Europeia
	Não reesterilizar
	Importador
UDI	Identificador único de dispositivo
CH REP	Representante autorizado na Suíça
	Data de fabrico
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada e consultar as instruções de utilização
EC	Comunidade Europeia/União Europeia
CH	Suíça
	Unidade de embalagem
	Atenção
	Sistema de barreira estéril única
Rx only	Atenção: a lei federal dos EUA limita a venda deste dispositivo a um médico qualificado ou mediante prescrição médica.
	Abrir aqui
MD	Dispositivo médico
	Frágil, manusear com cuidado
	Manter seco
	Esta parte virada para cima

Atenção: a lei federal dos EUA limita a venda deste dispositivo a um médico ou mediante prescrição médica.

Produto do México

Este documento apenas é válido na data de impressão. Se não tiver a certeza da data de impressão, volte a imprimir para assegurar a utilização da última revisão das instruções de utilização (disponíveis em www.e-ifu.com).
É da responsabilidade do utilizador assegurar que são utilizadas as instruções de utilização mais recentes.

Johnson & Johnson VISION

℞ only

Introducción/Descripción:
El paquete de perfusión avanzada VERITAS o paquete de gestión avanzada de fluidos VERITAS es un paquete de BOMBA DOBLE que proporciona todos los tubos y accesorios necesarios para realizar un procedimiento de irrigación y aspiración o un procedimiento de facoemulsificación. El paquete de perfusión avanzada VERITAS incluye una línea de tubo adicional para proporcionar aire a presión a la fuente de solución de irrigación. Todos los paquetes contienen los siguientes elementos:

1. Conjunto de casete y tubos
2. Cubierta estéril para el monitor
3. Cubierta estéril para el soporte Mayo
4. Cámara de prueba

Finalidad prevista:
El paquete de perfusión avanzada VERITAS o paquete de gestión avanzada de fluidos VERITAS incluye el conjunto de casete y tubos y está diseñado para irrigar y aspirar durante la cirugía de cataratas del segmento anterior. Se utiliza con el sistema VERITAS™ Vision. La cámara de prueba está diseñada para verificar la correcta conectividad y funcionalidad de la función de irrigación/aspiración antes del procedimiento quirúrgico.

Dibujos del producto:

Paquete de gestión avanzada de fluidos VERITAS

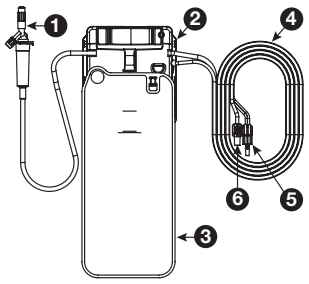

Paquete de perfusión avanzada VERITAS



1. Punzón de irrigación (a la fuente de irrigación)
2. Paquete
3. Bolsa de drenaje
4. Juego de tubos de I/A (a la pieza de mano)
5. Conector Luer Lock de irrigación
6. Conector de aspiración

Solo paquete de perfusión avanzada VERITAS:
7. Línea de infusión
8. Conector de infusión (a la consola)

Indicaciones/Contraindicaciones/Paciente previsto/Usuario previsto:
Toda la información relevante sobre las Indicaciones, Contraindicaciones, Paciente previsto y Usuario previsto se describe en el Manual de usuario del sistema de facoemulsificación («Manual de usuario») de Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Contraindicaciones: Cualquier afección preexistente del paciente que el profesional sanitario determine que es una contraindicación para la cirugía de cataratas. Los pacientes previstos son pacientes adultos con cataratas o que se sometan a una cirugía oftálmica del segmento anterior (por ejemplo, extracción del cristalino). Nota: En los ensayos clínicos realizados no se incluyeron mujeres embarazadas o en periodo de lactancia ni niños. El sistema de facoemulsificación de Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. está diseñado para que lo utilice un oftalmólogo y personal adjunto que actúe según las instrucciones del cirujano.

Beneficios clínicos/Efectos secundarios no deseados/Efectos adversos:
Toda la información relevante sobre Beneficios clínicos/Efectos secundarios no deseados/Efectos adversos se detalla en el Manual de usuario. Algunos de los beneficios clínicos del sistema de facoemulsificación de Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. son: Rápida rehabilitación visual, reanudación temprana de las actividades diarias, mínima inflamación ocular, mínimo astigmatismo posoperatorio, menor posibilidad de complicaciones oculares. Algunas de las complicaciones que pueden estar relacionadas con el sistema de facoemulsificación de Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. son rotura de la cápsula, quemadura corneal, infección/inflamación y edema corneal.

Instrucciones de uso:
Consulte las instrucciones siguientes para saber cómo instalar correctamente el paquete VERITAS. El paquete de perfusión avanzada VERITAS requiere un paso adicional, como se indica a continuación. Para utilizar el paquete de perfusión avanzada VERITAS, antes de la intervención quirúrgica, seleccione la opción de Infusión avanzada en la pantalla de Ajustes del programa. Para obtener instrucciones adicionales, consulte el Manual de usuario. Antes de su uso, inspeccione visualmente la bandeja del producto para comprobar que el paquete no esté dañado. No utilice el producto si el paquete no está intacto.

1. Después de retirar todo el contenido de la bandeja del producto precintada con la tapa, entregue el CASETE y el PUNZÓN DE IRRIGACIÓN al instrumentista (personal de enfermería) mientras mantiene el JUEGO DE TUBOS DE IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN (I/A) en el campo estéril.
2. Coloque la cubierta estéril para el monitor por encima del monitor del sistema VERITAS Vision.
3. Coloque las manos en la cubierta estéril para el soporte Mayo según las marcas guía de la cubierta y cubra el brazo de la bandeja del sistema VERITAS Vision.
4. Inserte el CASETE en el panel de fluidos del sistema VERITAS Vision.
5. Empuje el CASETE hasta que el sistema active el mecanismo de cierre para retener el CASETE.
6. Prepare la fuente de solución de irrigación.
7. Retire el protector de la punta del PUNZÓN DE IRRIGACIÓN.
8. Con la fuente en posición vertical, inserte el PUNZÓN DE IRRIGACIÓN directamente y sin girarlo en el centro del tapón de goma de la fuente.
9. Cuelgue la fuente en el portasueros i. v. y, a continuación, apriete y suelte la cámara de goteo hasta que esté llena entre 1/2 y 3/4 de su capacidad.
10. Solo para el paquete de perfusión avanzada VERITAS: La LÍNEA DE INFUSIÓN tiene un CONECTOR DE INFUSIÓN negro en el extremo libre. Inserte el CONECTOR DE INFUSIÓN en el panel lateral del sistema VERITAS Vision y, a continuación, gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que se oiga un clic cuando esté completamente conectado.
11. En el caso de piezas de mano sin puerto de irrigación de bloqueo, retraiga el anillo del CONECTOR LUER LOCK DE IRRIGACIÓN. Conecte los conectores Luer del JUEGO DE TUBOS DE I/A a la pieza de mano. Para piezas de mano equipadas con un puerto de irrigación de bloqueo, gire el anillo del CONECTOR LUER LOCK DE IRRIGACIÓN en el sentido de las agujas del reloj para bloquear el conector a la pieza de mano.
12. Conecte la punta y la funda de irrigación a la pieza de mano siguiendo las instrucciones de montaje.
13. En la pantalla CEBAR/AJUSTAR del sistema VERITAS Vision, active la irrigación continua con la punta de la pieza de mano orientada hacia abajo dentro de una cámara de prueba no sellada frente al manguito de irrigación.
14. Llene de líquido la cámara de prueba eliminando todo el aire e inserte la cámara de prueba recta y centrada por encima de la punta y el manguito de irrigación hasta que quede sellada.
15. Desactive la irrigación continua y realice la secuencia de cebado de acuerdo con el Manual de usuario.

Generalidades:
El producto no contiene ningún medicamento.

El paquete está esterilizado con óxido de etileno y está diseñado para un solo uso.

Guarde el producto en un lugar fresco y seco.

Este documento solo es válido en la fecha de impresión. Si no está seguro de la fecha de impresión, vuelva a imprimirlo para asegurarse de estar utilizando la última versión de las instrucciones de uso (disponibles en www.e-ifu.com). El usuario es responsable de asegurarse de utilizar las instrucciones de uso más recientes.

Johnson & Johnson VISION

Precauciones:

- No utilice el producto después de la fecha de caducidad indicada en las etiquetas del envase.
- El contenido se mantiene estéril cuando la bandeja del producto está sellada y no dañada.
- Si el rendimiento del producto se ve afectado al utilizarlo, interrumpa el uso y realice las pruebas correspondientes, según se detallan en el Manual de usuario del sistema. Si los resultados no son satisfactorios, reemplace el paquete de acuerdo con las instrucciones definidas en el Manual de usuario.
- Si se utiliza el paquete de perfusión avanzada VERITAS, la altura total efectiva de la fuente de irrigación no puede ser inferior a 30 cm cuando la infusión avanzada está activada.
- El paquete de perfusión avanzada VERITAS puede utilizarse con solución de irrigación en un frasco o bolsa después de llevar a cabo un cebado/ajuste. Es posible que el cebado no se pueda llevar a cabo correctamente con todas las bolsas, lo que puede retrasar el tratamiento.

Advertencia:

Un solo uso. No reesterilice, reprocese ni reutilice este producto.

Los productos sanitarios de un solo uso de Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. están etiquetados con las instrucciones de uso y manejo con el fin de reducir al mínimo la exposición a condiciones que pudieran poner en riesgo el producto, al paciente o al usuario. La reesterilización/reprocesado de los dispositivos de un solo uso de Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. puede provocar daños físicos al producto sanitario, que el producto sanitario no funcione según lo previsto, además de una enfermedad o lesión del paciente como consecuencia de infección, inflamación y/o enfermedad debidas a la contaminación del producto, transmisión de infecciones y ausencia de esterilidad del producto.

Eliminación:

Cualquier paquete VERITAS que haya sido contaminado con sangre, tejidos y/o materia/fluidos corporales debe manipularse como residuo médico con peligro biológico según el protocolo del centro sanitario y los requisitos locales aplicables.

Si se recibe el paquete VERITAS en un estado deficiente, póngase en contacto de inmediato con la oficina de ventas local de Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Cada paquete VERITAS está identificado por un número de lote, visible en las etiquetas del envase del producto, que debe incluirse en cualquier correspondencia o conversación.

Número gratuito en EE. UU.: 1-877-266-4543.

Notificación de incidentes graves:

Póngase en contacto con el representante local para notificar a Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. todas las reclamaciones sobre los productos y/o los eventos adversos. Si recibe el producto en un estado insatisfactorio, póngase en contacto con el departamento de ventas local de Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Cada componente está identificado por un número de lote, el cual debe incluirse en cualquier correspondencia o conversación. Número gratuito en EE. UU.: 1-877-266-4543.

Notificación de incidentes graves (UE):

En el caso de pacientes, usuarios o terceros ubicados en la Unión Europea y en países cuyo régimen regulatorio sea idéntico: si, durante el uso de este producto o a consecuencia de su uso, se ha producido un incidente grave, notifíquelo a Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. y/o a su representante autorizado y a la autoridad competente del Estado miembro en el que resida el usuario y/o paciente.

Símbolo/título (explicación):

SÍMBOLO	TÍTULO (EXPLICACIÓN)
	Consultar las instrucciones de uso o las instrucciones de uso electrónicas
	No volver a utilizar
	Esterilizado mediante óxido de etileno
	Número de referencia
	Código de lote
	Fecha de caducidad
	Fabricante
	Representante autorizado en la Comunidad Europea/Unión Europea
	No volver a esterilizar
	Importador
	Identificador único del dispositivo
	Representante autorizado en Suiza
	Fecha de fabricación
	No utilizar si el envase está dañado y consultar las instrucciones de uso
	Comunidad Europea/Unión Europea
	Suiza
	Unidad de envasado
	Precaución
	Sistema de barrera estéril único
	Precaución: Las leyes federales limitan la venta de este producto a médicos colegiados o por prescripción de un médico colegiado.
	Abrir aquí
	Producto sanitario
	Frágil; manipular con cuidado
	Mantener seco
	Este lado hacia arriba

Precaución: Las leyes federales estadounidenses restringen la venta de este producto a médicos o por prescripción facultativa.

Producto de México

Este documento solo es válido en la fecha de impresión. Si no está seguro de la fecha de impresión, vuelva a imprimirlo para asegurarse de estar utilizando la última versión de las instrucciones de uso (disponibles en www.e-ifu.com). El usuario es responsable de asegurarse de utilizar las instrucciones de uso más recientes.

℞ only

Inledning/beskrivning:
VERITAS Advanced Infusion-paket eller VERITAS Advanced Fluidics-paket är ett DUBBELPUMP-paket som innehåller alla slangset och tillbehör som behövs för att genomföra en sköljnings- och aspirationsprocedur eller en fakoemulsifieringsprocedur. VERITAS Advanced Infusion-paketet innehåller en extra slang som leder tryckluft till källan med sköljlösning. Varje paket består av följande artiklar:

1. Kassett- och slangenhet
2. Skyddsdrapering för monitor
3. Mayo skyddsdrapering för stativ
4. Testkammare

Avsedd användning:
VERITAS Advanced Infusion-paket eller VERITAS Advanced Fluidics-paket innehåller kassett- och slangenheten och är avsedda för sköljning och aspiration vid kataraktkirurgi i främre ögonsegmentet. Det används med VERITAS™ Vision-systemet. Testkammaren är avsedd för att verifiera korrekt anslutning och funktion hos sköljnings-/aspirationsfunktionen före det kirurgiska ingreppet.

Produktbilder:

VERITAS Advanced Fluidics-paket

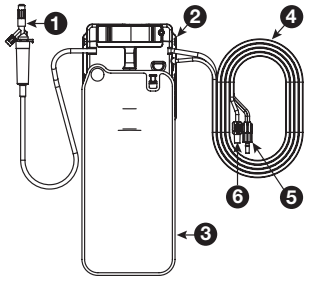

VERITAS Advanced Infusion-paket



1. Sköljspets (till spolkälla)
2. Kassett
3. Dränagepåse
4. I/A-slangset (till handstycke)
5. Luerlock-fattning för sköljning
6. Aspirationsfattning

Endast VERITAS Advanced Infusion-paket:
7. Infusionsslang
8. Infusionsanslutning (till konsol)

Indikationer/kontraindikationer/avsedd patient/avsedd användare:
All relevant information angående indikationer/kontraindikationer/avsedd patient/avsedd användare beskrivs i användarmanualen till fakoemulsifieringssystemet från Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. (”användarmanualen”). Kontraindikationer: Befintliga hälsotillstånd hos patienten som enligt vårdgivarens bedömning utgör en kontraindikation för kataraktkirurgi. Avsedda patienter inkluderar vuxna patienter med katarakt eller vuxna patienter som genomgår oftalmisk kirurgi i främre ögonsegmentet (t.ex. avlägsnande av ögonlinsen). Obs! Gravida eller ammande kvinnor samt barn inkluderades inte i de genomförda kliniska prövningarna. Fakoemulsifieringssystemet från Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. är avsett att användas av en ögonläkare och operationspersonal som vägleds av kirurgen.

Kliniska fördelar/oönskade bieffekter/biverkningar:
All relevant information om klinisk nytta/oönskade bieffekter/biverkningar finns i användarmanualen. Kliniska fördelar med fakoemulsifieringssystemet från Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. innefattar följande: Snabb synrehabilitering, tidig återgång till dagliga aktiviteter, minimal ögoninflammation, minimal postoperativ astigmatism, minskad risk för okulära komplikationer. Komplikationer som kan förknippas med fakoemulsifieringssystemet från Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. inkluderar trasig linskapsel, brännskador på hornhinnan, infektion/inflammation samt hornhinneödem.

Bruksanvisning:
Följ nedanstående instruktioner för att installera VERITAS-paketet korrekt. VERITAS Advanced Infusion-paketet har ett extra steg som anges nedan. Advanced Infusion måste väljas i Programinställningar före operationen för att VERITAS Advanced Infusion-paketet ska kunna användas. Ytterligare instruktioner finns i användarmanualen. Inspektera produktbrickan visuellt innan du använder den och kontrollera att paketet är helt. Använd inte produkten om paketet är skadat.

1. Efter sterilt avlägsnande av allt innehåll från produktbrickan som är förseglad med lock ska KASSETTEN och SKÖLJSPETSEN överlämnas till den osterila sjuksköterskan. I/A-SLANGSETET ska vara kvar i det sterila området.
2. Placera skyddsdraperingen för monitorn över monitorn på VERITAS Vision-systemet.
3. Placera händerna i Mayo skyddsdrapering för stativ enligt markeringarna på draperingen och täck över VERITAS Vision-systemets brickarm.
4. För in KASSETTEN i fluidikpanelen på VERITAS Vision-systemet.
5. Tryck på KASSETTEN tills systemet aktiverar låsmekanismen som håller KASSETTEN på plats.
6. Bered källan med sköljlösning.
7. Avlägsna skyddet från toppen på SKÖLJSPETSEN.
8. Håll källan upprätt och för in SKÖLJSPETSEN rakt in i mitten av gummikorken utan att vrida om.
9. Häng källan på droppställningen och kläm sedan på och släpp droppkammaren tills den är fylld till hälften eller tre fjärdedelar.
10. Endast för VERITAS Advanced Infusion-paket: INFUSIONSSLANGEN har en svart INFUSIONSANSLUTNING i den fria änden. För in INFUSIONSANSLUTNINGEN i sidopanelen på VERITAS Vision-systemet och vrid den sedan medurs tills den klickar på plats. Då är den helt ansluten.
11. För handstycken utan låsbar sköljport ska du dra tillbaka kragen på LUERLOCKFATTNINGEN FÖR SKÖLJNING. Anslut luer-fattningen på I/A-SLANGSETET till handstycket. För handstycken utrustade med en låsbar sköljport ska du vrida kragen på LUERLOCK-FATTNINGEN FÖR SKÖLJNING medurs för att låsa fast fattningen på handstycket.
12. Fäst spets och spolpåse på handstycket enligt monteringsanvisningarna.
13. Från skärmen FLÖDNING/INSTÄLLNING på VERITAS Vision-systemet aktiverar du kontinuerlig spolning med handstyckets spets nedåt i en testkammare som inte är förseglad mot spolpåsen.
14. Fyll testkammaren med vätska så att all luft elimineras och för in testkammaren rakt och centrerat över spetsen och spolpåsen tills den är förseglad.
15. Inaktivera kontinuerlig spolning och utför flödningssekvensen enligt användarmanualen.

Allmänt:
Produkten innehåller inte ftalater.

Paketet är steriliserat med etylenoxid och är avsett för engångsbruk.

Förvara produkten på en sval, torr plats.

Försiktighetsåtgärder:

- Använd inte produkten efter det utgångsdatum som anges på produktens förpackningsetiketter.
- Innehållet är sterilt när produktbrickan är förseglad med locket och oskadad.
- Om produktens prestanda äventyras under användning ska du avbryta användningen och genomföra tillämpliga tester enligt beskrivningen i användarmanualen för systemet. Om resultaten inte är tillfredsställande byter du ut paketet enligt anvisningarna i användarmanualen.
- När du använder VERITAS Advanced Infusion-paketet får spolkällans effektiva totala höjd inte vara lägre än 30 cm när Advanced Infusion aktiveras.

Detta dokument gäller endast det datum det skrivits ut. Om du är osäker på utskriftsdatumet, skriv ut på nytt för att säkerställa att den senaste revisionen av bruksanvisningen används (finns på www.e-ifu.com). Onus finns hos användaren, för att säkerställa att den mest aktuella bruksanvisningen används.

Johnson & Johnson VISION

Z311979E B

- VERITAS Advanced Infusion-paket kan användas med sköljlösning i en flaska eller påse efter att flödning/inställning har slutförts. Flödning kanske inte kan utföras med alla påsar vilket kan leda till fördröjningar i behandlingen.

Varning:
Endast för engångsbruk. Denna produkt får inte omsteriliseras, ombearbetas eller återanvändas.

Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. medicintekniska produkter för engångsbruk är märkta med användar- och hanteringsinstruktioner för att minimera exponering för förhållanden som kan innebära fara för produkten, patienten eller användaren. Omsterilisering eller ombearbetning av medicintekniska produkter för engångsbruk från Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. kan leda till att produkten skadas eller inte fungerar som den ska, eller att patienten blir sjuk eller tar skada på grund av infektion, inflammation, produktkontaminering, smittoöverföring eller avsaknad av sterilitet.

Kassering:
Alla VERITAS-paket som har förorenats av blod, vävnad och/eller kroppsvätskor/-materia måste hanteras som medicinskt riskavfall i enlighet med sjukvårdsanläggningens protokoll och tillämpliga lokala krav.

Om VERITAS-paketet levereras i ett otillfredsställande skick ska du omedelbart kontakta din lokala säljrepresentant för Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Varje VERITAS-paket identifieras med ett lotnummer som finns på produktens förpackning och detta nummer ska anges i all korrespondens och alla diskussioner.

Avgiftsfritt telefonnummer inom USA: 1-877-266-4543.

Rapportering av allvarliga incidenter:
Kontakta din lokala representant för att rapportera alla klagomål om produkten eller biverkningar till Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Om produkten levereras i ett otillfredsställande skick ska du omedelbart kontakta din lokala säljrepresentant för Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Varje komponent identifieras av ett lotnummer och detta ska anges i all korrespondens och alla diskussioner. Avgiftsfritt telefonnummer inom USA: 1-877-266-4543.

Rapportering av allvarliga händelser (EU):
För en patient/användare/tredje part inom EU och i länder med samma regleringssystem: Om en allvarlig händelse inträffar under användningen av denna produkt eller till följd av dess användning ska det rapporteras till Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. och/eller dess auktoriserade representant samt relevanta tillsynsmyndigheter i det medlemsland där användaren och/eller patienten finns.

Symbol/titel (förklaring):

SYMBOL	TITEL (FÖRKLARING)
	Konsultera bruksanvisning eller elektronisk bruksanvisning
	Får inte återanvändas
STERILE EO	Steriliserad med etylenoxid
REF	Katalognummer
LOT	Batchkod
	Utgångsdatum
	Tillverkare
EC REP	Auktoriserad representant inom europeiska gemenskapen/ europeiska unionen
	Får inte omsteriliseras
	Importör

SYMBOL	TITEL (FÖRKLARING)
UDI	Unik produktidentifiering
CH REP	Auktoriserad representant i Schweiz
	Tillverkningsdatum
	Använd inte om förpackningen är skadad och se bruksanvisningen
EC	Europeiska gemenskapen/europeiska unionen
CH	Schweiz
	Förpackningsenhet
	Försiktighet
	Enkelt sterilt barriärsystem
Rx only	Försiktighet: Enligt federal lag får denna produkt endast säljas av eller på ordination av legitimerad sjukvårdspersonal.
	Öppnas här
MD	Medicinteknisk produkt
	Ömtålig, hanteras varsamt
	Förvaras torrt
	Denna sida upp

Försiktighet: Enligt amerikansk federal lag får denna produkt endast säljas av eller på ordination av läkare.

Tillverkad i Mexiko

Detta dokument gäller endast det datum det skrivits ut. Om du är osäker på utskriftsdatumet, skriv ut på nytt för att säkerställa att den senaste revisionen av bruksanvisningen används (finns på www.e-ifu.com). Onus finns hos användaren, för att säkerställa att den mest aktuella bruksanvisningen används.

℞ only

Sissejuhatus/kirjeldus.
Täiustatud infusioonikomplekt VERITAS või täiustatud vedelikutasakaalu komplekt VERITAS on KAKSIKPUMBAGA komplekt, mis sisaldab kõiki voolikuid ja tarvikuid, mida on vaja niisutus- ja aspiratsiooniprotseduuride või fakoemulsifikatsiooni protseduuri tegemiseks. Täiustatud infusioonikomplekt VERITAS sisaldab täiendavat voolikut, mis tagab niisutuslahenduse allika jaoks suruõhu. Igas pakendis on järgmised osad:

1. Kassetti ja voolikukoostu
2. Monitori kattelina
3. Mayo statiivi kattelina
4. Katsekambrit

Sihtotstarve.
Täiustatud infusioonikomplekt VERITAS või täiustatud vedelikutasakaalu komplekt VERITAS sisaldavad kasseti- ja voolikukoostu ning need on ette nähtud eesmise segmendi katarakti operatsiooni käigus niisutuse ja aspiratsiooni tegemiseks. Seda kasutatakse süsteemiga VERITAS™ Vision. Katsekambrit kasutatakse niisutus-/aspiratsioonifunktsiooni nõuetekohase ühenduvuse ja toimivuse kinnitamiseks enne kirurgilise protseduuri sooritamist.

Toote joonised.

Täiustatud vedelikutasakaalu komplekt VERITAS

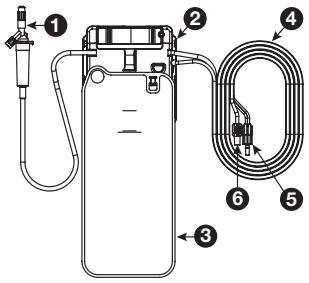

Täiustatud infusioonikomplekt VERITAS



1. Niisutusotsak (niisutusallikasse)
2. Kassett
3. Drenaažikott
4. Niisutus- ja aspiratsioonivoolikute komplekt (käsiseadmesse)
5. Luer-lukuga niisutusliitmik
6. Aspiratsiooniliitmik

Ainult täiustatud infusioonikomplekti VERITAS puhul:
7. Infusioonivoolik
8. Infusiooniliitmik (konsooli)

Näidustused / vastunäidustused / sihtpatsient / sihtkasutaja.
Kogu asjakohane teave näidustuste / vastunäidustuste / sihtpatsiendi / sihtkasutaja kohta on kirjeldatud ettevõtte Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. fakoemulsifikatsioonisüsteemi käsiraamatus („Käsiraamat"). Vastunäidustused Mis tahes olemasolevad patsiendi seisundid, mida tervishoiutöötaja loeb kaeoperatsiooni vastunäidustuseks. Patsientide sihtrühm on täiskasvanud patsiendid, kellel esineb kae, või täiskasvanud patsiendid, kellele tehakse silmaoperatsioon eesmises segmendis (nt silmaläätse eemaldamine). Märkus. Läbi viidud kliinilised uuringud ei hõlmanud rasedaid ja imetavaid naisi ega lapsi. Ettevõtte Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. fakoemulsifikatsioonisüsteem on ette nähtud kasutamiseks silmaarstile ja abipersonalile, kes töötavad kirurgi otsese juhendamise all.

Kliiniline kasu / soovimatud kõrvaltoimed / kõrvalnähud.
Kogu asjakohane teave kliinilise kasu / soovimatute kõrvaltoimete / kõrvalnähtude kohta on esitatud käsiraamatus. Ettevõtte Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. fakoemulsifikatsioonisüsteemi kliinilised kasud hõlmavad järgmist: nägemise kiire rehabilitatsioon, igapäevaste tegevuste varajane jätkamine, minimaalne silmapõletik, minimaalne operatsioonijärgne astigmatism, väiksem tõenäosus silma komplikatsioonide tekkimiseks. Ettevõtte Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. fakoemulsifikatsioonisüsteemiga seotud võimalikud kõrvaltoimed on kapsli purunemine, sarvkesta põletus, nakkus/põletik ja sarvkesta turse.

Kasutusjuhised.
Komplekti VERITAS nõuetekohaseks paigaldamiseks tutvuge järgmiste juhistega. Täiustatud infusioonikomplekti VERITAS kohta kehtib üks lisaetapp, nagu on allpool kirjeldatud. Täiustatud infusioonikomplekti VERITAS kasutamiseks tuleb enne operatsiooni tegemist valida programmi seadetes valida Täiustatud infusioon. Täiendavaid juhiseid vaadake käsiraamatust. Enne kasutamist kontrollige toodet visuaalselt pakendi terviklikkuse rikkumise suhtes. Ärge kasutage toodet, kui pakend on saanud kahjustada.

1. Pärast kaanega tootealuselt kogu sisu steriilset eemaldamist edastage KASSETT ja NIISUTUSOTSAK ringlusse (meditsiiniõele), samal ajal jätke NIISUTUS- JA ASPIRATSIOONIVOOLIKUTE KOMPLEKT steriilsele pinnale.
2. Asetage monitori kattelina süsteemi VERITAS Vision monitorile.
3. Asetage käed Mayo statiivi kattelinale vastavalt linal esitatud juhendmärgistustele ja süsteemi VERITAS Vision aluse laba.
4. Sisestage KASSETT süsteemi VERITAS Vision vedelikupaneeli.
5. Lükake KASSETTI seni, kuni süsteem käivitab KASSETI hoidmiseks sulgurmehhanismi.
6. Valmistage ette loputuslahuse allikas.
7. Eemaldage NIISUTUSOTSAKULT kaitse.
8. Hoidke allikat püstises asendis ja sisestage NIISUTUSOTSAK ilma keeramata kummikorgi keskele.
9. Riputage allikas veenitilguti postile ning seejärel pigistage ja vabastage tilgakamber siis, kui see on 1/2 kuni 3/4 ulatuses täis.
10. Ainult täiustatud infusioonikomplekti VERITAS puhul. INFUSIOONIVOOLIKU vabas otsas on must INFUSIOONILIITMIK. Sisestage INFUSIOONILIITMIK süsteemi VERITAS Vision külgpaneeli ja seejärel keerake seda päripäeva, kuni see täieliku ühendamise korral klõpsuga kinnitub.
11. Lukustatava niisutusavata käsiseadmetel tõmmake NIISUTAMISE LUER-LUKU LIITMIKU krae tagasi. Ühendage NIISUTUS- JA ASPIRATSIOONIVOOLIKUTE KOMPLEKTI Luer-tarvikud käsiseadmega. Lukustatava niisutusavaga käsiseadmetel pöörake NIISUTAMISE LUER-LUKU LIITMIKU kraed päripäeva, et lukustada liitmik käsiseadmega.
12. Kinnitage otsak ja niisutusseade kokkupaneku juhiste järgi otsikule.
13. Aktiveerige süsteemi VERITAS Vision kuval EELTÄITMINE/HÄÄLESTAMINE valik Pidev niisutamine, kui käsiseadme ots on testkambris allapoole suunatud, mitte loputustoru vastas.
14. Täitke katsekamber vedelikuga ja kõrvaldage kogu õhk ning sisestage katsekamber sirgelt ja tsentreeritult otsaku ning niisutusseadme peale, kuni need on kaetud.
15. Deaktiveerige valik Pidev niisutamine ja sooritage eeltäitmise järjestus vastavalt käsiraamatule.

Üldine.
Seade ei sisalda ftalaate.

Komplekti on steriliseeritud etüleenoksiidiga ja see on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.

Hoiustage toodet jahedas ja kuivas kohas.

Ettevaatusabinõud.

- Ärge kasutage toodet pärast tootepakendi sildile märgitud kõlblikkusaega.
- Kaanega suletud ja kahjustamata tootealuse sisu on steriilne.
- Kui toote toimivus saab kasutuse ajal kannatada, lõpetage toote kasutamine ja sooritage sobivad testid, nagu on kirjeldatud süsteemi käsiraamatus. Kui tulemused pole rahuldavad, vahetage komplekt välja vastavalt käsiraamatus kirjeldatud juhistele.
- Täiustatud infusioonikomplekti VERITAS kasutamise korral ei tohi niisutusallika efektiivne kogukõrgus olla madalamal kui 30 cm, kui täiustatud infusioonikomplekt on aktiveeritud.
- Täiustatud infusioonikomplekti VERITAS võib kasutada pudeli või koti kujul niisutuslahendustega pärast seda, kui valiku Eeltäitmine/häälestamine kasutamine on edukalt lõpetatud. Võimalik, et kõigi kottidega ei pruugi eeltäitmise lõpetamine olla edukas, mis võib põhjustada raviviivitusi.

See dokument kehtib ainult printimise kuupäeva seisuga. Kui te pole printimise kuupäevas kindel, printige dokument uuesti, et tagada kasutusjuhendi uusima versiooni kasutamine (saadaval lehel www.e-ifu.com). Kasutajal on kohustus tagada kõige ajakohasema kasutusjuhendi kasutamine.

Johnson & Johnson VISION

Hoiatus.

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Seadet ei tohi uuesti steriliseerida, ümber töödelda ega uuesti kasutada.

Ettevõtte Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. ühekordselt kasutatavate meditsiiniseadmetega on kaasas kasutus- ja käsitsemisjuhised, et vähendada kokkupuudet tingimustega, mis võivad toodet, patsienti või kasutajat kahjustada. Ettevõtte Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. ühekordselt kasutatavate meditsiiniseadmete korduskasutamine/taassteriliseerimine/taastöötlemine võib põhjustada meditsiiniseadme füüsilist kahjustamist, meditsiiniseadme toimimist ettenähtust erineval viisil ja nakkusest või põletikust tingitud patsiendi haigestumist või vigastust ja/või toote saastumisest, nakkuse edasikandumisest või toote mittesteriilsusest põhjustatud haigestumist.

Kasutuselt kõrvaldamine.

Komplekti VERITAS, mis on saastunud vere, kudede ja/või kehavedelike/-ainetega tuleb käsitleda bioloogiliselt ohtliku meditsiinijäätmena tervishoiuasutuse eeskirjade ja kohaldatavate kohalike nõuete järgi.

Kui komplekt VERITAS saabub ebarahuldavas seisukorras, võtke viivitamatult ühendust ettevõtte Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. kohaliku müügiesindusega. Iga komplekt VERITAS on tuvastatav tootepakendil esitatud partii numbri järgi ja selle peab lisama kõikidele kirjavahetustele või peab seda mainima kõikides vestlustes.

Tasuta telefoninumber USA-s: 1-877-266-4543.

Tõsistest vahejuhtumitest teatamine:

Ettevõtte Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. teavitamiseks kõikide tootealaste kaebuse ja/või kõrvaltoimete kohta võtke ühendust selle kohaliku esindajaga. Juhul kui toode on vastuvõtmisel mitterahuldavas seisukorras, võtke viivitamatult ühendust ettevõtte Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. kohaliku esinduse müügiosakonnaga. Iga komponent on tuvastatav partiinumbri järgi ja see tuleb edastada kirjalikult või suuliselt. Tasuta telefoninumber USA-s: 1-877-266-4543.

Tõsistest vahejuhtumitest teatamine (EL).

Patsiendile / kasutajale / kolmandale osapoolele Euroopa Liidus ja samaväärse reguleeriva korraga riikides: kui selle seadme kasutamise ajal või kasutamise tagajärjel on tekkinud tõsine vahejuhtum, tuleb sellest teavitada ettevõtet Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. ja/või selle volitatud esindajat ning selle liikmesriigi pädevat asutust, mis on kasutaja ja/või patsiendi elukohariigiks.

Sümbol/pealkiri (selgitus).

SÜMBOL	PEALKIRI (SELGITUS)
	Lugege kasutusjuhendit või elektroonset kasutusjuhendit
	Mitte korduskasutada
	Steriliseeritud etüleenoksiidiga
	Kataloginumber
	Partii kood
	Tarvitamise lõpptähtpäev
	Tootja
	Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses / Euroopa Liidus
	Mitte resteriliseerida
	Sissevedaja
	Seadme kordumatu identifitseerimistunnus
	Volitatud esindaja Šveitsis

SÜMBOL	PEALKIRI (SELGITUS)
	Tootmiskuupäev
	Ärge kasutage kui pakend on kahjustatud ja lugege kasutusjuhendit
	Euroopa Ühendus/Euroopa Liit
	Šveits
	Pakkeühik
	Ettevaatust!
	Ühekordne steriilne kaitsesüsteem
	Ettevaatust! Föderaalseadus lubab seda seadet müüa üksnes registreeritud tervishoiutöötajal või tema loal.
	Avage siit
	Meditsiiniseade
	Õrn, käsitseda ettevaatlikult
	Hoida kuivana
	See poole peab jääma üles

Ettevaatust! USA föderaalseadus lubab seda seadet müüa vaid arstil või arsti ettekirjutusel.

Toodetud Mehhikos

See dokument kehtib ainult printimise kuupäeva seisuga. Kui te pole printimise kuupäevas kindel, printige dokument uuesti, et tagada kasutusjuhendi uusima versiooni kasutamine (saadaval lehel www.e-ifu.com). Kasutajal on kohustus tagada kõige ajakohasema kasutusjuhendi kasutamine.

℞ only

简介/描述：

VERITAS 先进灌注包或 VERITAS 先进液流包是一种双泵包，提供了执行冲洗和抽吸操作或晶状体乳化术所需的所有导管和附件。VERITAS 先进灌注包含有一条额外的管路，用于向冲洗液源提供压缩空气。每个套件包都包含下列物品：

1. 导管盒和管路组件
2. 监控器罩
3. Mayo 支架罩
4. 测试箱

预期用途：

VERITAS 先进灌注包或 VERITAS 先进液流包含有导管盒和管路组件，用于在眼前段白内障手术期间执行冲洗和抽吸。它与 VERITAS™ Vision 系统搭配使用。测试箱的预期用途是在手术之前验证连接是否正确以及冲洗/抽吸功能是否正常。

产品图示：

VERITAS 先进液流包

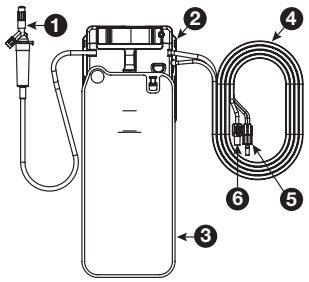

1. 冲洗针头（至冲洗源）
2. 导管盒
3. 废液袋
4. 冲洗/抽吸管组（至手持机头）
5. 冲洗鲁尔锁接头
6. 抽吸接头

VERITAS 先进灌注包

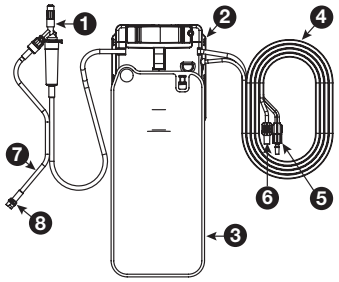

仅限 VERITAS 先进灌注包：
7. 灌注管线
8. 灌注连接器（至控制台）

适应症/禁忌症/目标患者/目标用户：

有关适应症/禁忌症/目标患者/目标用户的所有信息，请参见 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 超声乳化仪操作手册（简称“操作手册”）。禁忌症：医务人员认定为白内障手术禁忌症的任何既存病症。目标患者包括白内障成人患者或接受眼前段眼科手术（例如切除晶状体）的成人患者。注：所开展的临床试验未纳入妊娠期、哺乳期妇女或儿童。Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 超声乳化仪的目标用户为眼科医生和在外科医生指导下执行操作的支持人员。

临床获益/不良副作用/不良反应：

有关临床获益/不良副作用/不良反应的所有信息，请参见操作手册。Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 超声乳化仪的临床获益包括：快速恢复视力、尽快恢复日常活动、最大程度减少眼部炎症、最大程度减少术后散光、降低眼部并发症的可能性。可能与 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 超声乳化仪相关的并发症包括晶状体囊壁破裂、角膜灼伤、感染/炎症和角膜水肿。

使用说明：

请参阅以下说明了解如何正确安装 VERITAS 包。VERITAS 先进灌注包有一个额外步骤，如下所述。要使用 VERITAS 先进灌注包，手术前必须在“程序设置”中选择“先进灌注”。其他说明请参阅操作手册。使用前，目视检查产品托盘，以确认包装是否完好无损。如果包装已受损，请勿使用本产品。

1. 用无菌方法从带有封盖的产品托盘中取出所有内容物后，将导管盒和冲洗针头递给巡回护士，同时将冲洗/抽吸管组留在无菌区。
2. 将监控器罩盖在 VERITAS Vision 系统的监控器上。
3. 根据支架罩上的引导标记，将双手放入 Mayo 支架罩中，然后盖住 VERITAS Vision 系统的托盘臂。
4. 将导管盒插入 VERITAS Vision 系统的液流板中。
5. 推动导管盒直至系统激活闩锁装置，以固定导管盒。
6. 准备冲洗液源。
7. 取下冲洗针头尖端的保护罩。
8. 在冲洗液源保持竖直的情况下，将冲洗针头径直插入冲洗液源橡胶塞的中心，不要扭动。
9. 将冲洗液源挂在静脉输液架上，然后挤压并松开滴注室，直至 1/2 到 3/4 满。
10. 仅适用于 VERITAS 先进灌注包：灌注管线的自由端有一个黑色的灌注连接器。将该灌注连接器插入 VERITAS Vision 系统的侧面板中，然后顺时针旋转该连接器，直至完全连接后发出咔哒声为止。
11. 对于不带锁定冲洗口的手持机头，可收回冲洗鲁尔锁接头上的套管。将冲洗/抽吸管组的鲁尔接头连接至手持机头。对于配有锁定冲洗口的手持机头，可顺时针旋转冲洗鲁尔锁接头上的套管，以将接头锁定在手持机头上。
12. 按组装说明，将尖头和冲洗套筒连接至手持机头。
13. 在 VERITAS Vision 系统的“预灌注/微调”屏幕上，激活“连续冲洗”，使手持机头尖头朝下位于测试箱内，而冲洗套筒未将测试箱密封。
14. 向测试箱充注液体，以排空所有空气，然后将测试箱笔直插入，让其定位于尖头和冲洗套筒的中央，直至被密封。
15. 停用“连续冲洗”并根据操作手册执行预灌注序列。

一般信息：

本器械不含邻苯二甲酸盐。

本套件包已用环氧乙烷灭菌，仅供一次性使用。

请将产品存放在阴凉干燥的地方。

注意事项：

- 请勿在产品包装标签上标注的过期日期之后使用产品。
- 当产品托盘以封盖密封且未受损时，内容物为无菌状态。
- 若使用期间产品性能受损，请停止使用并执行适当测试，详情请参阅系统的操作手册。若测试结果不符合要求，请按照操作手册中的说明更换套件包。
- 使用 VERITAS 先进灌注包时，如果激活了“先进灌注”功能，则冲洗源的有效总高度不得低于 30 cm。
- 成功完成“预灌注/微调”后，VERITAS 先进灌注包可与瓶装或袋装冲洗液一起使用。并非各种袋都能成功完成预灌注，可能会导致治疗延误。

警告：

仅供一次性使用。请勿对本器械进行重新灭菌、重新处理或重复使用。

Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 一次性医疗器械带有使用和处理说明标签，以尽量避免发生可能会危及产品、患者或用户的情况。重新灭菌/重新处理 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 一次性医疗器械可能会对该医疗器械造成物理损坏，使之无法达到预期性能，使患者因感染和炎症而患病或受伤，及/或因产品污染、传染及产品未达无菌性而引起疾病。

处置：

VERITAS 包如果被血液、组织和/或体液/人体物质污染，应当作生物危害性医疗废物，根据医疗机构规程和适用的当地要求进行处理。

如果收到的 VERITAS 包不合格，请立即与您当地的 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 销售办事处联系。每个 VERITAS 包的包装标签上都标有批号，在任何通信或讨论中都应提及此批号。

美国境内联系电话：免费电话 1-877-266-4543。

严重事件报告：

请联系您当地的代表，向 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 报告所有产品投诉和/或不良事件。如果收到的产品不合格，请立即与您当地的 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 销售办事处联系。每个部件都标有批号，在任何通信或讨论中都应提及此批号。美国境内联系电话：免费电话 1-877-266-4543。

严重事件报告（欧盟）：

对于欧盟和具有相同监管制度的国家/地区的患者/用户/第三方，如果在使用本器械期间或由于使用本器械而发生严重事件，请将其报告给 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 和/或其授权代表以及用户和/或患者所在成员国的主管部门。

ZH

符号/标题(解释):

符号	标题(解释)
	参考使用说明或电子版使用说明
	请勿重复使用
	采用环氧乙烷灭菌
	产品编号
	批代码
	有效期
	制造商
	欧洲共同体/欧盟授权代表
	切勿重复灭菌
	进口商
	唯一器械标识符
	瑞士授权代表
	制造日期
	如果包装损坏,切勿使用并参考使用说明
	欧洲共同体/欧盟
	瑞士
	包装规格
	注意
	单层无菌屏障系统
	注意:美国联邦法律规定,本器械只能由执业医疗保健从业者销售或根据其医嘱销售。
	在此开启
	医疗器械
	易碎,小心轻放
	保持干燥
	此面朝上

注意:美国联邦法律规定,本器械只能由医生销售或根据其医嘱销售。

墨西哥产品

本文件仅于打印当日有效。如不确定打印日期,请重新打印以确保使用最新版的使用说明书 (IFU)
(可访问 www.e-ifu.com 获取)。用户有责任确保使用最新版本的 IFU。

℞ only

소개/설명:
VERITAS 고급형 주입 팩 또는 VERITAS 고급형 유체 팩은 세척 및 흡인 절차 또는 수정체유화 시술을 수행하는 데 필요한 일체의 튜브와 부속품을 제공하는 듀얼 펌프 팩입니다. VERITAS 고급형 주입 팩에는 세척액 공급원에 가압 공기를 제공하기 위한 추가 튜브 라인이 포함되어 있습니다. 각 팩은 다음과 같이 구성됩니다.

1. 카세트 및 튜브 어셈블리
2. 모니터 드레이프 커버
3. Mayo 스탠드 덮개 커버
4. 테스트 챔버

사용 목적:
VERITAS 고급형 주입 팩 또는 VERITAS 고급형 유체 팩은 카세트 및 튜브 어셈블리를 포함하며 전안부 백내장 수술 중에 세척 및 흡인을 수행하는 데 사용합니다. VERITAS™ Vision 시스템과 함께 사용됩니다. 테스트 챔버는 수술 절차 전에 세척/흡인 기능의 올바른 연결성과 기능을 확인하는 데 사용합니다.

제품 모양:

VERITAS 고급형 유체 팩

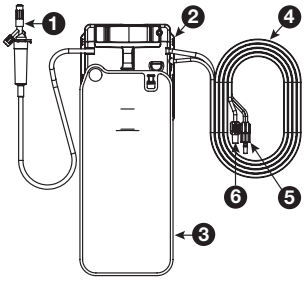

1. 세척 스파이크 (세척 공급원에 연결)
2. 카세트
3. 배출 백
4. I/A 튜브 세트 (핸드피스에 연결)
5. 세척 루어록 피팅
6. 흡인 피팅

VERITAS 고급형 주입 팩



VERITAS 고급형 주입 팩에만 해당:
7. 주입 라인
8. 주입 커넥터 (콘솔에 연결)

적응증/금기사항/대상 환자/대상 사용자:
적응증/금기사항/대상 환자/대상 사용자에 대한 모든 관련 정보는 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 수정체유화술 시스템 사용자 설명서 (" 사용자 설명서 ")에 기술되어 있습니다. 금기사항: 보건의료 제공자가 백내장 수술에 대한 금기사항이라고 판단하는 모든 선재성 환자 상태가 포함됩니다. 대상 환자에는 성인 백내장 환자 또는 전안부 안과 수술(예: 수정체 제거)을 받는 성인 환자가 포함됩니다. 참고: 임부, 수유부 또는 소아는 수행된 임상시험에 포함되지 않았습니다. Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 수정체유화술 시스템은 안과의 및 의사의 지시를 받는 보조 직원이 사용하는 용도입니다.

임상 유익성/바람직하지 않은 부작용/유해 영향:
임상 유익성/바람직하지 않은 부작용/유해 영향에 관한 모든 관련 정보는 사용자 설명서에 기술되어 있습니다. Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 수정체유화술 시스템의 임상 유익성에는 신속한 시력 재건, 일상 활동의 조기 재개, 안구 염증 최소화, 수술 후 난시 최소화, 잠재적 눈 합병증 감소가 포함됩니다. Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 수정체유화술 시스템과 관련 가능성이 있는 합병증에는 피막 손상, 각막 화상, 감염/염증 및 각막 부종이 포함됩니다.

사용 지침:
VERITAS 팩의 올바른 설치 방법은 아래 지침을 참조하십시오. VERITAS 고급형 주입 팩에는 아래 언급된 바와 같이 한 가지 추가 단계가 있습니다. VERITAS 고급형 주입 팩을 사용하려면, 수술 전 프로그램 설정에서 고급 주입을 선택해야 합니다. 기타 자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하시기 바랍니다. 사용하기 전에 제품 트레이의 포장 무결성 손상 여부를 육안으로 검사하십시오. 포장 무결성이 손상된 경우 제품을 사용하지 마십시오.

1. 뚜껑으로 밀봉된 제품 트레이에서 모든 내용물을 멸균 기법으로 꺼낸 후, I/A 튜브 세트는 멸균 영역에 남겨둔 상태로 카세트와 세척 스파이크를 순환 간호사에게 넘겨줍니다.
2. 모니터 드레이프 커버를 VERITAS Vision 시스템의 모니터 위에 배치합니다.
3. 드레이프의 가이드 표시에 따라 Mayo 스탠드 드레이프 커버에 손을 넣고 VERITAS Vision 시스템 트레이 암을 덮습니다.
4. 카세트를 VERITAS Vision 시스템의 유체 패널에 삽입합니다.
5. 시스템에서 잠금 메커니즘이 작동되어 카세트가 고정될 때까지 카세트를 누릅니다.
6. 세척액 공급원을 준비합니다.
7. 세척 스파이크의 팁에서 보호 장치를 제거합니다.
8. 세척액 공급원을 수직으로 세운 상태에서 세척 스파이크를 비틀지 말고 공급원의 고무 마개 중앙에 똑바로 삽입합니다.
9. 세척액 공급원을 I/V 폴에 걸고 드립 챔버를 눌렀다가 놓으면서 용기의 1/2~3/4이 채워지도록 합니다.
10. VERITAS 고급형 주입 팩 전용: 주입 라인의 자유 단부에는 검은색 주입 커넥터가 있습니다. 주입 커넥터를 VERITAS Vision 시스템의 측면 패널에 삽입한 다음 완전히 연결되어 딸깍 소리가 날 때까지 시계 방향으로 돌려 조여 주십시오.
11. 잠금 세척 포트가 없는 핸드피스의 경우 세척 루어록 피팅의 링을 잡아당기십시오. I/A 튜브 세트의 루어 피팅을 핸드피스에 연결합니다. 잠금 세척 포트가 장착된 핸드피스의 경우 세척 루어록 피팅의 링을 시계 방향으로 돌려 핸드피스에 잠금 고정시킵니다.
12. 조립 지침에 따라 팁과 세척 슬리브를 핸드피스에 부착합니다.
13. VERITAS Vision 시스템의 프라이밍/조정 화면에서 핸드피스 팁을 세척 슬리브에 밀봉되지 않은 테스트 챔버 안쪽에서 아래로 향하게 하고 연속 세척을 활성화합니다.
14. 테스트 챔버에 유체를 채워 모든 공기를 제거하고 테스트 챔버를 팁과 세척 슬리브 위로 중앙에 맞춰 밀폐될 때까지 똑바로 삽입합니다.
15. 연속 세척을 비활성화하고 사용자 설명서에 따라 준비 시퀀스를 수행합니다.

일반 사항:
장치에는 프탈레이트가 함유되어 있지 않습니다.

팩은 에틸렌옥사이드로 멸균 처리되며 일회용으로 설계되었습니다.

제품을 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.

주의 사항:

- 제품 포장 라벨에 표시된 유효 기간 이후에는 제품을 사용하지 마십시오.
- 제품 트레이가 뚜껑으로 밀봉을 유지하고 손상되지 않는 한 내용물의 멸균 상태가 유지됩니다.
- 사용 중 제품 성능이 저하된 경우 사용을 중단하고 시스템의 사용자 설명서에 따라 적절한 테스트를 수행하십시오. 결과가 만족스럽지 않은 경우 사용자 설명서에 명시된 지침에 따라 팩을 교체하십시오.
- VERITAS 고급형 주입 팩을 사용할 때, 고급 주입이 활성화된 경우 세척액 공급원의 유효 총 높이는 30cm보다 낮아질 수 없습니다.
- VERITAS 고급형 주입 팩은 성공적인 프라이밍/조정이 완료된 후 병이나 백에 담긴 세척액을 함께 사용할 수 있습니다. 모든 백이 프라이밍을 성공적으로 완료하는 것이 아닐 수 있으며, 이로 인해 치료가 지연될 수 있습니다.

경고:
본 제품은 일회용입니다. 재멸균, 재처리 또는 재사용하지 마십시오.

Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 일회용 의료기기에는 제품을 손상시키거나 환자 또는 사용자를 위험에 빠뜨릴 수 있는 조건에 노출되는 것을 최소화하도록 사용 및 취급 지침이 표시된 라벨이 부착되어 있습니다. Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 일회용 의료기기를 재멸균/재처리할 경우 의료기기의 물리적 손상, 의료기기의 기능 장애, 제품 오염, 감염 전염, 제품 무균상태 불량으로 인한 감염, 염증 및/또는 질환으로 인한 환자 질병 또는 상해가 유발될 수 있습니다.

폐기:
혈액, 조직 및/또는 체액/물질로 오염된 모든 VERITAS 팩은 의료 시설 프로토콜 및 해당하는 현지 요구 사항에 따라 생물학적 유해 의료 폐기물로 취급해야 합니다.

배송된 VERITAS 팩에 문제가 있는 경우 즉시 해당 지역의 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 판매점에 문의하시기 바랍니다. 각 VERITAS 팩은 제품의 포장 라벨 위 로트 번호로 식별되며 이 번호는 모든 연락이나 상담 시에 필요합니다.

전화번호(미국): 무료 1-877-266-4543.

심각한 사고 보고:
모든 제품 불만 및/또는 이상사례 사고는 현지 대리점에 연락하여 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.에 보고하십시오. 만족스럽지 않은 상태의 제품을 수령한 경우 현지 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 영업 사무소로 즉시 연락하십시오. 각 구성 요소는 로트 번호로 식별되며 이 번호는 모든 해당 절차와 상담 시에 필요합니다. 전화번호(미국): 무료 1-877-266-4543.

심각한 사고 보고(EU):
유럽 연합 및 동일한 규제 체제가 있는 국가의 환자/사용자/제3자의 경우, 이 장치를 사용하는 동안 또는 그 사용으로 인해 심각한 사고가 발생한 경우 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 및/또는 공인 대리점과 사용자 및/또는 환자가 위치한 회원국의 관할 당국에 이를 보고하십시오.

기호/제목(설명):

기호	제목(설명)
	사용 지침을 참조하거나 전자 사용 지침을 참조하십시오.
	재사용 금지
STERILE EO	에틸렌옥사이드로 멸균됨
REF	카탈로그 번호
LOT	배치 코드
	사용 기한
	제조업체
EC REP	유럽 공동체/유럽 연합 공식 대리점
	재멸균 금지
	수입업체
UDI	고유 장치 식별자
CH REP	스위스 공식 대리점
	제조일자
	포장이 손상된 경우 사용 금지 및 사용 지침 참조
EC	유럽 공동체/유럽 연합
CH	스위스
	포장 단위
	주의
	단일 멸균 차단 시스템
Rx only	주의: 미국 연방법에 따라 본 장치는 면허가 있는 의료전문가가 직접 판매하거나 면허가 있는 의료전문가의 지시에 의해서 판매할 수 있습니다.
	개봉 위치
MD	의료기기

기호	제목(설명)
	깨지기 쉬움, 취급 주의
	건조한 상태 유지
	이쪽을 위로

주의: 미국 연방법에 따라 본 장치는 의사가 직접 판매하거나 의사의 지시에 의해서 판매할 수 있습니다.

멕시코 제품

ZH VERITAS™ 先進注入組件 - REF VRT-AI VERITAS™ 先進流體組件 - REF VRT-AF

℞ only

簡介/說明：

VERITAS 先進注入組件或 VERITAS 先進流體組件為雙幫浦組件，可提供執行沖洗與抽吸程序或超音波乳化程序所需的所有管路和配件。VERITAS 先進注入組件包含一條額外的管道管線，用於向沖洗液源頭提供壓縮空氣。每個組件包含以下項目：

1. 卡匣及管路組件
2. 監視器防護罩
3. Mayo 器械盤套
4. 測試腔室

預期目的：

VERITAS 先進注入組件或 VERITAS 先進流體組件包含卡匣及管路組件，旨在前節白內障手術期間執行沖洗與抽吸。其與 VERITAS™ Vision 系統搭配使用。測試腔室旨在進行手術程序前，驗證沖洗/抽吸功能已正確連接且功能正常。

產品圖：

VERITAS 先進流體組件

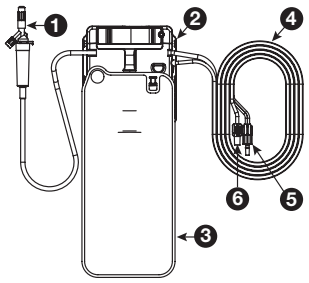

VERITAS 先進注入組件



1. 沖洗針 (至沖洗源頭)
2. 卡匣
3. 引流袋
4. 沖洗/抽吸管路組件 (至手持機)
5. 沖洗 Luer 鎖定接頭
6. 抽吸接頭

僅限 VERITAS 先進注入組件：
7. 注入管線
8. 注入接頭 (至控制台)

適應症/禁忌症/預期患者/預期使用者：

《Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 超音波乳化系統操作手冊》(以下稱《操作手冊》) 中，說明了適應症/禁忌症/預期患者/預期使用者的所有相關資訊。禁忌症：醫療照護提供者確定為白內障手術禁忌症的任何先前既有患者病症。預期患者包括白內障成人患者或接受前節眼科手術 (例如摘除水晶體) 的成人患者。註：孕婦、哺乳期婦女或兒童並未包括在已執行的臨床試驗中。Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 超音波乳化系統旨在供眼科醫師和在外科醫師指示下操作的支援人員使用。

臨床效益/不良副作用/不良反應：

《操作手冊》中介紹了有關臨床效益/不良副作用/不良反應的所有相關資訊。Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 超音波乳化系統的臨床效益包括：視覺康復快速、盡早恢復日常活動、最低程度的眼部發炎、最低程度的術後散光、減少眼部併發症的可能性。Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 超音波乳化系統的相關併發症包括外膜 (capsule) 破裂、角膜灼傷、感染/發炎和角膜水腫。

使用說明：

關於如何正確安裝 VERITAS 組件的相關資訊，請參閱下列說明。VERITAS 先進注入組件有一個額外步驟，如下所述。若要使用 VERITAS 先進注入組件，必須在進行手術前，先在「程序設定」中選取「先進注入」。如需其他說明，請參閱《操作手冊》。使用前，請先目視檢查產品托盤的包裝完整性是否遭破壞。如果包裝的完整性遭到破壞，請勿使用該產品。

1. 在以無菌方式從蓋子密封的產品托盤取出所有內容物之後，將卡匣與沖洗針移交給流動護理師，但沖洗/抽吸管路組件將保留在無菌區。
2. 將監視器防護罩置於 VERITAS Vision 系統的監視器上。
3. 依照 Mayo 器械盤套的指示標記，將雙手置於其中，並蓋住 VERITAS Vision 系統托盤臂。
4. 將卡匣插入 VERITAS Vision 系統的流體面板。
5. 將卡匣推入，直到系統啟動閂鎖機制卡住卡匣。
6. 準備沖洗液源頭。
7. 移除沖洗針尖端的保護套。
8. 保持源頭直立，將沖洗針直直插入橡膠源頭塞的中心，不得扭轉。
9. 將源頭掛在靜脈輸液架上，之後擠壓並釋放滴注器，直至達 1/2 至 3/4 滿。
10. 僅適用於 VERITAS 先進注入組件：注入管線的懸空端有一個黑色注入接頭。請將注入接頭插入 VERITAS Vision 系統的側面板，然後將其順時針轉動，直到完全連接時發出喀噠聲為止。
11. 若為無鎖定沖洗口的手持機，請縮回沖洗 LUER 鎖定接頭上的套環。將沖洗/抽吸管路組件的 Luer 接頭連接至手持機。若為配備鎖定沖洗口的手持機，請順時針轉動沖洗 LUER 鎖定接頭上的套環，將接頭鎖至手持機。
12. 按照組件說明，將吸頭與沖洗套管連接至手持機。
13. 手持機吸頭朝下，置於測試腔室內且不與沖洗套管密封，從 VERITAS Vision 系統的「灌注/調整」畫面啟動「連續沖洗」。
14. 將測試腔室充滿液體，排除所有空氣並將測試腔室直直插入，使其在吸頭和沖洗套管中置中，直至密封。
15. 停止「連續沖洗」，並依照《操作手冊》執行灌注序列。

一般事項：

裝置不含鄰苯二甲酸酯類。

組件已使用環氧乙烷滅菌且設計為單次使用。

請將產品存放在涼爽乾燥的地方。

注意事項：

- 若已超過產品包裝標籤上所標示的有效期限，請勿使用產品。
- 產品托盤由蓋子密封且未受損時內容物為無菌狀態。
- 若產品性能在使用期間受到損害，請停止使用，並依系統《操作手冊》詳述，執行適當的測試。若結果不理想，請依照《操作手冊》所列說明更換組件。
- 使用 VERITAS 先進注入組件時，若啟動「先進注入」，沖洗源頭的有效總計高度不可低於 30 cm。
- 在「灌注/調整」順利完成後，VERITAS 先進注入組件可搭配瓶中或袋中的沖洗液使用。並非所有袋子皆能順利完成灌注，因此可能導致治療延遲。

警告：

僅限單次使用。請勿對本裝置重複滅菌、重新處理或將其重複使用。

Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 單次使用醫療裝置均有標示使用與操作說明，以降低暴露於可能危及產品、患者或操作者之條件的風險。重複滅菌/重新處理 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 單次使用醫療裝置，可能會對醫療裝置產生實體損害、使醫療裝置無法如預期運作，以及患者由於感染、發炎和/或染病 (由於產品污染、感染源傳染及產品非無菌) 而生病或受傷。

棄置處理：

任何受到血液、組織和/或體液/物質污染的 VERITAS 組件，應依據醫療機構規定及適用的當地要求，將其視為生物危害性醫療廢棄物處理。

如果對收到的 VERITAS 組件不滿意，請立即與當地的 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 業務辦公室聯絡。每個 VERITAS 組件均由產品包裝標籤上的批號標識，在任何信件或討論中都應包括該批號。

在美國者，請致電：免付費電話 1-877-266-4543。

嚴重事件通報：

請聯絡當地代表，以向 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 通報所有產品投訴和/或不良事件。若對收到的產品不滿意，請立即與當地的 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 業務辦公室聯絡。每個組件均由批號標識，在任何信件或討論中都應包括該批號。在美國，請致電：免付費電話 1-877-266-4543。

嚴重事件通報 (歐盟)：

若患者/使用者/第三方位於歐盟及採行相同法規體制之國家/地區；若在使用本裝置期間，或因使用本裝置而導致，發生嚴重事件，請向 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 和/或其授權代表，以及使用者和/或患者所在之會員國主管機關通報。

ZH

符號/標題 (說明)：

符號	標題 (說明)
	參閱使用說明或是電子版使用說明
	請勿重複使用
STERILE EO	已使用環氧乙烷滅菌
REF	型錄編號
LOT	批次代碼
	使用期限
	製造商
EC REP	歐洲共同體/歐盟內授權代表
	請勿重複滅菌
	進口商
UDI	單一裝置識別碼
CH REP	瑞士授權代表
	製造日期
	若包裝破損請勿使用，並參閱使用說明
EC	歐洲共同體/歐盟
CH	瑞士
	包裝單位
	注意
	單一無菌屏障系統
Rx only	注意：美國聯邦法律限制本裝置只能由執業醫事人員銷售或依據其醫囑銷售。
	由此開啟
MD	醫療裝置
	易碎品，請小心處理
	保持乾燥
	此面向上

注意：聯邦 (美國)法律限制本裝置只能由醫師銷售或依據醫囑銷售。

墨西哥產品

℞ only

概要/説明:

VERITAS Advanced Infusion パックまたは VERITAS Advanced Fluidics パックは、灌流および吸引処置または水晶体超音波乳化吸引処置の実施に必要なすべてのチューブと付属品を備えたデュアルポンプパックです。VERITAS Advanced Infusion パックには、灌流液源に加圧空気を供給するための追加の配管ラインが含まれています。各パックの内容は次のとおりです。

1. カセットおよびチューブアセンブリ
2. モニタードレープカバー
3. Mayo スタンドドレープカバー
4. テストチャンバー

目的:

VERITAS Advanced Infusion パックまたは VERITAS Advanced Fluidics パックには、カセットとチューブアセンブリが含まれており、前眼房部の白内障手術中の灌流と吸引に使用することを目的としています。VERITAS™ Vision システムで使用します。テストチャンバーは、灌流/吸引機能の接続性と機能性が適切であることを、手術前に確認することを目的としています。

製品図:

VERITAS Advanced Fluidics パック

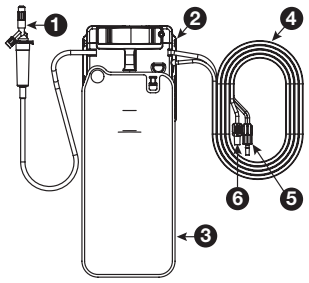

1. 灌流スパイク（灌流源へ）
2. カセット
3. 排液バッグ
4. I/A チューブセット（ハンドピースへ）
5. 灌流ルアーロックフィッティング
6. 吸引フィッティング

VERITAS Advanced Infusion パック



VERITAS Advanced Infusion パックのみ:
7. 輸液ライン
8. 輸液コネクタ（コンソールへ）

適応/禁忌/対象患者/対象ユーザー:

適応/禁忌/対象患者/対象ユーザーの関連情報は、Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 水晶体超音波乳化吸引システムオペレータマニュアル（以下、「オペレータマニュアル」）に記載されています。禁忌：医療提供者が白内障手術の禁忌であると判断した、あらゆる既存の患者状態。対象患者には、白内障の成人患者または前眼部眼科手術（水晶体除去など）を受ける成人患者が含まれます。注：妊娠中、授乳中の女性、または子供への臨床試験は行われていません。Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 水晶体超音波乳化吸引システムは、眼科医、および外科医の指示の下で作業する補助スタッフによる使用を目的としています。

臨床上の利点/望ましくない副作用/有害な影響:

臨床上の利点/望ましくない副作用/有害な影響に関するすべての関連情報は、オペレータマニュアルに記載されています。Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 水晶体超音波乳化吸引システムの臨床上の利点は次のとおりです。迅速な視力リハビリテーション、日常活動の早期再開、眼の炎症の抑制、術後乱視の抑制、眼の合併症リスクの低減。Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 水晶体超音波乳化吸引システムに関連する可能性のある合併症には、水晶体嚢の破損、角膜の火傷、感染症/炎症、および角膜浮腫などがあります。

使用法:

ここでは、VERITAS パックの正しい取り付け方法について説明します。VERITAS Advanced Infusion パックに関しては、下記に示すように、追加手順が 1 つあります。VERITAS Advanced Infusion パックを使用するには、手術前に［プログラム］設定で［Advanced 輸液］を選択しておく必要があります。詳細については、オペレータマニュアルを参照してください。使用前に、製品トレイの包装に破損がないか、目視で確認してください。包装が破損していた場合、製品は使用しないでください。

1. 蓋で密閉された製品トレイから内容物をすべて滅菌状態で取り出した後、I/A チューブセットを滅菌野内に維持しながら、カセットおよび灌流スパイクを外回り担当（看護師）に渡します。
2. VERITAS Vision システムのモニター上にモニタードレープカバーをかけます。
3. ドレープのガイドマークに従って、Mayo スタンドドレープカバー内に手を入れ、VERITAS Vision システムのトレイアームを覆います。
4. VERITAS Vision システムのフルイディクスパネルにカセットを挿入します。
5. システムのラッチ機構によりカセットが固定されるまで、カセットを押し込みます。
6. 灌流液源を準備します。
7. 灌流スパイクの先端からプロテクターを外します。
8. 灌流液源を直立させた状態で、灌流スパイクをねじらないように真っすぐゴム栓の中央に挿入します。
9. I/V ポールに灌流液源を掛け、点滴チャンバーを握って全体の 1/2 から 3/4 が満たされたところで放します。
10. VERITAS Advanced Infusion パックのみ：輸液ラインの自由端には、黒色の輸液コネクタが付いています。輸液コネクタを VERITAS Vision システムのサイドパネルに挿入し、カチッと音がするまで時計回り方向に回して、完全に接続させます。
11. ロック式灌流ポートのないハンドピースの場合は、灌流ルアーロックフィッティングのカラーを引っ込めます。I/A チューブセットのルアーフィッティングをハンドピースに接続します。ロック式灌流ポートを備えたハンドピースの場合は、灌流ルアーロックフィッティングのカラーを時計回り方向に回して、フィッティングをハンドピースに固定します。
12. 組み立て説明に従い、先端と灌流スリーブをハンドピースに取り付けます。
13. 灌流スリーブに対して密閉されていないテストチャンバー内でハンドピースの先端を下向きにした状態で、VERITAS VISION システムの［プライム/チューン］画面で［連続灌流］を有効にします。
14. テストチャンバーを液で満たして完全に空気を抜き、先端と灌流スリーブの中央にテストチャンバーを真っすぐに挿入して密閉状態にします。
15. ［連続灌流］を無効にし、オペレータマニュアルに従ってプライム手順を実行します。

一般:

本製品にフタル酸エステルは含まれていません。

パックはエチレンオキサイドを使用して滅菌されており、再使用はできません。

製品は、涼しく乾燥した場所に保管してください。

注意事項:

- 包装ラベルに記載されている有効期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- 製品の内容物は、製品トレイの蓋が正しく密閉されている限り、滅菌状態に保たれます。
- 使用中に製品性能が低下したときは、使用を中止し、システムのオペレータマニュアルに従い適切なテストを実施してください。結果が不良なときは、パックをオペレータマニュアルに従って交換してください。
- VERITAS Advanced Infusion パックを使用する場合、Advanced Infusion の作動時は、灌流源の有効全高が 30 cm より低くなってはなりません。
- VERITAS Advanced Infusion パックは、プライム/チューンが正常に完了した後に、ボトルまたはバッグ入りの灌流液を使用することができます。すべてのバッグでプライムが正常に完了するとは限らず、結果として治療が遅れる可能性があります。

この文書は、印刷日のみ有効です。印刷日が不明な場合は、最新の改訂版の IFU（www.e-ifu.com で入手可能）を使用するために、再印刷してください。最新の IFU を使用していることを確認する責任は、使用者にあります。

JA

警告：

単回使用製品です。本製品の再滅菌、洗浄・消毒、再使用はしないでください。

Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.単回使用医療機器のラベルには、使用法とともに、製品、患者、ユーザーを危険にさらす可能性のある状況への暴露を最小限に抑えるための取り扱い方法が記載されています。Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 単回使用医療機器の再滅菌/洗浄・消毒は、医療機器に物理的な損傷を与えたり、医療機器の意図した機能を妨げる可能性があるだけでなく、感染や炎症による患者の病気や傷害を引き起こしたり、製品の汚染、感染症の伝播、製品の無菌性欠如による病気を発生させるおそれがあります。

廃棄：

VERITAS パックが、血液、組織、その他の人体由来の液体/物質で汚染された場合は、医療施設の規則および該当する地域の要件に従って、バイオハザード医療廃棄物として取り扱う必要があります。

お手元の VERITAS パックに異常が認められる場合には、直ちに最寄りの Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 販売担当者までご連絡ください。ご連絡時には、各 VERITAS パックを識別するために、製品の包装ラベルにあるロット番号をご用意ください。

米国内の場合は、フリーダイヤル：1-877-266-4543 までお電話ください。

重大な事故についての報告：

製品に関する苦情および有害事象を Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. に報告される場合は、最寄りの代理店までご連絡ください。お手元の製品に異常が認められる場合には、直ちに最寄りの Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 販売担当者までご連絡ください。ご連絡時には、各コンポーネントを識別するために、ロット番号をご用意ください。米国内の場合は、フリーダイヤル：1-877-266-4543 までお電話ください。

重大な事故についての報告（EU）：

欧州連合および同様の規制体制の定められた国の患者/ユーザー/第三者において、本製品の使用中または使用後の結果として重大な事故が発生した場合は、Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. またはその指定代理人に連絡するとともに、ユーザーや患者が居住する加盟国の管轄当局に報告してください。

記号/タイトル（説明）：

記号	タイトル（説明）
	取扱説明書または電子取扱説明書を参照
	再使用不可
STERILE EO	エチレンオキサイドを使用して滅菌
REF	カタログ番号
LOT	バッチコード
	使用期限
	製造業者
EC REP	欧州共同体/欧州連合における指定代理人
	再滅菌禁止
	輸入業者
UDI	機器固有識別子
CH REP	スイスにおける指定代理人
	製造年月日
	包装が破損している場合は使用せず、取扱説明書を参照
EC	欧州共同体/欧州連合
CH	スイス
	包装単位
	注意
	シングル滅菌バリアシステム
Rx only	注意：米国連邦法に基づき、本製品は資格を有する医療従事者による指示または注文に応じてのみ販売されます。
	ここを開く
MD	医療機器
	壊れ物、取り扱いに注意
	湿気厳禁
	こちらが上側

注意：米国連邦法に基づき、本製品は医師による指示または注文に応じてのみ販売されます。

メキシコ製

℞ only

Wprowadzenie/opis:
Zaawansowany zestaw do infuzji VERITAS lub zaawansowany zestaw do zarządzania płynami VERITAS to zestaw do obsługi DWÓCH POMP, który zawiera wszystkie przewody i akcesoria niezbędne do przeprowadzenia procedury irygacji i aspiracji lub zabiegu fakoemulsyfikacji. Zaawansowany zestaw do infuzji VERITAS zawiera dodatkowy przewód do dostarczania sprężonego powietrza do pojemnika z roztworem do irygacji. Zawartość każdego zestawu:

1. Kaseta i zestaw przewodów
2. Serweta do przykrycia monitora
3. Serweta do przykrycia stolika Mayo na instrumenty
4. Komora testowa

Przeznaczenie:
Zaawansowany zestaw do infuzji VERITAS lub zaawansowany zestaw do zarządzania płynami VERITAS zawiera kasetę oraz zestaw przewodów i służy do przeprowadzenia procedury irygacji i aspiracji podczas zabiegu leczenia zaćmy na odcinku przednim oka. Do stosowania z aparatem VERITAS™ Vision. Komora testowa służy do sprawdzania poprawności połączenia i działania funkcji irygacji/aspiracji przed zabiegiem chirurgicznym.

Szkic produktu:
Zaawansowany zestaw do zarządzania płynami VERITAS

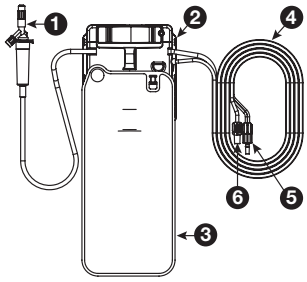

1. Kolec do przebijania pojemnika z roztworem do irygacji
2. Kaseta
3. Worek do drenażu

Zaawansowany zestaw do infuzji VERITAS



4. Zestaw przewodów do irygacji/aspiracji (do podłączenia do głowicy)
5. Złącze Luer Lock do irygacji
6. Złącze do aspiracji

Dotyczy tylko zaawansowanego zestawu do infuzji VERITAS:
7. Linia do infuzji
8. Złącze do infuzji (do podłączenia do konsoli)

Wskazania / przeciwwskazania / docelowy pacjent / docelowy użytkownik:
Wszelkie istotne informacje dotyczące wskazań / przeciwwskazań / docelowego pacjenta / docelowego użytkownika przedstawiono w podręczniku użytkownika aparatu do fakoemulsyfikacji firmy Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc („Podręczniku użytkownika"). Przeciwwskazania: wszelkie istniejące wcześniej u pacjenta schorzenia, które personel medyczny uzna za przeciwwskazanie do operacji zaćmy. Docelowymi pacjentami są dorośli pacjenci z zaćmą lub dorośli pacjenci poddawani okulistycznym operacjom przedniego odcinka oka (np. zabiegom usunięcia soczewki krystalicznej). Uwaga: do przeprowadzonych badań klinicznych nie włączono kobiet w ciąży, karmiących ani dzieci. Aparat do fakoemulsyfikacji firmy Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. jest przeznaczony do stosowania przez lekarza okulistę i personel pomocniczy pracujący pod kierownictwem chirurga.

Korzyści kliniczne / niepożądane skutki uboczne / działania niepożądane:
Wszystkie istotne informacje dotyczące korzyści klinicznych / niepożądanych skutków ubocznych / działań niepożądanych przedstawiono w podręczniku użytkownika. Korzyści kliniczne wynikające ze stosowania aparatu do fakoemulsyfikacji firmy Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. obejmują: szybką rehabilitację wzroku, wczesne wznowienie codziennych czynności, zminimalizowanie stanu zapalnego oczu, zminimalizowanie astygmatyzmu pooperacyjnego, zmniejszenie ryzyka powikłań ocznych. Powikłania, które mogą być związane z aparatem do fakoemulsyfikacji firmy Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc., obejmują: pęknięcie torebki soczewki, oparzenie rogówki, infekcję/zapalenie i obrzęk rogówki.

Instrukcje użycia:
Niniejsza instrukcja zawiera informacje na temat prawidłowej instalacji zestawu VERITAS. W przypadku zaawansowanego zestawu do infuzji VERITAS należy wykonać jedną dodatkową czynność, jak opisano poniżej. Aby móc zastosować zaawansowany zestaw do infuzji VERITAS, należy przed zabiegiem wybrać opcję Zaawansowana infuzja w menu Ustawienia programu. Dodatkowe instrukcje znajdują się w podręczniku użytkownika. Przed użyciem należy sprawdzić wzrokowo tackę produktu pod kątem naruszenia integralności opakowania. Nie wolno używać produktu, jeżeli doszło do naruszenia integralności opakowania.

1. W warunkach sterylnych wyjąć całą zawartość tacki szczelnie zamkniętej pokrywą i przekazać KASETĘ i KOLEC DO PRZEBIJANIA POJEMNIKA Z ROZTWOREM DO IRYGACJI pielęgniarce operacyjnej, pozostawiając ZESTAW PRZEWODÓW DO IRYGACJI/ASPIRACJI w sterylnym polu.
2. Umieścić serwetę do przykrycia monitora na monitorze aparatu VERITAS Vision.
3. Umieścić ręce w serwecie do przykrycia stolika Mayo na instrumenty zgodnie z oznaczeniami na serwecie, a następnie przykryć tackę na ramieniu aparatu VERITAS Vision.
4. Włożyć KASETĘ do panelu układów strumieniowych aparatu VERITAS Vision.
5. Dociskać KASETĘ do momentu, aż aparat aktywuje mechanizm zaciskowy, blokując KASETĘ.
6. Przygotować pojemnik z roztworem do irygacji.
7. Zdjąć ochraniacz z końca KOLCA DO PRZEBIJANIA POJEMNIKA Z ROZTWOREM DO IRYGACJI.
8. Trzymając pojemnik pionowo, wprowadzić KOLEC DO PRZEBIJANIA POJEMNIKA Z ROZTWOREM DO IRYGACJI – nie przekręcając go – w środek gumowej zatyczki pojemnika.
9. Zawiesić pojemnik na stojaku do kroplówek, a następnie uciskać i zwalniać komorę kroplową, aż napełni się do 1/2–3/4 pojemności.
10. Tylko w przypadku zaawansowanego zestawu do infuzji VERITAS: LINIA DO INFUZJI na wolnym końcu jest wyposażona w czarne ZŁĄCZE DO INFUZJI. Włożyć ZŁĄCZE DO INFUZJI do gniazda na panelu bocznym aparatu VERITAS Vision, a następnie przekręcać je zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż będzie słyszalne kliknięcie oznaczające pełne podłączenie.
11. W przypadku głowic bez blokady portu do irygacji należy odsunąć kołnierz na ZŁĄCZU LUER LOCK DO IRYGACJI. Podłączyć złącze typu Luer po stronie ZESTAWU PRZEWODÓW DO IRYGACJI/ASPIRACJI do głowicy. W przypadku głowic wyposażonych w blokadę portu do irygacji w celu zablokowania złącza w głowicy należy obrócić kołnierz na ZŁĄCZU LUER LOCK DO IRYGACJI zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
12. Podłączyć końcówkę i rękaw irygacyjny do głowicy zgodnie z instrukcjami montażu.
13. Z poziomu ekranu NAPEŁNIANIE/DOSTRAJANIE aparatu VERITAS Vision aktywować tryb ciągłej irygacji, przy czym końcówka głowicy powinna być skierowana ku dołowi i powinna znajdować się wewnątrz komory testowej niepodłączonej do rękawa irygacyjnego.
14. Napełnić komorę testową płynem, usuwając z niej całe powietrze, a następnie w linii prostej nasuwać ją na końcówkę i rękaw irygacyjny aż do momentu ich szczelnego połączenia.
15. Wyłączyć tryb ciągłej irygacji i wykonać sekwencję napełniania zgodnie z instrukcją w podręczniku użytkownika.

Niniejszy dokument jest ważny jedynie w dniu wydrukowania. W przypadku braku pewności co do daty wydrukowania dokumentu, należy wydrukować go ponownie, aby mieć pewność, że jest używana aktualna wersja instrukcji użytkowania (dostępna na stronie internetowej www.e-ifu.com). Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że korzysta z aktualnej wersji instrukcji użytkowania.

PL

Uwagi ogólne:
Wyrób nie zawiera ftalanów.

Zestaw został poddany sterylizacji przy użyciu tlenku etylenu i jest przeznaczony do jednorazowego użytku.

Wyrób należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

Środki ostrożności:
- Wyrobu nie wolno używać po upływie daty ważności wskazanej na etykietach na opakowaniu.
- Jeżeli tacka wyrobu jest zapieczętowana i nieuszkodzona, jej zawartość zachowuje jałowość.
- Jeśli działanie wyrobu ulegnie pogorszeniu podczas użytkowania, należy przerwać jego eksploatację i przeprowadzić odpowiednie testy szczegółowo opisane w podręczniku użytkownika. W przypadku niezadowalających wyników takich testów należy wymienić zestaw zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku użytkownika.
- Podczas korzystania z zaawansowanego zestawu do infuzji VERITAS efektywna wysokość całkowita, na jakiej znajduje się pojemnik z roztworem do irygacji, nie może wynosić mniej niż 30 cm, gdy włączona jest opcja Zaawansowana infuzja.
- Zaawansowany zestaw do infuzji VERITAS można stosować z roztworem do irygacji w butelce lub worku po pomyślnym zakończeniu procesu napełniania/dostrajania. Niektóre worki mogą nie zostać prawidłowo napełnione, co może skutkować opóźnieniem leczenia.

Ostrzeżenie:
Wyrób przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Wyrobu nie wolno ponownie sterylizować, ponownie używać ani przygotowywać do ponownego użycia.

Jednorazowe wyroby medyczne firmy Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. są wyposażone w instrukcje użycia oraz obchodzenia się z nimi w sposób pozwalający na minimalne narażenie na warunki, które mogą obniżyć skuteczność produktu bądź zaszkodzić pacjentowi lub użytkownikowi. Ponowna sterylizacja / przygotowanie do ponownego użycia wyrobów medycznych jednorazowego użytku firmy Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. może prowadzić do fizycznego uszkodzenia wyrobu medycznego, jego nieprawidłowego działania, jak również do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta ze względu na zakażenie, stan zapalny i/lub choroby wynikające ze skażenia i niesterylności wyrobu oraz przeniesienia zakażenia.

Utylizacja:
Zestaw VERITAS, który został skażony krwią, tkanką i/lub płynami/substancjami ustrojowymi, należy traktować jako odpad medyczny stanowiący zagrożenie biologiczne, stosując się do protokołu placówki medycznej i lokalnie obowiązujących wymogów.

Jeżeli przy odbiorze stan zestawu VERITAS był niezadowalający, należy niezwłocznie skontaktować się z miejscowym działem sprzedaży firmy Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Każdy zestaw VERITAS można zidentyfikować na podstawie numeru serii znajdującego się na opakowaniu wyrobu i dlatego numer ten należy podawać w każdej korespondencji lub rozmowie.

Numer telefonu w USA: 1-877-266-4543 (bezpłatny).

Zgłaszanie poważnych incydentów:
Wszelkie zażalenia dotyczące produktu i/lub informacje o związanych z nim zdarzeniach niepożądanych należy przekazywać lokalnemu przedstawicielowi firmy Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. W przypadku stwierdzenia niezadowalającego stanu technicznego przy odbiorze produktu należy natychmiast skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży firmy Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Każdą część identyfikuje się na podstawie numeru serii i dlatego należy go podawać w każdej korespondencji lub rozmowie. Numer telefonu w USA: 1-877-266-4543 (bezpłatny).

Zgłaszanie poważnych incydentów (UE):
Pacjenci / użytkownicy / osoby trzecie na terenie Unii Europejskiej i krajów o identycznym systemie prawnym – jeżeli podczas lub w wyniku użytkowania tego wyrobu doszło do poważnego incydentu, należy zgłosić ten fakt firmie Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. i/lub jej autoryzowanemu przedstawicielowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym przebywa użytkownik i/lub pacjent.

Symbol/tytuł (objaśnienie):

SYMBOL	TYTUŁ (OBJAŚNIENIE)
	Należy zapoznać się z instrukcją użycia lub instrukcją użycia w wersji elektronicznej
	Nie używać ponownie
	Wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu
	Numer katalogowy
	Numer partii
	Data ważności
	Producent
	Autoryzowany przedstawiciel na terenie Wspólnoty Europejskiej / Unii Europejskiej
	Nie sterylizować ponownie
	Importer
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu
	Autoryzowany przedstawiciel na terenie Szwajcarii
	Data produkcji
	Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone, i zapoznać się z instrukcją użycia
	Wspólnota Europejska / Unia Europejska
	Szwajcaria
	Jednostka opakowania
	Przestroga
	System pojedynczej bariery sterylnej
	Przestroga: prawo federalne dopuszcza sprzedaż tego wyrobu wyłącznie licencjonowanemu lekarzowi lub na jego zlecenie.
	Tu otwierać
	Wyrób medyczny
	Wyrób delikatny, zachować ostrożność
	Chronić przed wilgocią
	Tą stroną do góry

Przestroga: prawo federalne Stanów Zjednoczonych zezwala na sprzedaż tego wyrobu wyłącznie lekarzowi lub na jego zlecenie.

Wyprodukowano w Meksyku

Niniejszy dokument jest ważny jedynie w dniu wydrukowania. W przypadku braku pewności co do daty wydrukowania dokumentu, należy wydrukować go ponownie, aby mieć pewność, że jest używana aktualna wersja instrukcji użytkowania (dostępna na stronie internetowej www.e-ifu.com). Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że korzysta z aktualnej wersji instrukcji użytkowania.

Johnson & Johnson VISION

RU Комплект VERITAS™ для усовершенствованной инфузии — REF VRT-AI
Комплект VERITAS™ для усовершенствованного переливания жидкостей — REF VRT-AF

℞ only

Введение/описание

Комплект VERITAS для усовершенствованной инфузии или комплект VERITAS для усовершенствованного переливания жидкостей является комплектом со СДВОЕННЫМ НАСОСОМ, в рамках которого поставляется полный комплект трубок и принадлежностей, необходимых для выполнения процедуры промывания и аспирации или факоэмульсификации. В комплект VERITAS для усовершенствованной инфузии входит дополнительная трубка для подачи сжатого воздуха к источнику ирригационного раствора. Каждый комплект состоит из следующих компонентов:

1. Кассета и система трубок
2. Хирургическая простыня для монитора
3. Хирургическая простыня для столика Майо
4. Испытательная камера

Предусмотренное назначение

Комплект VERITAS для усовершенствованной инфузии/комплект VERITAS для усовершенствованного переливания жидкостей включает кассету и систему трубок и предназначен для выполнения процедуры промывания и аспирации во время операции по удалению катаракты на переднем сегменте глаза. Он используется с системой VERITAS™ Vision. Испытательная камера предназначена для проверки правильности подсоединения и исправности функции промывания/аспирации перед хирургической операцией.

Изображения изделия

Комплект VERITAS для усовершенствованного переливания жидкостей

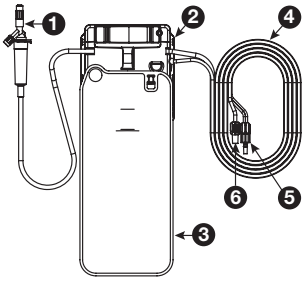

Комплект VERITAS для усовершенствованной инфузии

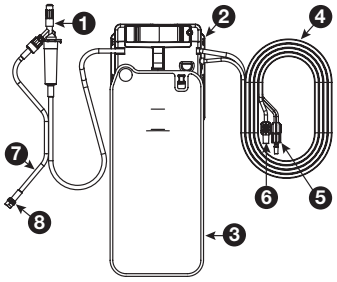

1. Игла для ирригации (к источнику ирригационного раствора)
2. Кассета
3. Дренажный пакет
4. Комплект трубок для промывания/аспирации (к манипулятору)
5. Винтовой соединитель типа Люэр для промывания
6. Соединитель для промывания

Только комплект VERITAS для усовершенствованной инфузии:

7. Линия вливания
8. Инфузионный разъем (к консоли)

Показания/противопоказания/предполагаемый пациент/предполагаемый пользователь

Вся соответствующая информация в отношении показаний, противопоказаний, предполагаемого пациента и предполагаемого пользователя предоставлена в руководстве оператора системы факоэмульсификации компании Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. (далее — «руководство оператора»). Противопоказания. Любые ранее существовавшие заболевания пациента, которые врач определяет как противопоказания к операции по удалению катаракты. К предполагаемым пациентам относятся взрослые пациенты с катарактой или взрослые пациенты, которым требуется офтальмологическая операция на переднем сегменте глаза (например, удаление хрусталика). Примечание. В проведенных клинических исследованиях не принимали участие беременные, кормящие женщины и дети. Система факоэмульсификации компании Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. предназначена для использования офтальмологом и вспомогательным персоналом, работающим под руководством хирурга.

Клиническая польза/нежелательные побочные эффекты/нежелательные явления

Вся соответствующая информация о клинической пользе, нежелательных побочных эффектах и нежелательных явлениях представлена в руководстве оператора. К клиническим преимуществам системы факоэмульсификации компании Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. относится следующее: быстрое восстановление зрения, раннее возобновление повседневной деятельности, минимальное глазное воспаление, минимальный послеоперационный астигматизм, снижение вероятности осложнений со стороны глаз. К осложнениям, которые могут быть связаны с системой факоэмульсификации Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc., относятся разрыв капсулы, ожог роговицы, инфекция/воспаление, а также отек роговицы.

Инструкция по применению

Следуйте данным инструкциям по правильной установке комплекта VERITAS. Комплект VERITAS для усовершенствованной инфузии имеет один дополнительный шаг, описанный ниже. Чтобы использовать комплект VERITAS для усовершенствованной инфузии, перед хирургической операцией в разделе настроек программы необходимо выбрать опцию усовершенствованной инфузии. Дополнительные инструкции см. в руководстве оператора. Перед использованием осмотрите лоток изделия на предмет нарушений целостности упаковки. Не используйте изделие, если нарушена целостность стерильной упаковки.

1. После стерильного извлечения всего содержимого из герметичного лотка изделия, закрытого крышкой, передайте КАССЕТУ и ИГЛУ ДЛЯ ИРРИГАЦИИ нестерильному операционному ассистенту (медсестре), оставляя КОМПЛЕКТ ТРУБОК ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ/АСПИРАЦИИ в стерильном поле.
2. Накройте монитор системы VERITAS Vision хирургической простыней для монитора.
3. Проденьте руки в хирургическую простыню для столика Майо согласно направляющим маркировкам на простыне и накройте кронштейн лотка системы VERITAS Vision.
4. Вставьте КАССЕТУ в гидравлический блок системы VERITAS Vision.
5. Продвиньте КАССЕТУ внутрь до активации фиксатора, удерживающего КАССЕТУ.
6. Подготовьте источник ирригационного раствора.
7. Снимите предохранитель с кончика ИГЛЫ ДЛЯ ИРРИГАЦИИ.
8. Удерживая флакон в вертикальном положении, установите ИГЛУ ДЛЯ ИРРИГАЦИИ прямо в центр резиновой пробки флакона без вращения.
9. Повесьте емкость с источником раствора на штатив для внутривенных вливаний, а затем сожмите и отпустите капельницу, пока она не наполнится до уровня в диапазоне от 1/2 до 3/4.
10. Только для комплекта VERITAS для усовершенствованной инфузии. На свободном конце ЛИНИИ ВЛИВАНИЯ имеется черный ИНФУЗИОННЫЙ РАЗЪЕМ. Вставьте ИНФУЗИОННЫЙ РАЗЪЕМ в боковую панель системы VERITAS Vision, а затем поверните его по часовой стрелке до щелчка, обозначающего подключение.
11. Для манипуляторов без порта для промывания с запорным механизмом отведите манжету на ВИНТОВОМ СОЕДИНИТЕЛЕ ТИПА ЛЮЭР ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ. Подсоедините соединители типа Люэр КОМПЛЕКТА ТРУБОК ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ/АСПИРАЦИИ к манипулятору. Для манипуляторов с портом для промывания с запорным механизмом поверните манжету на ВИНТОВОМ СОЕДИНИТЕЛЕ ТИПА ЛЮЭР ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ по часовой стрелке для фиксации соединителя на манипуляторе.
12. Подсоедините наконечник и рукав для промывания к манипулятору согласно инструкциям по сборке.
13. На экране ПРОМЫВКА/НАСТРОЙКА системы VERITAS Vision включите непрерывную ирригацию, при этом наконечник манипулятора должен быть обращен вниз внутри испытательной камеры, не закрытой герметично от рукава для ирригации.
14. Наполните испытательную камеру жидкостью, удалив весь воздух, и поместите испытательную камеру прямо по центру наконечника и рукава для промывания до герметизации.
15. Выключите режим непрерывного промывания и выполните процедуру промывания в соответствии с руководством оператора.

Общие сведения

Изделие не содержит фталатов.

Комплект стерилизован с использованием этиленоксида и предназначен для одноразового применения.

Храните изделие в сухом прохладном месте.

Данный документ действителен только по состоянию на день распечатки. Если дата распечатки инструкций неизвестна, распечатайте документ заново, чтобы гарантировать использование последней версии (доступной по ссылке www.e-ifu.com). Пользователь обязан удостовериться в применении новейшей версии инструкций.

Johnson & Johnson VISION

Меры предосторожности

- Не используйте изделие после даты истечения срока годности, указанного на этикетке упаковки изделия.
- Содержимое стерильно, если лоток изделия закрыт крышкой и не поврежден.
- При ухудшении эксплуатационных характеристик изделия во время использования следует прекратить его эксплуатацию и выполнить соответствующие проверки, детально описанные в руководстве оператора системы. Если результаты проверки окажутся неудовлетворительными, следует заменить комплект в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве оператора.
- При использовании комплекта VERITAS для усовершенствованной инфузии общая эффективная высота источника ирригационного раствора не должна быть меньше 30 см, если активирована опция усовершенствованной инфузии.
- После успешного завершения промывки/настройки можно использовать комплект VERITAS для усовершенствованной инфузии с ирригационным раствором во флаконе или пакете. Не все пакеты могут привести к успешному завершению промывки, что может стать причиной задержки процедуры.

Предупреждение

Только для одноразового использования. Запрещается стерилизовать, обрабатывать или использовать данное изделие повторно.

Медицинские изделия производства компании Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc., предназначенные для одноразового применения, комплектуются инструкциями по использованию и обращению для снижения воздействия условий, которые могут негативно повлиять на изделие, пациента или пользователя. Повторные стерилизация или обработка одноразовых медицинских изделий производства компании Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. могут привести к их механическому повреждению, ненадлежащему функционированию, а также нанесению вреда здоровью или травмированию пациента вследствие инфекции, воспаления и/или заболевания, обусловленных микробным загрязнением изделия, переносом инфекции и недостаточной стерильностью изделия.

Утилизация

С любым комплектом VERITAS, который контактировал с кровью, тканями и/или биологическими жидкостями/веществами, следует обращаться как с биологически опасными медицинскими отходами в соответствии с протоколом медицинского учреждения и применимыми местными требованиями.

Если комплект VERITAS поступил в неудовлетворительном состоянии, сразу же обратитесь в местное торговое представительство компании Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. На каждом комплекте VERITAS кассете присутствует обозначение в виде номера партии, который следует указывать в переписке и при обсуждении.

Номер телефона в США: 1-877-266-4543 (бесплатный звонок).

Уведомление о серьезных инцидентах

Для направления любых жалоб и/или сообщений о нежелательных явлениях, касающихся изделия, в компанию Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. обращайтесь к местному представителю компании. Если изделие было получено в неудовлетворительном состоянии, немедленно обратитесь в местное торговое представительство компании Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. На каждом компоненте указан номер партии, который следует сообщать в переписке и при обсуждении изделий. Номер телефона в США: 1-877-266-4543 (бесплатный звонок).

Уведомление о серьезных инцидентах (ЕС)

Информация для пациентов, пользователей и третьих лиц в Европейском союзе и в странах с идентичной системой нормативного регулирования: если во время использования данного изделия или в результате его использования произошло серьезное происшествие, сообщите об этом в компанию Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. и/или ее уполномоченному представителю, а также в государственный орган государства-участника, в котором находится пользователь и/или пациент.

Символы и их названия (расшифровка)

СИМВОЛ	НАЗВАНИЕ (РАСШИФРОВКА)
	Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде
	Не использовать повторно
	Стерилизовано этиленоксидом
	Номер по каталогу
	Код партии
	Срок годности
	Изготовитель
	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе/Европейском союзе
	Не стерилизовать повторно
	Импортер
	Уникальный идентификатор изделия
	Уполномоченный представитель в Швейцарии
	Дата изготовления
	Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению
	Европейское сообщество/Европейский союз
	Швейцария
	Упаковочная единица
	Внимание!
	Система с одинарным стерильным барьером
	Внимание! Согласно федеральному законодательству США, продажа настоящего изделия допускается только сертифицированным врачам или по их распоряжению.
	Открывать здесь
	Медицинское изделие
	Хрупкое, обращаться с осторожностью
	Беречь от влаги
	Верх

Внимание! Согласно федеральному законодательству США, продажа данного изделия допускается только врачам или по их распоряжению.

Произведено в Мексике

Данный документ действителен только по состоянию на день распечатки. Если дата распечатки инструкций неизвестна, распечатайте документ заново, чтобы гарантировать использование последней версии (доступной по ссылке www.e-ifu.com). Пользователь обязан удостовериться в применении новейшей версии инструкций.

Johnson & Johnson VISION

℞ only

Инструкции/описание:

Комплект VERITAS Advanced Infusion или Комплект VERITAS Advanced Fluidics е комплект с ДВОЙНА ПОМПА, който предоставя всички тръбички и аксесоари, необходими за извършване на процедури за иригация и аспирация или на процедура за факоемулсификация. Комплект VERITAS Advanced Infusion съдържа допълнителна тръбичка, която осигурява въздух под налягане към източника на иригационен разтвор. Всяка опаковка се състои от следните елементи:

1. Касета и система от тръбички
2. Покривало от хирургически чаршаф за монитор
3. Калъф от хирургически чаршаф за стенд Майо
4. Тестова камера

Предназначение:

Комплектът VERITAS Advanced Infusion или Комплектът VERITAS Advanced Fluidics съдържа касета и система от тръбички и е предназначен за извършване на иригация и аспирация по време на хирургична операция на катаракта на преден сегмент. Използва се със системата VERITAS™ Vision. Тестовата камера е предназначена за проверка на правилното свързване и на функционалността на функцията за иригация/аспирация преди извършване на хирургичната процедура.

Илюстрации на продукта:

Комплект VERITAS Advanced Fluidics

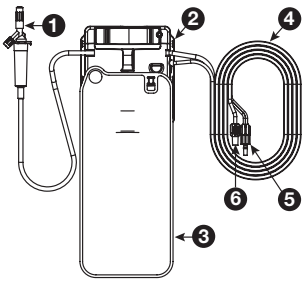

Комплект VERITAS Advanced Infusion



1. Игла за пробиване на банката (към иригационен източник)
2. Касета
3. Дренажна торбичка
4. Комплект от тръбички за иригация и аспириране (към наконечника)
5. Монтаж на фитинг Luer-Lock
6. Аспирационен фитинг

Само за комплект VERITAS Advanced Infusion:

7. Инфузионна линия
8. Конектор за инфузия (към конзолата)

Показания/противопоказания/предвидени пациенти/предвидени потребители:

Цялата съответна информация за показанията/противопоказанията/предвидените пациенти/предвидените потребители е описана в ръководството за оператора на факоемулсификационната система на Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. („Ръководство за оператора“). Противопоказания: Всяко съществуващо състояние на пациента, което доставчикът на здравни грижи определя като противопоказание за операция на катаракта. Предвидените пациенти са възрастни пациенти с катаракта или възрастни пациенти, подложени на хирургична процедура на преден очен сегмент (напр. отстраняване на кристалната леща). Забележка: В проведеното(ите) клинично(и) изпитване(ия) не са били включени бременни, кърмещи или деца. Факоемулсификационната система на Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. е предназначена за употреба от офталмолог и помощен персонал, опериращ под ръководството на хирурга.

Клинични ползи/нежелани странични ефекти/нежелани реакции:

Цялата необходима информация за клиничните ползи/нежеланите странични ефекти/нежеланите реакции е описана в ръководството за оператора. Клиничните ползи на факоемулсификационната система на Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. са следните: Бърза рехабилитация на зрението, ранно възобновяване на ежедневните дейности, минимално очно възпаление, минимален постоперативен астигматизъм, намален потенциал за усложнения за очите. Усложненията, които могат да бъдат свързани с факоемулсификационната система на Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc., включват нарушена капсула, изгаряне на роговицата, инфекция/възпаление и оток на роговицата.

Инструкции за употреба:

Вижте следните инструкции относно правилното монтиране на комплекта VERITAS. Монтажът на комплект VERITAS Advanced Infusion включва една допълнителна стъпка, която е отбелязана по-долу. За да използвате комплект VERITAS Advanced Infusion, трябва да изберете функция Усъвършенствана инфузия в Настройки на програмата преди операцията. За допълнителни инструкции направете справка с ръководството за оператора. Преди употреба проверете визуално опаковъчната поставка на продукта за нарушаване на целостта на опаковката. Не използвайте продукта, ако целостта на опаковката е нарушена.

1. След изваждане в стерилна среда на цялото съдържание от опаковъчната поставка на продукта, запечатана с капак, предайте КАСЕТАТА и ИГЛАТА ЗА ПРОБИВАНЕ НА БАНКАТА на операционна сестра (медицинска сестра), като оставите КОМПЛЕКТА ОТ ТРЪБИЧКИ ЗА ИРИГАЦИЯ И АСПИРИРАНЕ в стерилното поле.
2. Поставете покривало от хирургически чаршаф за монитор върху монитора на системата VERITAS Vision.
3. Поставете ръцете в калъф от хирургически чаршаф за стенд Майо в съответствие с указателните маркировки върху хирургическия чаршаф и покрийте рамото на поставката на VERITAS Vision.
4. Вкарайте КАСЕТАТА в панела на флуидната система на системата VERITAS Vision.
5. Натиснете КАСЕТАТА, докато системата активира заключващия механизъм, за да задържи КАСЕТАТА.
6. Подгответе източника на иригационен разтвор.
7. Отстранете предпазителя от върха на ИГЛАТА ЗА ПРОБИВАНЕ НА БАНКАТА.
8. С поставен в изправено положение източник въведете ИГЛАТА ЗА ПРОБИВАНЕ НА БАНКАТА права в центъра на гумената запушалка без да я завъртате.
9. Окачете източника на статив за интравенозна инфузия и след това стиснете и отпуснете няколко пъти капковата камера, докато се напълни от 1/2 до 3/4.
10. Само за комплект VERITAS Advanced Infusion: ИНФУЗИОННАТА ЛИНИЯ има черен КОНЕКТОР ЗА ИНФУЗИЯ в свободния си край. Поставете КОНЕКТОРА ЗА ИНФУЗИЯ в страничния панел на системата VERITAS Vision и след това го завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато щракне, когато е напълно свързан.
11. При наконечници без заключващ се иригационен порт приберете пръстена на ИРИГАЦИОННИЯ ФИТИНГ LUER-LOCK. Свържете луеровите фитинги на КОМПЛЕКТА ОТ ТРЪБИЧКИ ЗА ИРИГАЦИЯ И АСПИРИРАНЕ към наконечника. При наконечници, оборудвани със заключващ се иригационен порт, завъртете пръстена на ИРИГАЦИОННИЯ ФИТИНГ LUER-LOCK по посока на часовниковата стрелка, за да заключите фитинга към наконечника.
12. Прикрепете върха и иригационния маншона към наконечника съгласно инструкциите за сглобяване.
13. От екрана ЗАРЕЖДАНЕ/РЕГУЛИРАНЕ на системата VERITAS Vision активирайте функцията Непрекъсната иригация с върха на наконечника обърнат надолу в тестова камера, която не е уплътнена към иригационния маншон.
14. Напълнете тестовата камера с течност, като отстраните целия въздух, вкарайте тестовата камера права и центрирате върху върха и иригационния маншон така, че той да се уплътни.
15. Деактивирайте функцията Непрекъсната иригация и извършете процедурата за зареждане съгласно ръководството за оператора.

Обща информация:

Изделието не съдържа фталати.

Комплектът е стерилизиран с етиленов оксид и е предназначен за еднократна употреба.

Съхранявайте продукта на хладно и сухо място.

Предпазни мерки:

- Не използвайте продукта след изтичане на срока му на годност, отбелязан върху етикетите на опаковката на продукта.
- Съдържанието е стерилно, когато опаковъчната поставка на продукта е запечатана с капак и е неповредена.
- Ако работата на продукта се влоши по време на употреба, прекратете използването му и извършете тестовете, посочени в ръководството за оператора на системата. Ако резултатите не са задоволителни, сменете комплекта съгласно инструкциите, посочени в ръководството за оператора.

Този документ е валиден само към отпечатаната дата. Ако не сте сигурни каква е тази дата, моля, отпечатайте отново, за да сте сигурни, че използвате последното издание на инструкциите за употреба (налично на www.e-ifu.com). Задължението за използване на най-актуалните инструкции за употреба е на потребителя.

Johnson & Johnson VISION

Z311979E B

- Когато използвате комплект VERITAS Advanced Infusion, ефективната обща височина на иригационния източник не може да бъде по-ниска от 30 cm, когато функцията Усъвършенствана инфузия е активирана.
- Комплект VERITAS Advanced Infusion може да се използва с иригационен разтвор в бутилка или торбичка, след като функцията Зареждане/Регулиране е успешно изпълнена. Не всички торбички могат да са подходящи за успешно изпълнение на функцията Зареждане, което може да доведе до забавяне на лечението.

Предупреждение:

Само за еднократна употреба. Не стерилизирайте, не обработвайте и не използвайте повторно това изделие.

На медицинските изделия за еднократна употреба на Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. са поставени етикети с инструкции за употреба и работа с цел намаляване до минимум на условията, които могат да изложат на риск продукта, пациента или потребителя. Повторната стерилизация/повторната обработка на медицински изделия за еднократна употреба на Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. може да доведе до физическа повреда, до невъзможност на медицинското изделие да функционира според предназначението си и до заболяване или нараняване на пациента поради инфекция, възпаление и/или заболяване, дължащо се на замърсяване на продукта, предаване на инфекции и липса на стерилност на продукта.

Изхвърляне:

Всеки комплект VERITAS, замърсен с кръв, тъкан и/или телесни течности/материя, трябва да се третира като биологично опасен медицински отпадък в съответствие с протокола на здравното заведение и приложимите местни изисквания.

Ако комплект VERITAS е получен в незадоволително състояние, незабавно се свържете с местното търговско представителство на Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Всеки комплект VERITAS се идентифицира чрез партиден номер, указан върху етикетите на опаковката на продукта, който трябва да бъде включен в кореспонденцията или съобщен при разговорите.

В САЩ позвънете на безплатния телефонен номер 1-877-266-4543.

Съобщаване за сериозни инциденти:

Свържете се с местния представител на Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc, за да съобщите за всякакви оплаквания от продукта и/или за настъпили нежелани реакции. Ако продуктът е получен в незадоволително състояние, незабавно се свържете с местния търговски офис на Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Всеки компонент се идентифицира чрез партиден номер, който трябва да бъде включен в кореспонденцията или съобщен при разговорите. В САЩ позвънете на безплатния телефонен номер 1-877-266-4543.

Съобщаване за сериозни инциденти (ЕС):

За пациент/потребител/трета страна в Европейския съюз и в държави с идентичен регулаторен режим: ако по време на използването на това изделие или в резултат на употребата му е възникнал сериозен инцидент, моля, съобщете инцидента на Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. и/или на негов упълномощен представител и на компетентния орган на държавата членка, в която потребителят и/или пациентът е установен.

Символ/заглавие (обяснение):

СИМВОЛ	ЗАГЛАВИЕ (ОБЯСНЕНИЕ)
	Вижте инструкциите за употреба или разгледайте електронните инструкции за употреба
	Да не се използва повторно
STERILE EO	Стерилизирано с етиленов оксид
REF	Каталожен номер
LOT	Код на партидата
	Срок на годност
	Производител
EC REP	Упълномощен представител в Европейската общност/ Европейския съюз
	Да не се стерилизира повторно
	Вносител
UDI	Уникален идентификатор на изделието
CH REP	Упълномощен представител в Швейцария
	Дата на производство
	Не използвайте, ако опаковката е повредена, и вижте инструкциите за употреба
EC	Европейска общност/Европейски съюз
CH	Швейцария
	Опаковка
	Внимание
	Единична стерилна бариерна система
Rx only	Внимание: Федералното законодателство предвижда продажбата на това изделие да се извършва само от или по поръчка на лицензиран медицински специалист.
	Отворете тук
MD	Медицинско изделие
	Чупливо, боравете внимателно
	Пазете сухо
	С тази страна нагоре

Внимание: Федералното законодателство (на САЩ) предвижда продажбата на това изделие да се извършва само от или по поръчка на лекар.

Продукт от Мексико

Rx only

Uvod/opis:
Napredni infuzijski komplet VERITAS ali napredni fluidični komplet VERITAS sta kompleta z DVOJNO ČRPALKO, ki zagotavljata vse cevje in dodatke, potrebne za izvedbo postopka izpiranja in aspiracije ali postopka fakoemulzifikacije. Napredni infuzijski komplet VERITAS vsebuje dodatno cevje za dovajanje stisnjenega zraka do vira irigacijske raztopine. Vsak komplet je sestavljen iz naslednjih delov:

1. Sklop kasete in cevja
2. Pregrinjalo za monitor
3. Pregrinjalo za stojalo Mayo
4. Testna komora

Namen uporabe:
Napredni infuzijski komplet VERITAS ali napredni fluidični komplet VERITAS vsebujeta kaseto in cevje ter sta namenjena izvajanju izpiranja in aspiracije med operacijo katarakte v anteriornemu segmentu. Uporabljata se s sistemom VERITAS™ Vision. Testna komora je namenjena preverjanju pravilne povezanosti in delovanja funkcije izpiranja/aspiracije pred kirurškim posegom.

Slika izdelka:

Napredni fluidični komplet VERITAS

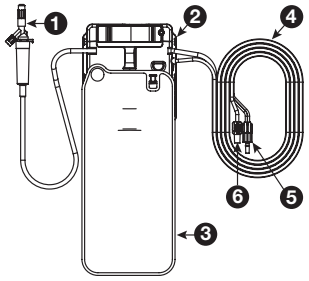

Napredni infuzijski komplet VERITAS

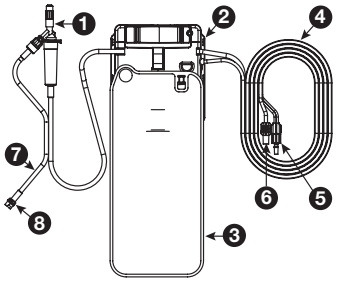

1. Konica za izpiranje (na vir izpiranja)
2. Kaseta
3. Drenažna vrečka
4. Cevje za izpiranje in aspiracijo (na držalo)
5. Irigacijski zaklepni nastavek po Luerju
6. Nastavek za aspiracijo

Samo napredni infuzijski komplet VERITAS:
7. Infuzijska cevka
8. Infusijski priključek (na konzolo)

Indikacije/kontraindikacije/predvidena populacija bolnikov/predvideni uporabnik:
Vse relevantne informacije za indikacije/kontraindikacije/predvideno populacijo bolnikov/predvidenega uporabnika so opisane v uporabniškem priročniku fakoemulzifikacijskega sistema družbe Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. („Uporabniški priročnik"). Kontraindikacije: Vsa predhodno obstoječa stanja bolnika, za katera zdravstveni strokovnjak ugotovi, da so kontraindikacija za kirurški poseg za odstranjevanje katarakte. Predvidena populacija bolnikov vključuje odrasle bolnike s kataraktami in odrasle bolnike, pri katerih se izvaja oftalmološki kirurški poseg v anteriornemu segmentu (npr. odstranitev očesne leče). Opomba: Nosečnice, doječe matere ali otroci niso bili vključeni v izvedene klinične študije. Fakoemulzifikacijski sistem Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. je namenjen oftalmologu in kirurškemu osebju za uporabo pri izvajanju kirurškega posega pod nadzorom kirurga.

Klinične koristi/neželeni stranski učinki/neželeni učinki:
Vse pomembne informacije o kliničnih koristih/neželenih učinkih/neželenih dogodkih so navedene v uporabniškem priročniku. Klinične koristi fakoemulzifikacijskega sistema Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. vključujejo naslednje: hitro rehabilitacijo očesa, zgodnje ponovno izvajanje dnevnih aktivnosti, minimalno vnetje oči, minimalni pooperativni astigmatizem, zmanjšani potencial za očesne komplikacije. Zapleti, ki so lahko povezani s fakoemulzifikacijskim sistemom Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc., vključujejo zlom kapsule, opeklino roženice, okužbo/vnetje in edem roženice.

Navodila za uporabo:
V nadaljevanju so navodila za pravilno namestitev kompleta VERITAS. Napredni infuzijski komplet VERITAS ima dodatni korak, kot je zapisano v nadaljevanju. Za uporabo naprednega infuzijskega kompleta VERITAS, morate pred operacijo v programskih nastavitvah izbrati možnost za napredno infundiranje. Za dodatna navodila glejte uporabniški priročnik. Pred uporabo vizualno preglejte pladenj izdelka, da preverite, če je ovojnina nepoškodovana. Če je ovojnina poškodovana, izdelka ne uporabite.

1. Ko sterilno odstranite vso vsebino s pladnja za izdelke, zaprtega s pokrovom, posredujte KASETO in KONICO ZA IZPIRANJE instrumentarki (medicinski sestri), pri tem pa ohranite KOMPLET CEVJA ZA IZPIRANJE IN ASPIRACIJO v sterilnem polju.
2. Na sistemu VERITAS Vision namestite pokrivalo za monitor čez monitor.
3. Namestite roke v pokrivalo za stojalo Mayo v skladu z usmerjevalnimi oznakami na pokrivalu in pokrijte roko pladnja sistema VERITAS Vision.
4. Vstavite KASETO v ploščo za fluidiko sistema VERITAS Vision.
5. Potisnite KASETO, dokler sistem ne aktivira zaklepnega mehanizma, ki KASETO zadrži.
6. Pripravite vir irigacijske raztopine.
7. Odstranite ščitnik s KONICE ZA IZPIRANJE.
8. Vir držite pokonci in vstavite KONICO ZA IZPIRANJE v sredino gumijastega zamaška za vir brez obračanja.
9. Vir obesite na držalo za infundiranje, nato pa stisnite in sprostite kapalno posodo, dokler ni polna od 1/2 do 3/4.
10. Samo za napredni infuzijski komplet VERITAS: INFUZIJSKA CEVKA ima črn INFUZIJSKI PRIKLJUČEK na prostem koncu. Vstavite INFUZIJSKI PRIKLJUČEK v stransko ploščo sistema VERITAS Vision in ga zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler ne zaskoči, ko je popolnoma priključen.
11. Za držala brez zaklepne odprtine za irigacijo, uvlecite manšeto na IRIGACIJSKEM ZAKLEPNEM NASTAVKU PO LUERJU. Nastavke po Luerju CEVJA ZA IZPIRANJE IN ASPIRACIJO priključite na držalo. Pri držalih z zaklepno odprtino za irigacijo obrnite manšeto na IRIGACIJSKEM ZAKLEPNEM NASTAVKU PO LUERJU v smeri urinega kazalca, da zaklenete nastavek na držalo.
12. Konico in izpiralni tulec pritrdite na držalo skladno z navodili za sestavljanje.
13. Na zaslonu za POLNJENJE IN UMERJANJE v sistemu VERITAS Vision aktivirajte neprekinjeno izpiranje s konico držala, obrnjeno navzdol, v testni komori, ki ni zatesnjena ob izpiralni tulec.
14. Testno komoro napolnite s tekočino, iz katere izločite ves zrak, ter jo naravnost in sredinsko vstavite čez konico in izpiralni tulec, dokler ni zaprta.
15. Deaktivirajte neprekinjeno izpiranje in izvedite polnjenje v skladu z uporabniškim priročnikom.

Splošno:
Pripomoček ne vsebuje ftalatov.

Komplet je steriliziran z etilenoksidom in je namenjen za enkratno uporabo.

Izdelek shranjujte na hladnem in suhem mestu.

Previdnostni ukrepi:
- Izdelka ne uporabljajte po izteku roka uporabnosti, ki je označen na embalaži izdelka.
- Vsebina je sterilna, če je pladenj za izdelke zaprt s pokrovom in nepoškodovan.
- Če izdelek med uporabo preneha delovati pravilno, prekinite uporabo in opravite ustrezne teste, kot je opisano v uporabniškem priročniku sistema. Če rezultati niso zadovoljivi, zamenjajte komplet skladno z navodili v uporabniškem priročniku.

Ta dokument velja le na datum tiskanja. Če niste prepričani glede datuma tiskanja, dokument znova natisnite in se tako prepričajte, da uporabljate najnovejšo revidirano različico navodil za uporabo (IFU) (na voljo na naslovu www.e-ifu.com). Uporabnik je odgovoren za uporabo najnovejše različice navodil za uporabo (IFU).

Johnson & Johnson VISION

Z311979E B

- Pri uporabi naprednega infuzijskega kompleta VERITAS učinkovita skupna višina vira izpiranja ne sme biti nižja od 30 cm, ko je aktivirana funkcija za napredno infundiranje.
- NApredni infuzijski komplet VERITAS se lahko uporablja z irigacijsko raztopino v steklenici ali vrečki po uspešno opravljenem polnjenju in umerjanju. Vse vrečke morda ne bodo uspešno zaključile postopka polnjenja, kar lahko povzroči zamudo pri zdravljenju.

Opozorilo:

Samo za enkratno uporabo. Pripomočka ne ponovno sterilizirajte, obdelujte ali ponovno uporabljajte.

Medicinski pripomočki Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. za enkratno uporabo so opremljeni z navodili za uporabo in ravnanje, da se čim bolj zmanjša izpostavljenost pogojem, ki lahko ogrozijo izdelek, bolnika ali uporabnika. Ponovna sterilizacija/obdelava za ponovno uporabo medicinskih pripomočkov družbe Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. za enkratno uporabo lahko povzroči fizične poškodbe medicinskih pripomočkov, njihovo odpoved in bolezen ali telesno poškodbo bolnika zaradi okužbe, vnetja in/ali bolezni, do česar pride zaradi kontaminacije izdelka, prenosa okužbe ali nesterilnosti izdelka.

Odstranjevanje:

S kompletom VERITAS, ki je bil kontaminiran s krvjo, tkivom in/ali telesnimi tekočinami/snovmi, je treba ravnati kot z biološko nevarnim medicinskim odpadkom skladno s protokolom zdravstvene ustanove in veljavnimi lokalnimi zahtevami.

Če ste komplet VERITAS prejeli v neustreznem stanju, se nemudoma obrnite na lokalnega predstavnika družbe Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Vsak komplet VERITAS ima svojo serijsko številko na nalepkah na ovojnini izdelka, ki jo navedite v korespondenci in pogovorih.

Telefonska številka v ZDA: Brezplačna telefonska številka 1-877-266-4543.

Poročanje o resnih zapletih:

Obrnite se na lokalnega predstavnika, da družbi Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. sporočite vse pritožbe in/ali neželene dogodke v zvezi z izdelki. Če izdelek prejmete v nesprejemljivem stanju, se nemudoma obrnite na lokalnega predstavnika družbe Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Vsak sestavni del ima svojo serijsko številko, ki jo navedite v korespondenci in pogovorih. Telefonska številka v ZDA: Brezplačna telefonska številka 1-877-266-4543.

Poročanje o resnih zapletih (EU):

Za bolnika/uporabnika/tretjo osebo v Evropski uniji in v državah z enakim regulativnim režimom; če se med uporabo tega pripomočka ali kot posledica njegove uporabe zgodi resen zaplet, o tem obvestite družbo Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. in/ali njenega pooblaščenega zastopnika ter ustrezni nacionalni organ države članice, kjer se nahaja uporabnik in/ali bolnik.

Simbol/naziv (pojasnilo):

SIMBOL	NAZIV (POJASNILO)
	Preberite navodila za uporabo ali elektronska navodila za uporabo
	Ne uporabite ponovno
	Sterilizirano z etilenoksidom
	Kataloška številka
	Koda serije
	Uporabno do
	Proizvajalec
	Pooblaščeni predstavnik v Evropski skupnosti/Evropski uniji

SIMBOL	NAZIV (POJASNILO)
	Ne sterilizirajte ponovno
	Uvoznik
	Enotna identifikacija pripomočka
	Pooblaščeni predstavnik v Švici
	Datum izdelave
	Ne uporabite, če je ovojnina poškodovana, in glejte navodila za uporabo
	Evropska skupnost/Evropska unija
	Švica
	Enota pakiranja
	Pozor
	Enojna sterilna pregrada
	Pozor: Zvezna zakonodaja dovoljuje prodajo tega pripomočka samo zdravnikom oziroma po njihovem naročilu.
	Odprite tukaj
	Medicinski pripomoček
	Lomljivo, ravnajte previdno
	Shranjujte na suhem mestu
	Zgoraj

Pozor: Zvezna zakonodaja ZDA dovoljuje prodajo izdelka le zdravnikom oziroma po njihovem naročilu.

Izdelek iz Mehike

Ta dokument velja le na datum tiskanja. Če niste prepričani glede datuma tiskanja, dokument znova natisnite in se tako prepričajte, da uporabljate najnovejšo revidirano različico navodil za uporabo (IFU) (na voljo na naslovu www.e-ifu.com). Uporabnik je odgovoren za uporabo najnovejše različice navodil za uporabo (IFU).

Johnson & Johnson VISION

Z311979E B

℞ only

Úvod/popis:
Rozšířená infuzní sada VERITAS nebo rozšířená kapalinová sada VERITAS jsou balení DUÁLNÍ PUMPY, která obsahují všechny hadičky a příslušenství potřebné k provádění irigace a aspirace nebo fakoemulzifikace. Rozšířená infuzní sada VERITAS obsahuje hadičku navíc, která přivádí stlačený vzduch ke zdroji irigačního roztoku. Každá sada se skládá z následujících položek:

1. Sestava kazety a hadiček
2. Rouškový kryt monitoru
3. Rouškový kryt stojanu Mayo
4. Testovací komůrka

Účel použití:
Rozšířená infuzní sada VERITAS nebo rozšířená kapalinová sada VERITAS obsahuje sestavu kazety a hadiček a je určena k provádění irigace a aspirace během operace katarakty na předním segmentu oka. Používá se se systémem VERITAS™ Vision. Testovací komůrka slouží k ověření správné konektivity a funkčnosti irigační/aspirační funkce před operací.

Nákresy výrobku:

Rozšířená kapalinová sada VERITAS

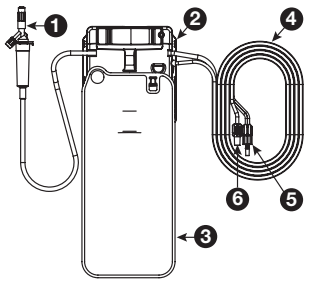

Rozšířená infuzní sada VERITAS



1. Irigační hrot (na irigační zdroj)
2. Kazeta
3. Drenážní vak
4. Souprava irigačních a aspiračních hadiček (na násadec)
5. Irigační spojka typu Luer
6. Aspirační spojka

Pouze rozšířená infuzní sada VERITAS:
7. Infuzní hadička
8. Infuzní konektor (ke konzoli)

Indikace / Kontraindikace / Určený pacient / Určený uživatel:
Veškeré příslušné informace týkající se indikací / kontraindikací / určeného pacienta / určeného uživatele jsou uvedeny v návodu k obsluze fakoemulzifikačního systému Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. („návod k obsluze“). Kontraindikace: jakýkoli již existující zdravotní stav pacienta, který poskytovatel zdravotní péče stanoví jako kontraindikaci operace katarakty. Mezi určené pacienty patří dospělí pacienti postižení kataraktou nebo dospělí pacienti podstupující oftalmologickou operaci na předním segmentu oka (např. odstranění oční čočky). Poznámka: Těhotné a kojící ženy či děti nebyly do provedené klinické studie (studií) zahrnuty. Fakoemulzifikační systém společnosti Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. je určen k použití očními lékaři a pomocným personálem, který pracuje podle pokynů chirurga.

Klinické přínosy / Nežádoucí vedlejší účinky / Nežádoucí účinky:
Veškeré informace týkající klinických přínosů / nežádoucích vedlejších účinků / nežádoucích účinků jsou uvedeny v návodu k obsluze. Mezi klinické přínosy fakoemulzifikačního systému společnosti Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. patří: rychlá rehabilitace zraku, brzké obnovení denních aktivit, minimální výskyt očních zánětů, minimální výskyt pooperačního astigmatismu, snížení možného výskytu očních komplikací. Mezi komplikace, které mohou být spojovány s fakoemulzifikačním systémem společnosti Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc., patří poškození pouzdra čočky, popálení rohovky, infekce/zánět a edém rohovky.

Návod k použití:
Seznamte se s následujícími pokyny ke správné instalaci sady VERITAS. Rozšířená infuzní sada VERITAS zahrnuje jeden krok navíc, který je popsán níže. Předtím než budete rozšířenou infuzní sadu VERITAS používat, v nabídce Nastavení programu musíte před operací zvolit možnost Rozšířená infuze. Další pokyny naleznete v návodu k obsluze. Před použitím vizuálně zkontrolujte, zda není obalová vanička výrobku poškozena. Výrobek nepoužívejte, pokud je obal porušen.

1. Po sterilním vyjmutí celého obsahu výrobku z vaničky se zataveným víčkem předejte KAZETU a IRIGAČNÍ HROT pomocné sálové sestře a přitom udržujte SOUPRAVU IRIGAČNÍCH A ASPIRAČNÍCH HADIČEK ve sterilním poli.
2. Rouškový kryt monitoru umístěte na monitor systému VERITAS Vision.
3. Vložte ruce do rouškového krytu stojanu Mayo podle značení na roušce a zakryjte rameno stolku systému VERITAS Vision.
4. Vložte KAZETU do kapalinového panelu systému VERITAS Vision.
5. Tlačte na KAZETU, dokud systém neaktivuje mechanizmus západky, který KAZETU drží.
6. Připravte zdroj irigačního roztoku.
7. Odstraňte chránič ze špičky IRIGAČNÍHO HROTU.
8. Zdroj držte svisle a zaveďte IRIGAČNÍ HROT rovně bez kroucení do středu pryžové zátky zdroje.
9. Zdroj zavěste na infuzní stojan a potom opakovaným stiskem naplňte odkapávací komůrku do poloviny až tří čtvrtin.
10. Platí pouze pro rozšířenou infuzní sadu VERITAS: INFUZNÍ HADIČKA má na volném konci černý INFUZNÍ KONEKTOR. Zaveďte INFUZNÍ KONEKTOR do bočního panelu systému VERITAS Vision a kroutivým pohybem ve směru hodinových ručiček jej otáčejte, dokud po úplném připojení nezacvakne.
11. U násadců, které nemají zajišťovací irigační přípojku, zatáhněte objímku na IRIGAČNÍ SPOJCE TYPU LUER. Připojte spojky typu Luer ze SOUPRAVY IRIGAČNÍCH/ASPIRAČNÍCH HADIČEK k násadci. U násadců, které zajišťovací irigační přípojku mají, otočte objímkou na IRIGAČNÍ SPOJCE TYPU LUER ve směru hodinových ručiček, čímž připevníte spojku k násadci.
12. Připojte hrot a irigační koncovku k násadci podle pokynů k sestavení.
13. Na obrazovce PLNĚNÍ/LADĚNÍ systému VERITAS Vision aktivujte funkci Kontinuální irigace. Hrot násadce přitom musí směřovat dolů do testovací komůrky, která není utěsněná vůči irigační koncovce.
14. Naplňte testovací komůrku tekutinou, dokud neodstraníte veškerý vzduch, a nasaďte testovací komůrku rovně a vystředěně na hrot a irigační koncovku až do utěsnění.
15. Deaktivujte kontinuální irigaci a proveďte plnicí sekvenci podle návodu k obsluze.

Obecné informace:
Prostředek neobsahuje ftaláty.

Sada je sterilizována etylenoxidem a je určena k jednorázovému použití.

Výrobek skladujte na chladném a suchém místě.

Bezpečnostní opatření:

- Nepoužívejte výrobek po datu exspirace vyznačeném na štítku obalu.
- Obsah je sterilní, pokud je vanička výrobku zatavena víčkem a je nepoškozená.
- Pokud při použití dojde k narušení funkčních vlastností výrobku, přerušte probíhající proceduru a proveďte příslušné zkoušky podrobně popsané v návodu k obsluze systému. Pokud není výsledek uspokojivý, vyměňte sadu podle pokynů v návodu k obsluze.
- Při používání rozšířené infuzní sady VERITAS nesmí být zdroj irigace v celkové účinné výšce při aktivní možnosti Rozšířená infuze níže než 30 cm.
- Rozšířená infuzní sada VERITAS smí být použita s irigačním roztokem v lahvi nebo ve vaku až poté, co je úspěšně dokončen proces Plnění/Ladění. Proces Plnění nemusí být úspěšný se všemi vaky, což může vést ke zpoždění léčby.

Tento dokument je platný pouze k datu tisku. Pokud si nejste datem tisku jisti, vytiskněte si jej ještě jednou, abyste skutečně měli k dispozici poslední revizi tohoto návodu k použití (je dostupný na stránce www.e-ifu.com). Za používání nejaktuálnějšího návodu k použití zodpovídá uživatel.

Johnson & Johnson VISION

Varování:

Pouze k jednomu použití. Tento prostředek opakovaně nesterilujte, neregenerujte ani opakovaně nepoužívejte.

Jednorázové zdravotnické prostředky společnosti Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. jsou opatřeny návodem k použití a pokyny k zacházení s nimi, aby se minimalizovalo vystavení podmínkám, které mohou ohrozit výrobek, pacienta nebo uživatele. Opakovaná sterilizace / opětovné zpracování jednorázových zdravotnických prostředků společnosti Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. může mít za následek fyzické poškození zdravotnického prostředku, selhání zdravotnického prostředku v jeho zamýšleném použití a onemocnění nebo zranění pacienta v důsledku infekce, zánětu nebo onemocnění v důsledku kontaminace výrobku, přenosu infekce a nedostatečné sterility výrobku.

Likvidace:

S každou sadou VERITAS, která byla kontaminována krví, tkáněmi a/nebo tělesnými tekutinami/látkami, je nutno nakládat jako s biologicky nebezpečným zdravotnickým odpadem v souladu s protokolem zdravotnického zařízení a příslušnými místními předpisy.

Pokud bude sada VERITAS dodána v neuspokojivém stavu, ihned se obraťte na místní obchodní zastoupení společnosti Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Každá sada VERITAS je na štítcích na obalu výrobku označena číslem šarže, které je nutno uvádět v případné korespondenci a při veškerém jednání.

Telefonní číslo v USA: bezplatná linka 1-877-266-4543.

Hlášení závažných příhod:

Všechny reklamace nebo nežádoucí příhody spojené s výrobkem je nutné hlásit místnímu zástupci společnosti Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Pokud bude výrobek dodán v neuspokojivém stavu, kontaktujte svého místního zástupce společnosti Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Každá součást je označena číslem šarže, které je nutno uvádět v případné korespondenci a při veškerém jednání. Telefonní číslo v USA: bezplatná linka 1-877-266-4543.

Hlášení závažných příhod (EU):

Pro pacienta / uživatele / třetí stranu v Evropské unii a v zemích se stejným regulačním režimem: pokud během používání tohoto prostředku nebo v důsledku jeho používání došlo k závažné příhodě, nahlaste ji společnosti Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. a/nebo jejímu zplnomocněnému zástupci a příslušnému úřadu členského státu, ve kterém má uživatel nebo pacient sídlo/bydliště.

Symbol/název (vysvětlení):

SYMBOL	NÁZEV (VYSVĚTLENÍ)
	Přečtěte si návod k použití nebo si přečtěte elektronický návod k použití
	Nepoužívejte opakovaně
STERILE EO	Sterilizováno etylenoxidem
REF	Katalogové číslo
LOT	Kód šarže
	Datum spotřeby
	Výrobce
EC REP	Oprávněný zástupce v Evropském společenství / Evropské unii
	Nesterilizujte opakovaně
	Dovozce

SYMBOL	NÁZEV (VYSVĚTLENÍ)
UDI	Jedinečný identifikátor prostředku
CH REP	Oprávněný zástupce ve Švýcarsku
	Datum výroby
	Nepoužívejte, pokud je obal poškozen, a postupujte podle návodu k použití
EC	Evropské společenství / Evropská unie
CH	Švýcarsko
	Obalová jednotka
	Upozornění
	Systém s jednou sterilní bariérou
Rx only	Upozornění: Federální zákon (v USA) omezuje prodej tohoto prostředku na licencovaného zdravotnického pracovníka nebo na jeho předpis.
	Otevřít zde
MD	Zdravotnický prostředek
	Křehké, zacházejte opatrně
	Udržujte v suchu
	Takto nahoru

Upozornění: Federální (USA) zákony omezují prodej tohoto prostředku pouze na lékaře nebo na lékařský předpis.

Vyrobeno v Mexiku

℞ only

Bemutatás/leírás:
A VERITAS Fejlett infúziós készlet, illetve a VERITAS Fejlett folyadékkezelő készlet egy KETTŐSPUMPA-csomag az öblítési és aspirációs eljáráshoz, illetve a phacoemulzifikációs eljáráshoz szükséges minden csövet és tartozékot tartalmazza. A VERITAS Fejlett infúziós készlet egy további csővezetéket is tartalmaz, amely nagynyomású levegőt juttat az irrigációsoldat-forráshoz. Minden készlet a következő tételeket tartalmazza:

1. Kazetta és csővezeték-szerelék
2. Monitorizoláló kendő
3. Mayo állványizoláló kendő
4. Próbatartály

Rendeltetés:
A VERITAS Fejlett infúziós készlet, illetve a VERITAS Fejlett folyadékkezelő készlet tartalmazza a kazettát és a csővezeték-szereléket, célja pedig az öblítés és az aspiráció elvégzése az elülső szegmentumban végzett szürkehályog-műtét közben. A VERITAS™ Vision rendszerrel együttesen használatos. A próbatartály arra szolgál, hogy segítségével a sebészeti eljárás előtt ellenőrizzék a megfelelő csatlakozást és az öblítési/aspirációs funkció működését.

A termék ábrája:

VERITAS Fejlett folyadékkezelő készlet

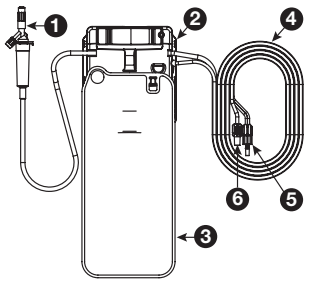

VERITAS Fejlett infúziós készlet



1. Irrigációs tüske (az irrigációs forráshoz)
2. Kazetta
3. Váladékgyűjtő zsák
4. Öblítő- és aspirációs csőkészlet (a kézidarabhoz)
5. Irrigációs Luer-záras csatlakozó
6. Aspirációs csatlakozó

Csak a VERITAS Fejlett infúziós készlet esetében:
7. Infúziós vezeték
8. Infúziós csatlakozó (a konzolhoz)

Javallatok/ellenjavallatok/rendeltetésszerű beteg/rendeltetésszerű felhasználó:
A javallatokkal/ellenjavallatokkal/rendeltetésszerű beteggel/rendeltetésszerű felhasználóval kapcsolatos összes releváns információt a Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. phacoemulzifikációs rendszer kezelési útmutatójában találja. Ellenjavallatok: A betegnek minden olyan meglévő betegsége, amely az egészségügyi ellátó véleménye szerint a szürkehályog-műtét ellenjavallatát képezi. A rendeltetésszerű betegek közé tartoznak a szürke hályogos felnőtt betegek, illetve az elülső szegmens szemészeti műtétjén (pl. a szemlencse eltávolítása) áteső felnőtt betegek. Megjegyzés: Terhes és szoptató nők vagy gyermekek nem vettek részt az elvégzett klinikai vizsgálat(ok)ban. A Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. phacoemulzifikációs rendszert egy szemész és a sebész utasításai mellett dolgozó kisegítő személyzet használhatja.

Klinikai előnyök/nemkívánatos mellékhatások/nemkívánatos hatások:
A klinikai előnyökkel/nemkívánatos mellékhatásokkal/nemkívánatos hatásokkal kapcsolatos releváns információkat a kezelési útmutatóban találja. A Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. phacoemulzifikációs rendszerének klinikai előnyei közé tartoznak a következők: a látás gyors rehabilitációja, korai visszatérés a napi tevékenységekhez, minimális mértékű szemgyulladás, minimális mértékű posztoperatív asztigmatizmus, csökkent esély a szemmel kapcsolatos szövődményekre. A Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. phacoemulzifikációs rendszerrel kapcsolatos szövődmények közé tartozik a törött tok, a szaruhártya égése, a fertőzés/gyulladás és a szaruhártya ödémája.

Használati utasítások:
A VERITAS készlet megfelelő felszereléséhez kövesse az alábbi utasításokat. A VERITAS Fejlett infúziós készlet esetében egy további lépés szükséges, amint alább olvasható. A VERITAS Fejlett infúziós készlet használatához a műtét előtt ki kell választani a Programbeállítások alatt a Fejlett infúzió opciót. További útmutatást a kezelési útmutatóban talál. A használat előtt szemrevételezéssel vizsgálja meg a termék tálcáját a csomagolás épségének ellenőrzésére. Ne használja a terméket, ha a csomagolás sérült.

1. Miután steril technikával kivette az összetevőket a fedéllel lezárt terméktálcából, adja át a KAZETTÁT és az IRRIGÁCIÓS TÜSKÉT a műtőssegédnek (ápolónak), az ÖBLÍTŐ- ÉS ASPIRÁCIÓS CSŐKÉSZLETET pedig tartsa a steril területen belül.
2. Helyezze a monitorizoláló kendőt a VERITAS Vision rendszer monitorára.
3. Fogja meg a Mayo állványizoláló kendőt a kendőn található jelöléseknek megfelelően, és takarja be vele a VERITAS Vision rendszer tálcatartó karját.
4. Helyezze be a KAZETTÁT a VERITAS Vision rendszer folyadékpaneljába.
5. Nyomja be a KAZETTÁT úgy, hogy a rendszer aktiválja a rögzítőreteszt, és benntartsa a KAZETTÁT.
6. Készítse elő az irrigációs oldat forrását.
7. Távolítsa el a védőelemet az IRRIGÁCIÓS TÜSKE csúcsáról.
8. A forrást felfelé tartva szúrja be az IRRIGÁCIÓS TÜSKÉT a forrás gumidugaszának közepébe úgy, hogy közben ne forgassa azt meg.
9. Akassza fel a forrást az infúziós állványra, majd nyomogassa a cseppkamrát addig, amíg az feléig-háromnegyedéig fel nem töltődik.
10. Csak a VERITAS Fejlett infúziós készlet esetében: Az INFÚZIÓS VEZETÉK fekete INFÚZIÓS CSATLAKOZÓVAL rendelkezik a szabad végén. Vezesse be az INFÚZIÓS CSATLAKOZÓT a VERITAS Vision rendszer oldalpanelébe, majd csavarja az óramutató járása szerint, amíg kattanással teljesen helyére nem záródik.
11. A záró irrigációs port nélküli kézidarabok esetében húzza vissza a gallért az IRRIGÁCIÓS LUER-ZÁRAS CSATLAKOZÓN. Csatlakoztassa az ÖBLÍTŐ- ÉS ASPIRÁCIÓS CSŐKÉSZLET Luer-záras csatlakozásait a kézidarabhoz. A záró irrigációs porttal felszerelt kézidarabok esetében a kézidarab záras rögzítéséhez forgassa el a gallért az IRRIGÁCIÓS LUER-ZÁRAS CSATLAKOZÓN az óramutató járása szerint.
12. Csatlakoztassa a hegyet és az öblítőhüvelyt a kézidarabhoz az összeszerelési utasításoknak megfelelően.
13. A VERITAS Vision rendszer FELTÖLTÉS/BEÁLLÍTÁS képernyőjén aktiválja a Folyamatos öblítés funkciót úgy, hogy közben a kézidarab hegye lefelé néz a próbatartályban, és a próbatartály nincs leszigetelve az öblítőhüvelynél.
14. Töltse fel a próbatartályt folyadékkal úgy, hogy az teljesen légmentes legyen, majd helyezze be a próbatartályt egyenesen, a hegy és az öblítőhüvely közepénél úgy, hogy az öblítőhüvely tömítésre kerüljön.
15. Kapcsolja ki a Folyamatos öblítés funkciót, majd végezze el a feltöltési műveletet a kezelési útmutatóban leírtaknak megfelelően.

Általános tudnivalók:
Az eszköz nem tartalmaz ftalátokat.

A készlet etilén-oxiddal van sterilizálva, és egyszeri felhasználásra szolgál.

Hűvös, száraz helyen tárolandó.

Óvintézkedések:
- Ne használja fel a terméket a termék csomagolásán, illetve címkéin jelzett lejárati időn túl.
- A csomag tartalma steril, amennyiben a termék tálcája le van zárva a fedéllel, és a csomagolás sértetlen.

A dokumentum kizárólag a nyomtatás napján érvényes. Ha bizonytalan a nyomtatás napjában, akkor kérjük, nyomtassa újra, hogy biztos legyen abban, hogy a használati útmutató (IFU) legfrissebb változatát használja (elérhetősége: www.e-ifu.com). A felhasználó saját felelőssége, hogy a legfrissebb használati útmutatót használja.

- Ha a használat során a termék teljesítménye csökken, függessze fel a használatot, és végezze el a megfelelő vizsgálatokat a rendszer kezelési útmutatójában leírtak szerint. Ha az eredmények nem kielégítőek, cserélje ki a készletet a kezelési útmutató utasításainak megfelelően.
- A VERITAS Fejlett infúziós készlet használatakor az irrigációs forrás hatékony teljes magassága nem lehet 30 cm-nél alacsonyabb, amikor a Fejlett infúzió aktiválva van.
- A VERITAS Fejlett infúziós készlet palackban vagy zsákban lévő irrigációs oldattal is használható, miután a Feltöltés/beállítás sikeresen befejeződött. Nem minden zsákkal lehetséges a Feltöltés végrehajtása, ami a kezelés késleltetéséhez vezethet.

Figyelmeztetés:
Csak egyszeri felhasználásra. Ne sterilizálja újra, ne dolgozza fel újra, és ne használja fel többször az eszközt.

A Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. egyszer használatos orvosi eszközei olyan használati és kezelési útmutatókkal vannak ellátva, amelyek segítségével minimalizálhatók a terméket, a beteget vagy a felhasználót potenciálisan veszélyeztető körülmények. A Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. egyszer használatos orvostechnikai eszközeinek újrasterilizálása/újrafeldolgozása az orvostechnikai eszköz fizikai károsodását vagy rendeltetésszerű funkciójának elvesztését eredményezheti, illetve a beteg megbetegedését vagy egészségkárosodását okozhatja a termék beszennyeződése, fertőzések átvitele, valamint a termék sterilitásának megszűnése miatt kialakuló fertőzés, gyulladás és/vagy megbetegedés révén.

Ártalmatlanítás:
A vérrel, szövetekkel és/vagy a szervezetből származó testnedvekkel/anyagokkal szennyezett VERITAS készlet biológiailag veszélyes orvosi hulladékként kell kezelni az egészségügyi intézmény szabályzatának és az alkalmazandó helyi követelményeknek megfelelően.

Ha a VERITAS készlet nem megfelelő állapotban érkezik, kérjük, azonnal lépjen kapcsolatba a helyi Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. értékesítési irodával. Minden VERITAS készletet egy tételszám azonosít a termékcsomagolás címkéjén, amit a termékkel kapcsolatos, írásbeli vagy szóbeli kommunikációk során meg kell adnia.

Az Amerikai Egyesült Államokban díjmentesen hívható telefonszám: 1-877-266-4543.

Súlyos események jelentése:
A termékkel kapcsolatos panaszokkal, illetve mellékhatásokkal kapcsolatban kérjük, forduljon a Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. helyi képviseletéhez. Ha a termék nem megfelelő állapotban érkezik, kérjük, azonnal lépjen kapcsolatba a helyi Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. értékesítési irodával. Minden tartozékot egy tételszám azonosít, amit a levelezések vagy megbeszélések során meg kell adnia. Az Amerikai Egyesült Államokban díjmentesen hívható telefonszám: 1-877-266-4543.

Súlyos események jelentése (EU):
Az Európai Unióban és az azonos szabályozási rendszerrel rendelkező országokban élő beteg/felhasználó/harmadik fél esetén, ha az eszköz használata során vagy annak következtében súlyos esemény történt, kérjük, jelentse azt a Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. vállalatnak és/vagy a vállalat meghatalmazott képviselőjének, valamint a felhasználó, illetve beteg tartózkodási helye szerinti tagország illetékes hatóságának.

Szimbólum/cím (magyarázat):

SZIMBÓLUM	CÍM (MAGYARÁZAT)
	Olvassa el a használati útmutatót vagy az elektronikus használati útmutatót
	Tilos újrafelhasználni!
	Etilén-oxiddal sterilizálva
	Katalógusszám
	Sarzskód
	Lejárati idő
	Gyártó
	Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben/Európai Unióban
	Tilos újrasterilizálni!
	Importőr
	Egyedi eszközazonosító
	Meghatalmazott képviselő Svájcban
	Gyártási dátum
	Ne használja, ha a csomagolás sérült, és olvassa el a használati utasítást
	Európai Közösség/Európai Unió
	Svájc
	Csomagolási egység
	Figyelem
	Egyszeres steril barrier rendszer
	Figyelem! A szövetségi (USA) törvények értelmében ez az eszköz csak engedéllyel rendelkező egészségügyi szakember által vagy annak megbízásából értékesíthető.
	Itt nyílik
	Orvostechnikai eszköz
	Törékeny, óvatosan kezelje
	Tartsa szárazon
	Ezzel az oldalával felfelé

Figyelem! Az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi törvényei szerint ez az eszköz kizárólag orvos által vagy orvosi rendelvényre értékesíthető.

Készült Mexikóban

℞ only

Ievads/apraksts:
VERITAS uzlabotu infūziju šķīdumu pakete vai VERITAS uzlabotu šķidrumu pakete ir DUĀLĀ SŪKŅA komplekts, kurš nodrošina visas caurulītes un piederumus, kas ir nepieciešami irigācijas un aspirācijas procedūras vai fakoemulsifikācijas procedūras veikšanai. VERITAS uzlabotu infūziju šķīdumu paketē ir papildu caurulītes vads, kas irigācijas šķīduma avotam nodrošina saspiestu gaisu. Katrā iepakojumā ir šādi priekšmeti:

1. Kasete ar caurulīšu bloku
2. Monitora priekškara pārsegs
3. Mayo statīva priekškara pārsegs
4. Testa kamera

Paredzētais nolūks:
VERITAS uzlabotu infūziju šķīdumu paketē vai VERITAS uzlabotu šķidrumu paketē ir iekļauta kasete un caurulīšu bloks, un tā ir paredzēta, lai priekšējā segmenta kataraktas operācijas laikā veiktu irigāciju un aspirāciju. To lieto kopā ar VERITAS™ Vision sistēmu. Testa kamera ir paredzēta, lai pirms ķirurģiskās procedūras pārbaudītu pareizu irigācijas/aspirācijas funkcijas savienojamību un darbību.

Izstrādājuma attēli:

VERITAS uzlabotu šķidrumu pakete

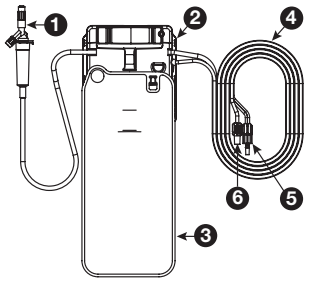

1. Irigācijas durklis (uz irigācijas avotu)
2. Kasete
3. Drenāžas maiss
4. I/A caurulīšu komplekts (uz rokā turamu ierīci)
5. Irigācijas Luera tipa stiprinājums
6. Aspirācijas stiprinājums

VERITAS uzlabotu infūziju šķīdumu pakete

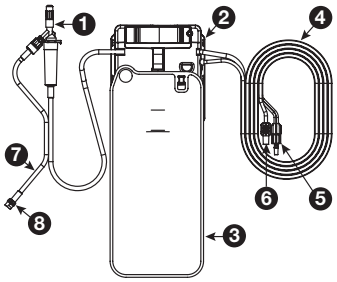

Tikai VERITAS uzlabotu infūziju šķīdumu paketei:
7. Infūzijas vads
8. Infūzijas savienotājs (uz konsoli)

Indikācijas/kontrindikācijas/paredzētais pacients/paredzētais lietotājs:
Visa attiecīgā informācija par indikācijām/kontrindikācijām/paredzēto pacientu/paredzēto lietotāju ir aprakstīta Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. fakoemulsifikācijas sistēmas operatora rokasgrāmatā ("operatora rokasgrāmata"). Kontrindikācijas: Visi iepriekš pastāvoši pacienta stāvokļi, kurus veselības aprūpes sniedzējs uzskata par kontrindikāciju kataraktas operācijai. Paredzētie pacienti ir pieauguši pacienti ar kataraktu vai pieauguši pacienti, kuriem tiek veikta priekšējā segmenta oftalmiska operācija (piemēram, kristāliskās lēcas noņemšana). Piezīme. Veiktajā(-os) klīniskajā(-os) pētījumā(-os) netika iekļautas grūtnieces, sievietes, kuras baro bērnu ar krūti, un bērni. Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. fakoemulsifikācijas sistēma ir paredzēta oftalmologa un atbalsta personāla lietošanai ķirurga vadībā.

Klīniskie ieguvumi/nevēlamās blakusparādības/nelabvēlīga ietekme:
Visa saistītā informācija par klīniskajiem ieguvumiem/nevēlamajām blakusparādībām/nelabvēlīgām ietekmēm ir aprakstīta operatora rokasgrāmatā. Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. fakoemulsifikācijas sistēma nodrošina šādus klīniskos ieguvumus: Ātra vizuālā rehabilitācija, drīza ikdienas aktivitāšu atsākšana, minimāls acu iekaisums, minimāls pēcoperācijas astigmātisms, samazināts potenciālo acu komplikāciju rašanās risks. Komplikācijas, kas var būt saistītas ar Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. fakoemulsifikācijas sistēmu, tostarp ir kapsulas plīsums, radzenes apdegums, infekcija/iekaisums un radzenes tūska.

Lietošanas instrukcijas:
Skatiet turpmākās norādes par to, kā pareizi uzstādīt VERITAS paketi. VERITAS uzlabotu infūziju šķīdumu pakete ir papildu solis, kā norādīts tālāk. Lai izmantotu VERITAS uzlabotu infūziju šķīdumu paketi, programmas iestatījumos pirms operācijas ir jāatlasa uzlabotā infūzija. Papildu norādījumus skatiet operatora rokasgrāmatā. Pirms lietošanas vizuāli pārbaudiet, vai izstrādājuma paliktņa iepakojums ir vesels. Nelietojiet izstrādājumu, ja iepakojums nav vesels.

1. Pēc visa satura sterilas izņemšanas no izstrādājuma paliktņa, kas noslēgts ar vāku, padodiet KASETI un IRIGĀCIJAS DURKLI nesterilajam lietotājam (medmāsai), savukārt I/A CAURULĪŠU BLOKU paturot sterilajā zonā.
2. Monitora priekškara pārsegu novietojiet pār VERITAS Vision sistēmas monitoru.
3. Ievietojiet rokas Mayo statīva priekškara pārsegā saskaņā ar norādēm uz priekškara un pārsedziet VERITAS Vision sistēmas paliktņa strēli.
4. Ievietojiet KASETI VERITAS Vision sistēmas fluīdikas panelī.
5. Stumiet KASETI, līdz sistēma aktivizē fiksācijas mehānismu, lai noturētu KASETI vietā.
6. Sagatavojiet irigācijas šķīduma avotu.
7. Noņemiet aizsargu no IRIGĀCIJAS DURKĻA gala.
8. Avotu turot stateniski, IRIGĀCIJAS DURKLI ievietojiet taisni gumijas avota aizbāžņa centrā bez grozīšanas.
9. Piekariet pudeli I/V statīvam un pēc tam saspiediet un atlaidiet pilināšanas kameru, līdz tā ir no 1/2 līdz 3/4 pilna.
10. Tikai VERITAS uzlabotu infūziju šķīdumu paketei: INFŪZIJAS VADA brīvajā galā ir melns INFŪZIJAS SAVIENOTĀJS. Ievietojiet INFŪZIJAS SAVIENOTĀJU VERITAS Vision sistēmas sānu panelī un pēc tam grieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz tas ar klikšķi savienojas pilnībā.
11. Rokā turamajām ierīcēm bez bloķējošas irigācijas pieslēgvietas atvelciet manšeti uz IRIGĀCIJAS LUERA TIPA STIPRINĀJUMA. I/A CAURULĪŠU KOMPLEKTA Luera tipa savienojumus pievienojiet rokā turamajai ierīcei. Rokā turamajām ierīcēm, kas ir aprīkotas ar bloķējošu irigācijas pieslēgvietu, manšeti uz IRIGĀCIJAS LUERA TIPA SAVIENOJUMA grieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai stiprinājumu fiksētu pie rokā turamās ierīces.
12. Galu un irigācijas uzmavu piestipriniet rokā turamajai ierīcei saskaņā ar uzstādīšanas instrukcijām.
13. VERITAS Vision sistēmas UZPILDĪŠANAS/PIELĀGOŠANAS ekrānā aktivizējiet nepārtrauktu irigāciju, kad rokā turamās ierīces gals ir vērsts uz leju testa kamerā un nav noslēgts pret irigācijas uzmavu.
14. Piepildiet testa kameru ar šķidrumu, izvadot visu gaisu, un ievietojiet testa kameru taisni un pa vidu pār galu un irigācijas uzmavu, līdz tā noslēdzas.
15. Deaktivizējiet nepārtraukto irigāciju un veiciet uzpildīšanas darbību secību saskaņā ar operatora rokasgrāmatu.

Vispārīgi:
Šī ierīce nesatur ftalātus.

Pakete ir sterilizēta, izmantojot etilēnoksīdu, un ir paredzēta vienreizējai lietošanai.

Izstrādājums jāglabā vēsā, sausā vietā.

Piesardzības pasākumi:

- Neizmantojiet šo izstrādājumu pēc tā derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz izstrādājuma iepakojuma etiķetēm.
- Ja izstrādājuma paliktnis ir noslēgts ar vāku un nav bojāts, tā saturs ir sterils.
- Ja lietošanas laikā izstrādājuma veiktspēja pasliktinās, pārtrauciet lietošanu un veiciet sistēmas operatora rokasgrāmatā izklāstītos attiecīgos testus. Ja rezultāti nav apmierinoši, nomainiet paketi, izpildot operatora rokasgrāmatā sniegtās instrukcijas.

Šis dokuments ir derīgs tikai drukāšanas dienā. Ja izdrukāšanas datums nav zināms, izdrukājiet dokumentu vēlreiz, lai izmantotu jaunāko pārskatīto lietošanas instrukcijas versiju (pieejama vietnē www.e-ifu.com). Lietotājs ir atbildīgs par to, lai tiktu izmantota jaunākā lietošanas instrukcija.

Johnson & Johnson VISION

Z311979E B

- Kad izmantojat VERITAS uzlabotu infūziju šķīdumu paketi un ir aktivizēta uzlabotā infūzija, irigācijas avota faktiskais kopējais augstums nevar būt mazāks par 30 cm.
- VERITAS uzlabotu infūziju šķīdumu paketi var izmantot ar irigācijas šķīdumu pudelē vai maisiņā pēc tam, kad ir veikta sekmīga uzpildīšana/pielāgošana. Ne visiem maisiņiem uzpildīšanu var izpildīt sekmīgi, un tas var aizkavēt procedūru.

Brīdinājums:

Tikai vienreizējai lietošanai. Šo ierīci nedrīkst atkārtoti sterilizēt, atkārtoti apstrādāt vai atkārtoti lietot.

Lai līdz minimumam samazinātu tādu apstākļu ietekmi, kuru dēļ var ciest izstrādājums, pacients vai lietotājs, uz Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. vienreizlietojamām medicīniskajām ierīcēm ir marķējums ar norādījumiem par to lietošanu un rīkošanos ar tām. Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. vienreizlietojamo medicīnisko ierīču atkārtota sterilizēšana/apstrāde var izraisīt medicīniskās ierīces fiziskus bojājumus, ierīces darbības traucējumus un pacienta saslimšanu vai traumu infekcijas, iekaisuma un/vai slimības dēļ, ko izraisījis izstrādājuma piesārņojums, infekciju pārnešana vai izstrādājuma nesterilitāte.

Likvidēšana:

Pret visām VERITAS paketēm, kas ir piesārņotas ar asinīm, audiem un/vai ķermeņa šķidrumiem/vielām, ir jāizturas kā pret bioloģiski bīstamiem medicīniskiem atkritumiem saskaņā ar veselības aprūpes iestādes protokolu un spēkā esošajām vietējām prasībām.

Ja VERITAS pakete ir saņemta neapmierinošā stāvoklī, nekavējoties sazinieties ar vietējo Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. tirdzniecības biroju. Katra VERITAS pakete uz izstrādājuma iepakojuma etiķetēm ir apzīmēta ar partijas numuru, un tas ir jānorāda ikvienā rakstiskā vai mutiskā saziņā.

Bezmaksas tālrunis ASV: 1-877-266-4543.

Ziņošana par nopietniem incidentiem:

Sazinieties ar vietējo pārstāvi, lai uzņēmumam Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. ziņotu par sūdzībām saistībā ar šo izstrādājumu un/vai par nevēlamiem notikumiem. Ja izstrādājums tiek saņemts neapmierinošā stāvoklī, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar vietējo Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. tirdzniecības biroju. Katra sastāvdaļa ir apzīmēta ar partijas numuru, kas ir jānorāda ikvienā rakstiskā vai mutiskā saziņā. Bezmaksas tālrunis ASV: 1-877-266-4543.

Ziņošana par nopietniem incidentiem (ES):

Pacientam/lietotājam/trešajai pusei Eiropas Savienībā un valstīs ar identisku tiesiskā regulējuma režīmu; ja šīs ierīces lietošanas laikā vai lietošanas rezultātā ir noticis nopietns incidents, lūdzu, ziņojiet par to uzņēmumam Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. un/vai tā pilnvarotajam pārstāvim un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā ir reģistrēts lietotājs un/vai pacients.

Simbols/nosaukums (skaidrojums):

SIMBOLS	NOSAUKUMS (SKAIDROJUMS)
	Skatīt lietošanas instrukciju vai skatīt elektronisko lietošanas instrukciju
	Nelietot atkārtoti
STERILE EO	Sterilizēts, izmantojot etilēna oksīdu
REF	Kataloga numurs
LOT	Partijas kods
	Derīguma termiņš
	Ražotājs
EC REP	Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā/Eiropas Savienībā

SIMBOLS	NOSAUKUMS (SKAIDROJUMS)
	Nesterilizēt atkārtoti
	Importētājs
UDI	Unikālais ierīces identifikators
CH REP	Pilnvarotais pārstāvis Šveicē
	Ražošanas datums
	Nelietot, ja iepakojums ir bojāts, un skatīt lietošanas instrukciju
EC	Eiropas Kopiena/Eiropas Savienība
CH	Šveice
	Iepakojuma vienība
	Piesardzības paziņojums
	Vienas sterilās barjeras sistēma
Rx only	Uzmanību! Federālie tiesību akti ierobežo šīs ierīces tirdzniecību: to drīkst pārdot tikai licencētiem veselības aprūpes speciālistiem vai pēc to pasūtījuma.
	Atvērt šeit
MD	Medicīniska ierīce
	Trausls, rīkoties uzmanīgi
	Glabāt sausumā
	Ar šo pusi uz augšu

Uzmanību! Federālie (ASV) tiesību akti nosaka, ka šo ierīci drīkst pārdot tikai ārsts vai pēc ārsta pasūtījuma.

Ražots Meksikā

Šis dokuments ir derīgs tikai drukāšanas dienā. Ja izdrukāšanas datums nav zināms, izdrukājiet dokumentu vēlreiz, lai izmantotu jaunāko pārskatīto lietošanas instrukcijas versiju (pieejama vietnē www.e-ifu.com). Lietotājs ir atbildīgs par to, lai tiktu izmantota jaunākā lietošanas instrukcija.

Johnson & Johnson VISION

℞ only

Įvadas / aprašas:
„VERITAS Advanced Infusion Pack“ arba „VERITAS Advanced Fluidics Pack“ yra DVIEJŲ SIURBLIŲ pakuotė, kurioje yra visi vamzdeliai ir priedai, reikalingi drėkinimo ir išsiurbimo procedūrai arba fakoemulsifikacijos procedūrai atlikti. „VERITAS Advanced Infusion Pack“ yra papildoma vamzdelių linija, skirta tiekti suslėgtąjį orą į drėkinimo tirpalo šaltinį. Kiekvieną pakuotę sudaro šios dalys:

1. Kasetės ir vamzdelių komplektas
2. Monitoriaus apvalkalas
3. „Mayo“ stovo apvalkalas
4. Bandymų kamera

Paskirtis:
„VERITAS Advanced Infusion Pack“ arba „VERITAS Advanced Fluidics Pack“ yra kasetės ir vamzdelių komplektas ir ji skirta drėkinti bei išsiurbti, atliekant priekinio segmento kataraktos chirurginę operaciją. Jis naudojamas su „VERITAS™ Vision“ sistema. Bandymų kamera skirta prieš chirurginę operaciją patikrinti, ar įrenginys tinkamai prijungtas ir drėkinimo / išsiurbimo funkcija veikia.

Produkto piešiniai:

„VERITAS Advanced Fluidics Pack“

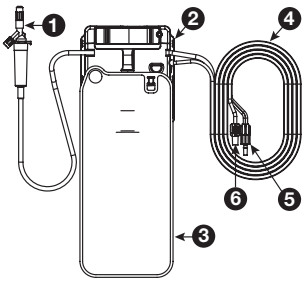

1. Drėkinimo smaigalys (Prie drėkinimo šaltinio)
2. Kasetė
3. Drenažinis maišelis
4. I/A vamzdelių rinkinys (Į rankinį instrumentą)
5. Drėkinimo Luerio jungtis
6. Įsiurbimo jungtis

„VERITAS Advanced Infusion Pack“

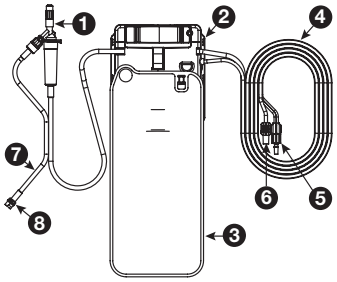

Tik „VERITAS Advanced Infusion Pack“:
7. Infuzijos linija
8. Infuzijos jungtis (Į pultą)

Indikacijos / kontraindikacijos / numatytasis pacientas / numatytasis naudotojas:
Visa aktuali informacija apie indikacijas / kontraindikacijas / numatytąjį pacientą / numatytąjį naudotoją aprašyta „Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.“ fakoemulsifikacijos sistemos operatoriaus vadove („Operatoriaus vadovas“). Kontraindikacijos: bet kokia esama (-os) paciento būklė (-ės), kurią (-ias) sveikatos priežiūros specialistas nustato kaip kontraindikaciją kataraktos operacijai. Numatytieji pacientai yra katarakta sergantys suaugę pacientai arba pacientai, kuriems atliekama priekinio segmento oftalmologinė operacija (pvz., šalinamas skaidrus lęšiukas). Pastaba: nėščiosios, žindyvės ar vaikai nebuvo įtraukti į atliktą (-us) klinikinį (-ius) tyrimą (-us). „Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.“ fakoemulsifikacijos sistema skirta naudoti oftalmologui ir pagalbiniam personalui, dirbančiam pagal chirurgo nurodymus.

Klinikinė nauda / nepageidaujamas poveikis / šalutinis poveikis:
Visa aktuali informacija apie klinikinę naudą / nepageidaujamą poveikį / šalutinį poveikį pateikiama operatoriaus vadove. „Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.“ fakoemulsifikacijos sistemos klinikinė nauda: greita regėjimo reabilitacija, ankstyvas kasdienės veiklos atnaujinimas, minimalus akių uždegimas, minimalus pooperacinis astigmatizmas, sumažėjęs akių komplikacijų pavojus. Komplikacijos, kurios gali būti susijusios su „Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.“ fakoemulsifikacijos sistema: sulūžusi kapsulė, ragenos nudegimas, infekcija / uždegimas ir ragenos edema.

Naudojimo instrukcijos:
Toliau pateikiamos instrukcijos, kaip tinkamai prijungti „VERITAS Pack“. Jungiant „VERITAS Advanced Infusion Pack“, reikia atlikti vieną papildomą žingsnį, kaip nurodoma toliau. Norint prijungti „VERITAS Advanced Infusion Pack“, prieš operaciją programos nustatymuose reikia pasirinkti „Advanced Infusion“ (sudėtingesnė infuzija). Papildomų instrukcijų ieškokite operatoriaus vadove. Prieš naudodami apžiūrėkite gaminio dėklą, ar nepažeistas jo vientisumas. Nenaudokite gaminio, jei pakuotė buvo pažeista.

1. Steriliomis sąlygomis išėmę visą turinį iš uždaryto gaminio dėklo, perduokite KASETĘ ir DRĖKINIMO SMAIGALĮ pagalbiniam gydytojui (slaugytojui), bet I/A VAMZDELIUS palikite sterilioje vietoje.
2. Monitoriaus apvalkalą uždėkite ant „VERITAS Vision“ sistemos monitoriaus.
3. Įkiškite rankas į „Mayo“ stovo apvalkalą pagal žymes ant apvalkalo ir uždenkite „VERITAS Vision“ sistemos dėklo laikiklį.
4. Įstatykite KASETĘ į „VERITAS Vision“ sistemos skysčių valdymo pultą.
5. Paspauskite KASETĘ, kol sistema aktyvuos skląsčio mechanizmą ir užfiksuos KASETĘ.
6. Paruoškite drėkinimo tirpalo šaltinį.
7. Nuimkite apsauginį antgalį nuo DRĖKINIMO SMAIGALIO.
8. Šaltiniui esant vertikaliojoje padėtyje, įsmeikite DRĖKINIMO SMAIGALĮ tiesiai į guminio šaltinio kamščio centrą nesukdami.
9. Pakabinkite šaltinį ant I/V laikiklio bei suspauskite ir atleiskite lašinimo kamerą, kol prisipildys 1/2–3/4 jos tūrio.
10. Skirta tik „VERITAS Advanced Infusion Pack“: INFUZIJOS LINIJOS laisvajame gale yra juoda INFUZIJOS JUNGTIS. Įkiškite INFUZIJOS JUNGTĮ į „VERITAS Vision“ sistemos šoninį skydelį ir sukite pagal laikrodžio rodyklę, kol ji visiškai užsifiksuos.
11. Rankiniams instrumentams be fiksuojamosios drėkinimo angos, žiedą įtraukite ant DRĖKINIMO LUERIO JUNGTIES. Prijunkite I/A VAMZDELIŲ Luerio jungtis prie rankinio instrumento. Rankiniams instrumentams su fiksuojamuoju drėkinimo prievadu pasukite DRĖKINIMO LUERIO JUNGTIES žiedą pagal laikrodžio rodyklę, kad jungtį užfiksuotumėte prie rankinio instrumento.
12. Prijunkite antgalį ir drėkinimo movą prie rankinio instrumento pagal komplekto instrukcijas.
13. Sistemos „VERITAS Vision“ ekrane UŽPILDYTI / SUDERINTI aktyvinkite funkciją „Continuous Irrigation“ (nenutrūkstamas drėkinimas), rankinio instrumento antgalį testo kameroje laikydami nukreiptą žemyn, neprigludusį prie drėkinimo rankovės.
14. Užpildykite bandymų kamerą skysčiu, išstumdami visą orą ir įstatykite bandymų kameros centrą tiesiai ant antgalio ir drėkinimo movos, kol ji sandariai prisispaus.
15. Išjunkite nenutrūkstamą drėkinimą ir atlikite užpildymo seką pagal operatoriaus vadovą.

Bendroji informacija:
Šio įrenginio sudėtyje nėra ftalatų.

Pakuotė yra sterilizuota etileno oksidu ir skirta vienkartiniam naudojimui.

Gaminį laikykite vėsioje, sausoje vietoje.

Atsargumo priemonės:

- Nenaudokite gaminio praėjus galiojimo datai, nurodytai gaminio pakuotės etiketėse.
- Turinys sterilus, kol gaminio dėklas yra sandariai uždarytas dangčiu ir nepažeistas.
- Jei naudojant gaminys ima prasčiau veikti, jo nebenaudokite ir atlikite reikiamus bandymus, išsamiau aprašytus sistemos operatoriaus vadove. Jei rezultatai netenkina, pakuotę pakeiskite laikydamiesi operatoriaus vadove aprašytų nurodymų.
- Naudojant „VERITAS Advanced Infusion Pack“, aktyvinus sudėtingesnę infuziją, bendras efektyvus drėkinimo šaltinio aukštis negali būti mažesnis nei 30 cm.

Šis dokumentas galioja tik nurodytu laikotarpiu. Jeigu nesate tikri dėl spausdinimo datos, dokumentą išspausdinkite iš naujo, kad turėtumėte naujausią naudojimo instrukcijų versiją (ją rasite www.e-ifu.com). Užtikrinimas, kad naudojama naujausia naudojimo instrukcijų versija, yra naudotojo atsakomybė.

Johnson&Johnson VISION

Z311979E B

- „VERITAS Advanced Infusion Pack“ galima naudoti su drėkinimo tirpalu butelyje arba maišelyje, kai sėkmingai baigiamas užpildymas / suderinimas. Ne visi maišeliai gali būti sėkmingai užpildyti ir dėl to gydymas gali vėluoti.

Įspėjimas:

Tik vienkartiniam naudojimui. Negalima sterilizuoti, apdoroti ir naudoti pakartotinai.

Siekiant sumažinti dėl sąlygų poveikio gaminiui, pacientui ar naudotojui kylantį pavojų, „Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.“ vienkartinio naudojimo medicinos priemonės yra ženklinamos nurodymais. Pakartotinai sterilizuojant ar apdorojant „Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.“ vienkartines medicinos priemones, jas galima fiziškai pažeisti, gali sutrikti numatytas jų veikimas, dėl infekcijos, uždegimo ir (arba) gaminio taršos, infekcijos perdavimo arba gaminio sterilumo trūkumo pacientas gali susirgti arba būti sužalotas.

Šalinimas:

„VERITAS Pack“ užteršta krauju, audiniais ir (arba) kūno skysčiais, turi būti tvarkoma kaip biologiškai pavojingos medicininės atliekos pagal sveikatos priežiūros įstaigos protokolą ir taikomus vietinius reikalavimus.

Jei „VERITAS Pack“ gaunamas nepatenkinamos būklės, nedelsdami susisiekite su vietiniu „Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.“ pardavimo skyriumi. Kiekvienoje „VERITAS Pack“ gaminio pakuotės etiketėje nurodomas partijos numeris, kuris turėtų būti įtrauktas į visą korespondenciją ar diskusijas.

Nemokamas telefono numeris JAV 1-877-266-4543.

Pranešimas apie rimtus incidentus:

Susisiekite su savo vietiniu atstovu, jei norite pateikti pretenziją dėl gaminio ir (arba) nepageidaujamų reiškinių „Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.“. Jei gaminį gavote nepatenkinamos būklės, nedelsdami susisiekite su vietiniu „Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.“ pardavimo skyriumi. Kiekviena dalis identifikuojama pagal partijos numerį, kuris turi būti nurodytas bet kokioje korespondencijoje arba diskusijose. Nemokamas telefono numeris JAV 1-877-266-4543.

Pranešimas apie rimtus incidentus (ES):

Skirta pacientui, naudotojui ir (arba) trečiajai šaliai Europos Sąjungoje ir šalyse, kuriose galioja toks pat reguliavimo režimas. Jei naudojant šią priemonę arba dėl jos naudojimo įvyko rimtas incidentas, praneškite apie tai „Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.“ ir (arba) jos įgaliotajam atstovui bei kompetentingai valstybės narės, kurioje gyvena vartotojas ir (arba) pacientas, institucijai.

Simbolis / pavadinimas (paaiškinimas):

SIMBOLIS	PAVADINIMAS (PAAIŠKINIMAS)
	Žiūrėkite naudojimo instrukcijas arba elektronines naudojimo instrukcijas
	Nenaudokite pakartotinai
	Sterilizuota etileno oksidu
	Katalogo numeris
	Partijos kodas
	Tinkamumo naudoti data
	Gamintojas
	Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje ir (arba) Europos Sąjungoje
	Nesterilizuoti pakartotinai

SIMBOLIS	PAVADINIMAS (PAAIŠKINIMAS)
	Importuotojas
	Unikalus prietaiso identifikatorius
	Įgaliotasis atstovas Šveicarijoje
	Pagaminimo data
	Nenaudokite, jei pakuotė pažeista, ir vadovaukitės naudojimo instrukcijomis
	Europos Bendrija / Europos Sąjunga
	Šveicarija
	Pakuotės vienetas
	Dėmesio
	Vienguba sterili barjerinė sistema
	Dėmesio. Federaliniai įstatymai leidžia šį prietaisą parduoti tik licencijuotam sveikatos priežiūros specialistui arba jo nurodymu.
	Atidaryti čia
	Medicinos prietaisas
	Dūžta, naudoti atsargiai
	Laikyti sausai
	Viršus

Dėmesio. Pagal federalinius įstatymus (JAV) šį prietaisą leidžiama parduoti tik gydytojui arba jo nurodymu.

Meksikos produktas

℞ only

Úvod/opis:
Pokročilá infúzna súprava VERITAS alebo súprava VERITAS na pokročilý manažment tekutín je súprava DUÁLNEJ PUMPY, ktorá obsahuje všetky hadičky a príslušenstvo potrebné na vykonanie irigácie a aspirácie či fakoemulzifikácie. Pokročilá infúzna súprava VERITAS obsahuje dodatočnú hadičku zabezpečujúcu prívod stlačeného vzduchu do zdroja irigačného roztoku. Každá súprava obsahuje nasledujúce časti:

1. Zostava kazety a hadičiek
2. Navliekací kryt na monitor
3. Navliekací kryt na stojan Mayo
4. Testovacia komora

Určený účel:
Pokročilá infúzna súprava VERITAS alebo súprava VERITAS na pokročilý manažment tekutín obsahuje zostavu kazety a hadičiek a je určená na vykonávanie irigácie a aspirácie počas operácie katarakty v prednom segmente oka. Používa sa so systémom VERITAS™ Vision. Testovacia komora je určená na overenie správneho pripojenia a fungovania irigačnej/aspiračnej funkcie pred operačným postupom.

Náčrty produktu:

Súprava VERITAS na pokročilý manažment tekutín

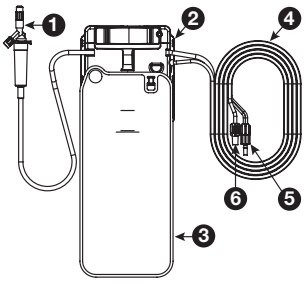

Pokročilá infúzna súprava VERITAS



1. Irigačná ihla (k irigačnému zdroju)
2. Kazeta
3. Drenážny vak
4. Súprava irigačnej a aspiračnej hadičky (k rukoväti)
5. Irigačný konektor Luer Lock
6. Aspiračný konektor

Len pokročilá infúzna súprava VERITAS:
7. Infúzna hadička
8. Infúzny konektor (ku konzole)

Indikácie/kontraindikácie/určený pacient/určený používateľ:
Všetky relevantné informácie týkajúce sa indikácií/kontraindikácií/určeného pacienta/určeného používateľa sú uvedené v používateľskej príručke fakoemulzifikačného systému Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. (ďalej len „používateľská príručka"). Kontraindikácie: Akékoľvek existujúce ochorenia pacienta, ktoré poskytovateľ zdravotnej starostlivosti označí ako kontraindikácie operácie katarakty. Medzi určených pacientov patria pacienti s kataraktami alebo dospelí pacienti, ktorí podstupujú operáciu predného segmentu oka (napr. odstránenie očnej šošovky). Poznámka: Do vykonaných klinických skúšaní neboli zahrnuté tehotné ženy, dojčiace ženy ani deti. Fakoemulzifikačný systém od spoločnosti Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. je určený na použitie oftalmológom a pomocným personálom pri operácii pod vedením chirurga.

Klinické prínosy/nežiaduce vedľajšie účinky/nepriaznivé účinky:
Všetky relevantné informácie týkajúce sa klinických prínosov/nežiaducich vedľajších účinkov/nepriaznivých účinkov sú uvedené v používateľskej príručke. Medzi klinické prínosy fakoemulzifikačného systému Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. patrí: rýchla rehabilitácia zraku, skoré obnovenie každodenných činností, minimálny zápal v oku, minimálny pooperačný astigmatizmus, znížené riziko očných komplikácií. Komplikácie, ktoré môžu byť spojené s fakoemulzifikačným systémom Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc., zahŕňajú ruptúru kapsuly, popáleniny rohovky, infekciu/zápal a opuch rohovky.

Návod na použitie:
Pozrite si nasledujúce pokyny na správnu inštaláciu súpravy VERITAS. V prípade pokročilej infúznej súpravy VERITAS je potrebný jeden dodatočný krok, ako sa uvádza nižšie. Aby bolo možné použiť pokročilú infúznu súpravu VERITAS, v položke Nastavenia programu musíte vybrať možnosť Pokročilá infúzia. Ďalšie pokyny nájdete v používateľskej príručke. Pred použitím vizuálne skontrolujte podnos produktu, či nedošlo k narušeniu integrity balenia. Ak je integrita balenia narušená, produkt nepoužívajte.

1. Po sterilnom vybratí všetkých komponentov z podnosu produktu utesneného vekom podajte KAZETU a IRIGAČNÚ IHLU sálovej sestre, pričom je potrebné zachovať SÚPRAVU IRIGAČNEJ A ASPIRAČNEJ HADIČKY v sterilnom poli.
2. Na monitor systému VERITAS Vision umiestnite navliekací kryt na monitor.
3. Podľa navádzacích označení na návleku vložte ruky do navliekacieho krytu na stojan Mayo a zakryte rameno podnosu systému VERITAS Vision.
4. Vložte KAZETU do panela pre tekutiny systému VERITAS Vision.
5. Zatláčajte KAZETU, kým systém neaktivuje západkový mechanizmus na zachytenie KAZETY.
6. Pripravte zdroj irigačného roztoku.
7. Odstráňte chránič z hrotu IRIGAČNEJ IHLY.
8. Držte zdroj vo zvislej polohe a bez otáčania zaveďte IRIGAČNÚ IHLU priamo do stredu gumenej zátky zdroja.
9. Zaveste zdroj na infúzny stojan a potom stláčajte a uvoľňujte odkvapkávaciu komoru, kým nebude do 1/2 až 3/4 plná.
10. Len v prípade pokročilej infúznej súpravy VERITAS: INFÚZNA HADIČKA má na voľnom konci čierny INFÚZNY KONEKTOR. Vložte INFÚZNY KONEKTOR do bočného panela systému VERITAS Vision a potom ho otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým sa po jeho úplnom pripojení neozve cvaknutie.
11. V prípade rukovätí bez zaisťovacieho irigačného portu zatiahnite prstenec na IRIGAČNOM KONEKTORE LUER LOCK. Pripojte konektory luer SÚPRAVY IRIGAČNEJ A ASPIRAČNEJ HADIČKY k rukoväti. V prípade rukovätí vybavených zaisťovacím irigačným portom otočte prstenec na IRIGAČNOM KONEKTORE LUER LOCK v smere hodinových ručičiek na zaistenie konektora k rukoväti.
12. Podľa pokynov na zostavenie pripojte k rukoväti hrot a irigačné puzdro.
13. Na obrazovke NAPLNIŤ/VYLADIŤ systému VERITAS Vision aktivujte nepretržitú irigáciu s hrotom rukoväti smerujúcim nadol do testovacej komory neutesnenej na irigačnom puzdre.
14. Naplňte testovaciu komoru tekutinou, pričom odstráňte všetok vzduch, a priamo do stredu do testovacej komory zaveďte hrot a irigačné puzdro, kým nebudú utesnené.
15. Deaktivujte nepretržitú irigáciu a podľa používateľskej príručky vykonajte sekvenciu naplnenia.

Všeobecné:
Táto pomôcka neobsahuje ftaláty.

Súprava je sterilizovaná etylénoxidom a je určená na jednorazové použitie.

Produkt skladujte na chladnom a suchom mieste.

Bezpečnostné opatrenia:
- Nepoužívajte produkt po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítkoch na balení produktu.
- Obsah je sterilný, ak je podnos produktu utesnený vekom a ak nie je poškodený.
- Ak počas použitia dôjde k narušeniu funkčnosti produktu, prestaňte ho používať a vykonajte príslušné testovanie podľa podrobného opisu v používateľskej príručke systému. Ak výsledky nie sú uspokojivé, vymeňte súpravu podľa pokynov uvedených v používateľskej príručke.
- V prípade použitia pokročilej infúznej súpravy VERITAS sa nemôže účinná celková výška zdroja dostať nižšie ako 30 cm, keď je aktivovaná funkcia pokročilej infúzie.

Tento dokument je platný iba v deň tlače. Ak si nie ste istí dátumom tlače, dokument opätovne vytlačte, aby ste zabezpečili použitie najnovšej revízie návodu na použitie (k dispozícii na www.e-ifu.com). Je zodpovednosťou používateľa, aby zabezpečil použitie najnovšieho návodu na použitie.

Johnson & Johnson VISION

Z311979E B

- Pokročilá infúzna súprava VERITAS sa môže používať s irigačným roztokom vo fľaši alebo vaku po úspešnom dokončení fázy Naplniť/Vyladiť. Nie všetky vaky môžu úspešne dokončiť fázu Naplniť, čo môže viesť k oneskoreniu liečby.

Varovanie:

Len na jednorazové použitie. Túto pomôcku opätovne nesterilizujte, nepripravujte na opätovné použitie ani opakovane nepoužívajte.

Jednorazové zdravotnícke pomôcky Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. majú na štítkoch uvedené pokyny na použitie a manipuláciu, aby sa tak minimalizovalo vystavenie produktu podmienkam, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na samotný produkt, pacienta či používateľa. Následkom opätovnej sterilizácie alebo prípravy na opätovné použitie jednorazových zdravotníckych pomôcok od spoločnosti Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. môže dôjsť k fyzickému poškodeniu a zlyhaniu správnej funkčnosti týchto pomôcok, ako aj k ochoreniu či poraneniu pacienta v dôsledku infekcie, zápalu a/alebo ochoreniu spôsobenému kontamináciou produktu, prenosom infekcie a nedostatočnou sterilitou produktu.

Likvidácia:

So všetkými súpravami VERITAS kontaminovanými krvou, tkanivom a/alebo telesnými tekutinami/materiálom sa musí zaobchádzať ako s biologicky nebezpečným zdravotníckym odpadom podľa protokolu zdravotníckeho zariadenia a platných miestnych požiadaviek.

Ak dostanete súpravu VERITAS v neuspokojivom stave, ihneď sa obráťte na miestneho predajcu spoločnosti Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Na každej súprave VERITAS sa na štítkoch balenia produktu nachádza číslo šarže, ktoré je potrebné uviesť pri každej korešpondencii či rozhovore.

V rámci USA volajte na bezplatnú linku: 1-877-266-4543.

Hlásenie závažných nežiaducich udalostí:

V prípade hlásenia akýchkoľvek reklamácií výrobku a/alebo nežiaducich udalostí v súvislosti s výrobkom Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. sa obráťte na miestneho zástupcu spoločnosti. Ak výrobok dostanete v neuspokojivom stave, ihneď sa obráťte na miestneho predajcu spoločnosti Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Každý komponent je označený číslom šarže, ktoré sa musí uviesť pri akejkoľvek korešpondencii alebo rozhovore. V rámci USA volajte na bezplatnú linku: 1-877-266-4543.

Hlásenie závažných incidentov (EÚ):

V prípade pacienta/používateľa/tretej strany v Európskej únii a v krajinách s identickým právnym systémom; ak sa počas používania tejto pomôcky alebo následkom jej používania vyskytne závažná nežiaduca udalosť, ohláste ju spoločnosti Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. a/alebo jej oprávnenému zástupcovi a zároveň kompetentnému orgánu členského štátu, v ktorom sa používateľ a/alebo pacient nachádzajú.

Symbol/názov (vysvetlenie):

SYMBOL	NÁZOV (VYSVETLENIE)
	Prečítajte si návod na použitie alebo si prečítajte elektronický návod na použitie
	Nepoužívajte opakovane
	Sterilizované etylénoxidom
	Katalógové číslo
	Kód šarže
	Dátum spotreby
	Výrobca
	Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve/Európskej únii

SYMBOL	NÁZOV (VYSVETLENIE)
	Nevykonávajte opätovnú sterilizáciu
	Dovozca
	Jedinečný identifikátor pomôcky
	Autorizovaný zástupca vo Švajčiarsku
	Dátum výroby
	Nepoužívajte, ak je obal poškodený, a prečítajte si návod na použitie
	Európske spoločenstvo/Európska únia
	Švajčiarsko
	Jednotka balenia
	Upozornenie
	Systém jednej sterilnej bariéry
	Upozornenie: Federálne zákony (USA) obmedzujú predaj tejto pomôcky iba na licencovaného zdravotníckeho pracovníka alebo na jeho objednávku.
	Tu otvoriť
	Zdravotnícka pomôcka
	Krehké, manipulujte opatrne
	Uchovávajte na suchom mieste
	Touto stranou nahor

Upozornenie: Federálne zákony (USA) obmedzujú predaj tejto pomôcky len prostredníctvom lekára alebo na objednávku lekára.

Vyrobené v Mexiku

Tento dokument je platný iba v deň tlače. Ak si nie ste istí dátumom tlače, dokument opätovne vytlačte, aby ste zabezpečili použitie najnovšej revízie návodu na použitie (k dispozícii na www.e-ifu.com). Je zodpovednosťou používateľa, aby zabezpečil použitie najnovšieho návodu na použitie.

℞ only

Introducere/Descriere:
VERITAS Pachet de perfuzie avansată sau VERITAS Pachet pentru gestionarea avansată a fluidelor este un pachet cu POMPĂ DUBLĂ care oferă toate tuburile și accesoriile necesare pentru efectuarea procedurii de irigare și aspirare sau a procedurii de facoemulsificare. VERITAS Pachet de perfuzie avansată conține o tubulatură suplimentară pentru a furniza aer comprimat în sursa cu soluție de irigare. Fiecare pachet este format din următoarele elemente:

1. Ansamblu de casetă și tuburi
2. Folie de acoperire pentru monitor
3. Folie de acoperire pentru suportul Mayo
4. Cameră de testare

Scop propus:
VERITAS Pachet de perfuzie avansată sau VERITAS Pachet pentru gestionarea avansată a fluidelor conține Ansamblul de casetă și tuburi și este conceput pentru irigarea și aspirarea în timpul intervenției chirurgicale de cataractă a segmentului anterior. Este utilizat împreună cu Sistemul VERITAS™ Vision. Camera de testare este menită să verifice, înainte de procedura chirurgicală, conectivitatea și funcționalitatea corectă a funcției de irigare/aspirare.

Reprezentarea schematică a produsului:

VERITAS Pachet pentru gestionarea avansată a fluidelor

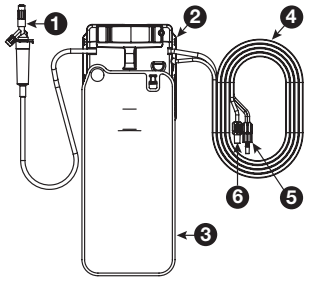

1. Ac de irigare (către sursa de irigare)
2. Casetă
3. Pungă de drenare
4. Set de tuburi I/A (către piesa de mână)
5. Racord de irigare luer cu blocare
6. Fiting de aspirație

VERITAS Pachet de perfuzie avansată



Doar pentru VERITAS Pachet de perfuzie avansată:
7. Linie de perfuzie
8. Racord de perfuzie (către consolă)

Indicații/contraindicații/pacient propus/utilizator propus:
Toate informațiile relevante pentru indicații/contraindicații/pacientul propus/utilizatorul propus sunt descrise în Manualul de operare a sistemului de facoemulsificare („Manual de operare") de la Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Contraindicații: orice afecțiuni preexistente ale pacientului pe care furnizorul de asistență medicală le determină ca fiind contraindicații la intervenția chirurgicală de cataractă. Printre pacienții propuși se numără pacienții adulți cu cataracte sau pacienții adulți care sunt supuși intervenției chirurgicale oftalmice de segment anterior (de exemplu, îndepărtarea cristalinului). Notă: femeile însărcinate, femeile care alăptează sau copiii nu au fost incluși în studiile clinice intervenționale efectuate. Sistemul de facoemulsificare Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. este destinat utilizării de către un oftalmolog și de către personalul de sprijin care operează sub îndrumarea chirurgului.

Beneficii clinice/efecte secundare nedorite/efecte adverse:
Toate informațiile relevante pentru beneficiile clinice/efectele secundare nedorite/efectele adverse sunt descrise în Manualul de operare. Printre beneficiile clinice ale sistemului de facoemulsificare de la Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. se numără următoarele: reabilitare vizuală rapidă, reluare rapidă a activităților zilnice, inflamație oculară minimă, astigmatism postoperatoriu minim, risc potențial redus de complicații oculare. Printre complicațiile care pot fi asociate cu sistemul de facoemulsificare Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. se numără capsulă spartă, arsură corneană, infecție/inflamație și edem cornean.

Instrucțiuni de utilizare:
Pentru modul corect de instalare a pachetului VERITAS, consultați instrucțiunile următoare. VERITAS Pachet de perfuzie avansată are o etapă suplimentară, așa cum este menționat mai jos. Pentru a utiliza VERITAS Pachet de perfuzie avansată, trebuie să selectați Perfuzie avansată în Setări program înainte de intervenția chirurgicală. Pentru instrucțiuni suplimentare consultați Manualul de operare. Înainte de utilizare, inspectați vizual tăvița pentru produs pentru a verifica dacă integritatea ambalajului a fost compromisă. Nu utilizați produsul dacă integritatea ambalajului a fost compromisă.

1. După scoaterea în condiții sterile a întregului conținut al tăviței pentru produs sigilate cu capac, înmânați CASETA și ACUL DE IRIGARE asistentului perioperator (asistentă medicală) păstrând SETUL DE TUBURI I/A în câmpul steril.
2. Puneți folia de acoperire pentru monitor peste Sistemul VERITAS Vision.
3. Așezați mâinile în folia de acoperire pentru suportul Mayo conform marcajelor de ghidare de pe folie și acoperiți brațul tăviței Sistemului VERITAS Vision.
4. Introduceți CASETA în complexul pentru fluide al Sistemului VERITAS Vision.
5. Împingeți CASETA până când sistemul activează mecanismul cu clapetă pentru a o fixa pe loc.
6. Pregătiți sursa cu soluție de irigare.
7. Scoateți elementul de protecție de pe vârful ACULUI DE IRIGARE.
8. Cu sursa orientată în sus introduceți ACUL DE IRIGARE în centrul dopului de cauciuc al sursei fără a răsuci.
9. Agățați sursa de stativul pentru perfuzie și apoi strângeți și dați drumul camerei de picurare până ce aceasta se umple pe jumătate sau pe trei sferturi.
10. Doar pentru VERITAS Pachet de perfuzie avansată: LINIA DE PERFUZIE este prevăzută cu un CONECTOR DE PERFUZIE negru la capătul liber. Introduceți CONECTORUL DE PERFUZIE în panoul lateral al Sistemului VERITAS Vision și răsuciți-l în sensul acelor de ceas până când se aude un clic atunci când este conectat complet.
11. Pentru piesele de mână fără port de irigare cu blocare, retrageți colierul de pe RACORDUL DE IRIGARE LUER CU BLOCARE. Conectați racordurile luer ale SETULUI DE TUBURI I/A la piesa de mână. Pentru piesele de mână dotate cu un port de irigare cu blocare, rotiți colierul de pe RACORDUL DE IRIGARE LUER CU BLOCARE în sensul acelor de ceas pentru a fixa racordul pe piesa de mână.
12. Atașați vârful și manșonul de irigare la piesa de mână conform instrucțiunilor de asamblare.
13. Din ecranul AMORSARE/REGLARE de pe Sistemul VERITAS Vision, activați Irigare continuă cu vârful piesei de mână orientat în jos, în interiorul unei camere de testare neetanșată pe manșonul de irigare.
14. Umpleți camera de testare cu lichid, eliminând integral aerul și introduceți camera de testare drept și centrat peste vârf și manșonul de irigare până la etanșare.
15. Dezactivați irigarea continuă și efectuați secvența de amorsare conform Manualului de operare.

Generalități:
Dispozitivul nu conține ftalați.

Pachetul este sterilizat cu oxid de etilenă și este conceput pentru unică folosință.

Depozitați produsul într-un loc rece și uscat.

Acest document este valid numai la data la care a fost imprimat. Dacă nu sunteți sigur de data imprimării, imprimați documentul din nou pentru a vă asigura că utilizați cea mai recentă ediție a instrucțiunilor de utilizare (disponibilă la adresa www.e-ifu.com). Este responsabilitatea utilizatorului să asigure utilizarea celor mai recente instrucțiuni de utilizare.

Johnson & Johnson VISION

Măsuri de precauție:

- Nu utilizați produsul după data de expirare marcată pe etichetele de pe ambalaj.
- Conținutul este steril atunci când tăvița pentru produs este sigilată cu capac și nedeteriorată.
- Dacă, în timpul utilizării, este compromisă performanța produsului, nu îl mai utilizați și efectuați testele corespunzătoare descrise detaliat în Manualul de operare a sistemului. Dacă rezultatele nu sunt satisfăcătoare, înlocuiți pachetul conform instrucțiunilor din Manualul de operare.
- Când se utilizează VERITAS Pachet de perfuzie avansată, înălțimea totală efectivă a sursei de irigare nu poate scădea sub 30 cm când Irigare avansată este activată.
- VERITAS Pachet de perfuzie avansată poate fi utilizat cu soluție de irigare într-un flacon sau o pungă după ce se finalizează cu succes operațiunea Amorsare/Reglare. Nu toate pungile pot finaliza cu succes operațiunea Amorsare, ceea ce poate duce la întârzierea tratamentului.

Avertisment:

Exclusiv de unică folosință. Nu resterilizați, reprelucrați sau reutilizați acest dispozitiv.

Dispozitivele medicale de unică folosință de la Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. sunt etichetate cu instrucțiuni de utilizare și de manipulare, pentru a reduce la minimum expunerea la condiții care pot afecta produsul, pacientul ori utilizatorul. Resterilizarea/reprelucrarea dispozitivelor medicale de unică folosință de la Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. poate duce la deteriorarea fizică a dispozitivului medical, la nefuncționarea dispozitivului medical conform indicațiilor, precum și la îmbolnăvirea sau vătămarea pacientului din cauza unei infecții, a unei inflamații și/sau unei afecțiuni cauzate de contaminarea produsului, de transmiterea de infecții, precum și de lipsa de sterilitate a produsului.

Eliminarea:

Orice pachet VERITAS care a fost contaminat cu sânge, țesut și/sau fluide/materii corporale trebuie să fie manipulat ca deșeu medical cu pericol biologic, în conformitate cu protocolul unității sanitare și cu cerințele locale aplicabile.

Dacă pachetul VERITAS este recepționat într-o stare nesatisfăcătoare, contactați imediat reprezentanța locală de vânzări Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Fiecare pachet VERITAS este identificat cu un număr de lot pe etichetele de pe ambalajul produsului și trebuie să îl menționați în orice corespondență sau discuții.

Telefon pentru SUA: TelVerde 1-877-266-4543.

Raportarea incidentelor grave:

Contactați reprezentantul local pentru a raporta toate reclamațiile sau evenimentele adverse legate de produs către Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Dacă produsul este primit în stare nesatisfăcătoare, contactați imediat biroul local de vânzări al Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Fiecare componentă este identificată cu un număr de lot pe care trebuie să îl menționați în orice corespondență sau discuții. Telefon pentru SUA: TelVerde 1-877-266-4543.

Raportarea incidentelor grave (UE):

Pentru pacienții/utilizatorii/terții din Uniunea Europeană și din țările cu regim de reglementare identic; dacă, în timpul utilizării sau ca urmare a utilizării acestui dispozitiv, a avut loc un incident grav, vă rugăm să îl raportați companiei Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. și/sau reprezentantului său autorizat și autorității competente din statul membru în care utilizatorul și/sau pacientul este stabilit.

Simbol/titlu (explicație):

SIMBOL	TITLU (EXPLICAȚIE)
	Consultați instrucțiunile de utilizare sau consultați instrucțiunile de utilizare în format electronic
	A nu se reutiliza
STERILE EO	Sterilizat cu oxid de etilenă
REF	Număr de catalog
LOT	Număr de serie
	Data de expirare
	Producător
EC REP	Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană/ Uniunea Europeană
	A nu se resteriliza
	Importator
UDI	Identificator unic al dispozitivului
CH REP	Reprezentant autorizat în Elveția
	Data fabricației
	A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat. Consultați instrucțiunile de utilizare
EC	Comunitatea Europeană/Uniunea Europeană
CH	Elveția
	Unitate de ambalare
	Atenție
	Sistem de barieră sterilă unică
Rx only	Atenție: conform legislației federale, vânzarea acestui dispozitiv poate fi efectuată numai de către un medic autorizat sau la recomandarea acestuia.
	Deschideți aici
MD	Dispozitiv medical
	Fragil, a se manipula cu atenție
	Mențineți uscat
	Cu această parte în sus

Atenție: Legislația federală (SUA) vânzarea acestui dispozitiv poate fi efectuată numai de către un medic sau la recomandarea acestuia.

Produs în Mexic

Acest document este valid numai la data la care a fost imprimat. Dacă nu sunteți sigur de data imprimării, imprimați documentul din nou pentru a vă asigura că utilizați cea mai recentă ediție a instrucțiunilor de utilizare (disponibilă la adresa www.e-ifu.com). Este responsabilitatea utilizatorului să asigure utilizarea celor mai recente instrucțiuni de utilizare.

Johnson & Johnson VISION

℞ only

Giriş/Açıklama:
VERITAS Gelişmiş İnfüzyon Paketi veya VERITAS Gelişmiş Flüidik Paketi, irigasyon ve aspirasyon prosedürü veya fakoemülsifikasyon prosedürü gerçekleştirmek için gerekli tüm hortum ve aksesuarları sağlayan ÇİFT POMPA Paketidir. VERITAS Gelişmiş İnfüzyon Paketi, irigasyon solüsyonu kaynağına basınçlı hava sağlamak için ek bir hortum hattı içerir. Her Paket aşağıdaki parçalardan oluşur:

1. Kaset ve Hortum Düzeneği
2. Monitör Örtüsü
3. Mayo Standı Örtüsü
4. Test Odacığı

Kullanım Amacı:
VERITAS Gelişmiş İnfüzyon Paketi veya VERITAS Gelişmiş Flüidik Paketi, Kaset ve Hortum Düzeneğini içerir ve ön segment katarakt ameliyatı sırasında irigasyon ve aspirasyon gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. VERITAS™ Vision Sistemi ile birlikte kullanılır. Test Odacığı, cerrahi prosedürden önce irigasyon/aspirasyon işlevinin doğru bağlanabilirliğini ve işlevselliğini doğrulamak için tasarlanmıştır.

Ürün Çizimleri:

VERITAS Gelişmiş Flüidik Paketi

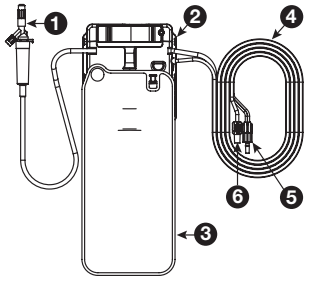

1. İrigasyon Sivri Ucu (İrigasyon Kaynağına)
2. Kaset
3. Drenaj Torbası
4. I/A Hortum Seti (El Cihazına)
5. İrigasyon Luer Kilidi Bağlantı Parçası
6. Aspirasyon Bağlantı Parçası

VERITAS Gelişmiş İnfüzyon Paketi



Yalnızca VERITAS Gelişmiş İnfüzyon Paketi:
7. İnfüzyon Hattı
8. İnfüzyon Konektörü (Konsola)

Endikasyonlar/Kontrendikasyonlar/Hedef Hastalar/Hedef Kullanıcılar:
Endikasyonlar/Kontrendikasyonlar/Hedef Hastalar/Hedef Kullanıcılar ile ilgili bilgiler, Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Fakoemülsifikasyon Sistemi Kullanıcı Kılavuzunda ("Kullanıcı Kılavuzu") açıklanmaktadır. Kontrendikasyonlar: Sağlık uzmanının katarakt ameliyatına bir kontrendikasyon olduğunu belirlediği, hastanın önceden mevcut rahatsızlıkları. Hedef hastalar, kataraktlı yetişkin hastaları veya ön segmentte oftalmik ameliyat (ör. kristalin lensin çıkarılması) yapılmakta olan yetişkin hastaları içermektedir. Not: Hamile, emziren kadınlar veya çocuklar, yürütülen klinik çalışmalara dahil edilmemiştir. Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Fakoemülsifikasyon Sistemi, göz hekimleri tarafından ve cerrahın yönergeleriyle ameliyat gerçekleştiren destek personeli tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Klinik Faydalar/İstenmeyen Yan Etkiler/Advers Etkiler:
Klinik Faydalar/İstenmeyen Yan Etkiler/Advers Etkiler ile ilgili tüm bilgiler Kullanıcı Kılavuzunda açıklanmaktadır. Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Fakoemülsifikasyon Sisteminin klinik faydaları aşağıdakileri içerir: Hızlı görsel rehabilitasyon, Günlük aktivitelerin erkenden yeniden başlaması, Minimum oküler enflamasyon, Minimum postoperatif astigmatizm, Oküler komplikasyon olasılığında azalma. Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Fakoemülsifikasyon Sistemiyle ilişkili olabilecek komplikasyonlar arasında kırık kapsül, korneal yanma, enfeksiyon/inflamasyon ve korneal ödem yer almaktadır.

Kullanım Talimatları:
VERITAS Paketinin uygun şekilde montajı için aşağıdaki talimatlara başvurun. VERITAS Gelişmiş İnfüzyon Paketi için aşağıda belirtildiği gibi bir ekstra adım vardır. VERITAS Gelişmiş İnfüzyon Paketini kullanmak için ameliyattan önce Program Ayarlarında Gelişmiş İnfüzyon seçilmelidir. Ek talimatlar için lütfen Kullanıcı Kılavuzuna başvurun. Kullanmadan önce ürün tepsisinde ambalaj bütünlüğünün bozulup bozulmadığını görsel olarak inceleyin. Ambalaj bütünlüğü bozulmuşsa ürünü kullanmayın.

1. Kapakla kapatılmış ürün tepsisindeki tüm içeriğin steril olarak çıkarılmasından sonra I/A HORTUM SETİNİ steril alanda tutarken KASETİ ve İRİGASYON DELME UCUNU Sirkülatöre (Hemşire) teslim edin.
2. Monitör Örtüsünü, VERITAS Vision Sistemi üzerindeki monitörün üzerine yerleştirin.
3. Örtüdeki kılavuz işaretlerine göre ellerinizi Mayo Standı Örtüsüne yerleştirin ve VERITAS Vision Sistemi tepsi kolunu örtün.
4. KASETİ, VERITAS Vision Sisteminin flüidik paneline yerleştirin.
5. KASETİ tutmak için sistem mandal mekanizmasını etkinleştirene kadar KASETİ itin.
6. İrigasyon solüsyonu kaynağını hazırlayın.
7. Koruyucuyu İRİGASYON DELME UCUNDAN çıkarın.
8. Kaynak dik konumdayken İRİGASYON DELME UCUNU bükmeden doğrudan kauçuk kaynak tıpasının ortasına yerleştirin.
9. Kaynağı I/V direğine asın ve ardından 1/2 ila 3/4 dolana kadar damlama haznesini sıkın ve bırakın.
10. Sadece VERITAS Gelişmiş İnfüzyon Paketi için: İNFÜZYON HATTININ serbest ucunda siyah bir İNFÜZYON KONEKTÖRÜ vardır. İNFÜZYON KONEKTÖRÜNÜ VERITAS Vision Sisteminin yan paneline takın ve tam olarak oturduğunu gösteren klik sesi duyana kadar saat yönünde çevirin.
11. Kilitlenen irigasyon portu olmayan el cihazlarında İRİGASYON LUER KİLİDİ BAĞLANTI PARÇASINDAKİ bileziği geri çekin. I/A HORTUM SETİNİN luer bağlantı parçalarını el cihazına bağlayın. Kilitlenen irigasyon portu bulunan el cihazlarında bağlantı parçasını el cihazına kilitlemek için İRİGASYON LUER KİLİDİ BAĞLANTI PARÇASINDA bulunan bileziği saat yönünde çevirin.
12. Uç ve irigasyon kovanını montaj talimatlarına göre el cihazına takın.
13. VERITAS Vision Sistemindeki HAZIRLAMA/İNCE AYAR ekranından, el cihazının ucu irigasyon kovanına karşı kapatılmamış bir test odacığı içinde aşağıya bakacak şekilde Kesintisiz İrigasyonu etkinleştirin.
14. Test odacığını sıvıyla doldurarak tüm havayı çıkarın ve test odacığını sızdırmaz hale gelene kadar uç ve irigasyon kovanı üzerine düz bir şekilde yerleştirin ve ortalayın.
15. Kesintisiz İrigasyonu devre dışı bırakın ve Kullanıcı Kılavuzuna göre hazırlama işlemi gerçekleştirin.

Genel:
Cihaz Ftalat içermez.

Paket etilen oksit kullanılarak sterilize edilmiştir ve tek kullanım için tasarlanmıştır.

Ürünü serin ve kuru bir yerde saklayın.

Önlemler:

- Ürünü, ürünün ambalaj etiketleri üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayın.
- Ürün tepsisi kapakla kapalı ve hasarsız olduğunda içerik steril kalır.
- Kullanım sırasında ürün performansı bozulursa kullanmayı bırakın ve Sistemin Kullanıcı Kılavuzunda ayrıntılı olarak açıklanan uygun testleri yapın. Sonuçlar tatmin edici değilse Paketi Kullanıcı Kılavuzunda yer alan talimatlara göre değiştirin.
- VERITAS Gelişmiş İnfüzyon Paketini kullanırken Gelişmiş İnfüzyon etkinleştirildiğinde irigasyon kaynağının etkin toplam yüksekliği 30 cm'den düşük olamaz.
- VERITAS Gelişmiş İnfüzyon Paketi, başarılı bir Hazırlama/İnce Ayar tamamlandıktan sonra şişe veya torbada irigasyon solüsyonuyla kullanılabilir. Tüm torbalar için Hazırlama işlemi başarıyla tamamlanmayabilir ve bu tedavinin gecikmesine neden olabilir.

Bu belge yalnızca basıldığı tarihte geçerlidir. Basıldığı tarihten emin değilseniz Kullanım Talimatlarının en son sürümünü (www.e-ifu.com adresinde mevcuttur) kullandığınızdan emin olmak için lütfen yeniden basın. En güncel Kullanım Talimatlarının kullanıldığından emin olmak kullanıcının sorumluluğundadır.

Johnson & Johnson VISION

Uyarı:
Yalnızca tek kullanımlıktır. Bu cihazı yeniden sterilize etmeyin, yeniden işlemeyin veya yeniden kullanmayın.

Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. tek kullanımlık tıbbi cihazlarının etiketinde, ürüne, hastaya veya kullanıcıya zarar verebilecek durumlara maruziyeti en aza indirmeye yönelik kullanım ve tutma talimatları bulunur. Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. tek kullanımlık tıbbi cihazlarının tekrar kullanılması/tekrar sterilize edilmesi/tekrar işlemden geçirilmesi; tıbbi cihazda fiziksel hasara, tıbbi cihazın amacı doğrultusunda işlev görmemesine ve ürün kontaminasyonu, enfeksiyon bulaşması ve ürün sterilitesinin yitirilmesi dolayısıyla oluşan enfeksiyon, enflamasyon ve/veya hastalık nedeniyle hastanın zarar görmesine veya yaralanmasına yol açabilir.

İmha:
Kan, doku ve/veya vücut sıvılarıyla/maddeleriyle kontamine olmuş herhangi bir VERITAS Paketi, sağlık hizmeti tesisi protokolüne ve geçerli yerel gerekliliklere uygun şekilde biyolojik açıdan tehlikeli tıbbi atık olarak işlem görmelidir.

VERITAS Paketinin uygun olmayan koşullarda teslim alınması durumunda lütfen hemen yerel Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Satış Ofisiniz ile irtibat kurun. Her VERITAS Paketinin ürün ambalajı etiketinde bir parti numarası bulunur ve bu numara her türlü yazışma veya konuşmada belirtilmelidir.

ABD'de telefon: ücretsiz 1-877-266-4543.

Ciddi Olay Raporlama:
Tüm ürün şikayetlerini ve/veya advers olayları Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.a bildirmek için yerel temsilcinizle iletişime geçin. Ürün tatmin edici olmayan bir durumda alındıysa lütfen hemen yerel Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Satış Ofisiyle iletişime geçin. Her bileşen bir parti numarasına sahiptir ve bu numara her türlü yazışma veya konuşmada belirtilmelidir. ABD'de telefon: ücretsiz 1-877-266-4543.

Ciddi Olay Bildirimi (AB):
Avrupa Birliği ve benzer düzenleyici yönetime sahip ülkelerde bulunan hastalar/kullanıcılar/üçüncü taraflarda, bu cihazın kullanımı sırasında veya kullanımının bir sonucu olarak ciddi bir olayın meydana gelmesi halinde, lütfen bu olayı Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. ve/veya yetkili temsilcilerine ve kullanıcının ve/veya hastanın bulunduğu Üye Devletin yetkili makamına bildirin.

Sembol/Başlık (Açıklama):

SEMBOL	BAŞLIK (AÇIKLAMA)
	Kullanım talimatlarına veya elektronik kullanım talimatlarına bakın
	Yeniden kullanmayın
	Etilen oksit kullanılarak sterilize edilmiştir
	Katalog numarası
	Seri kodu
	Son kullanma tarihi
	Üretici
	Avrupa Topluluğu/Avrupa Birliği'ndeki yetkili temsilci
	Tekrar sterilize etmeyin
	İthalatçı
	Benzersiz cihaz tanımlayıcı
	İsviçre'deki yetkili temsilci

SEMBOL	BAŞLIK (AÇIKLAMA)
	Üretim tarihi
	Ambalaj hasar görmüşse kullanmayın ve kullanım talimatlarına bakın
	Avrupa Topluluğu/Avrupa Birliği
	İsviçre
	Ambalaj birimi
	Dikkat
	Tek steril bariyerli sistem
	Dikkat: Federal kanunlara göre, bu cihaz yalnızca lisanslı bir doktor tarafından veya talimatıyla satılabilir.
	Buradan açın
	Tıbbi cihaz
	Kırılabilir, dikkatli kullanın
	Kuru halde saklayın
	Bu taraf yukarı bakacaktır

Dikkat: Federal (ABD) Yasaları uyarınca bu cihazın satışı yalnızca bir hekim tarafından veya bir hekimin siparişi üzerine yapılabilmektedir.

Meksika Malıdır

Bu belge yalnızca basıldığı tarihte geçerlidir. Basıldığı tarihten emin değilseniz Kullanım Talimatlarının en son sürümünü (www.e-ifu.com adresinde mevcuttur) kullandığınızdan emin olmak için lütfen yeniden basın. En güncel Kullanım Talimatlarının kullanıldığından emin olmak kullanıcının sorumluluğundadır.

Johnson & Johnson VISION

℞ only

Uvod/opis:
Pakiranje za naprednu infuziju VERITAS ili pakiranje za napredno upravljanje tekućinama VERITAS je komplet DVOSTRUKE PUMPE koji sadrži sve cjevčice i dodatnu opremu potrebnu za izvođenje postupka ispiranja i aspiracije ili postupka fakoemulzifikacije. Pakiranje za naprednu infuziju VERITAS sadrži dodatnu cijev za dovod komprimiranog zraka u izvor irigacijske otopine. Svako pakiranje sastoji se od sljedećih stavki:

1. Sklop kasete i cijevi
2. Pokrivka za monitor
3. Pokrivka za Mayo stolić
4. Ispitna komora

Namjena:
Pakiranje za naprednu infuziju VERITAS ili pakiranje za napredno upravljanje tekućinama VERITAS sadrži sklop kasete i cijevi i namijenjen je za izvođenje irigacije i aspiracije tijekom kirurškog zahvata na prednjem segmentu, sivoj mreni. Upotrebljava se sa sustavom VERITAS™ Vision. Ispitna komora namijenjena je za potvrdu odgovarajuće povezivosti i funkcionalnosti irigacije/aspiracije prije kirurškog zahvata.

Crteži proizvoda:

Pakiranje za napredno upravljanje tekućinama VERITAS

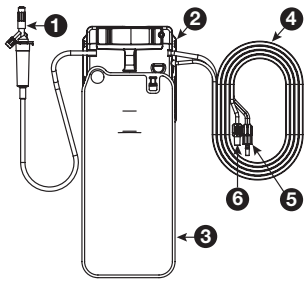

1. Šiljak za ispiranje (na izvor ispiranja)
2. Kaseta
3. Drenažna vrećica
4. I/A komplet cijevi (na sondu)
5. Luer Lock priključak za ispiranje
6. Priključak za aspiraciju

Pakiranje za naprednu infuziju VERITAS



Samo pakiranje za napredno upravljanje tekućinama VERITAS:
7. Infuzijski vod
8. Infuzijski priključak (na konzolu)

Indikacije / kontraindikacije / predviđeni pacijent / predviđeni korisnik:
Sve relevantne informacije za indikacije / kontraindikacije / predviđenog pacijenta / predviđenog korisnika opisane su u priručniku za korisnike sustava za fakoemulzifikaciju tvrtke Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. („Priručniku za korisnike"). Kontraindikacije: postojeća stanja pacijenta za koja zdravstveni djelatnik utvrdi da su kontraindicirana za operaciju mrene. Predviđeni pacijenti obuhvaćaju odrasle pacijente s mrenom ili odrasle pacijente koji se podvrgavaju oftalmološkom kirurškom zahvatu prednjeg segmenta (npr. uklanjanju kristalne leće). Napomena: u provedena klinička ispitivanja nisu bile uključene trudnice, dojilje ni djeca. Sustav za fakoemulzifikaciju tvrtke Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. namijenjen je za upotrebu oftalmolozima i pomoćnom osoblju pod vodstvom kirurga.

Kliničke prednosti / neželjene nuspojave / štetne nuspojave:
Sve relevantne informacije o kliničkim prednostima / neželjenim nuspojavama / štetnim nuspojavama navedene su u priručniku za korisnike. Kliničke prednosti sustava za fakoemulzifikaciju tvrtke Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. obuhvaćaju sljedeće: brzu rehabilitaciju vida, rano nastavljanje sa svakodnevnim aktivnostima, minimalnu upalu očiju, minimalni postoperativni astigmatizam, smanjenu vjerojatnost očnih komplikacija. Komplikacije koje se mogu povezati sa sustavom za fakoemulzifikaciju tvrtke Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. obuhvaćaju oštećenu kapsulu, opekline rožnice, infekciju/upalu i edem rožnice.

Upute za uporabu:
Pogledajte u sljedećim uputama kako da pravilno instalirate pakiranje VERITAS. Pakiranje za naprednu infuziju VERITAS ima jedan dodatni korak kao što je navedeno u nastavku. Kako biste mogli upotrijebiti pakiranje za naprednu infuziju VERITAS, prije kirurškog zahvata u programskim postavkama mora se odabrati napredna infuzija. Dodatne upute potražite u priručniku za korisnike. Prije uporabe vizualno pregledajte ima li na ambalaži plitice proizvoda oštećenja. Ne upotrebljavajte proizvod ako je ambalaža oštećena.

1. Nakon sterilnog uklanjanja cijelog sadržaja iz plitice proizvoda hermetički zatvorene poklopcem dodajte KASETU i ŠILJAK ZA ISPIRANJE instrumentarki (sestri) dok istovremeno zadržavate I/A KOMPLET CJEVČICA u sterilnom polju.
2. Postavite sterilnu zaštitu za zaslon na sustav VERITAS Vision.
3. Postavite ruke na pokrivku za Mayo stolić u skladu s oznakama na pokrivki i prekrijte ruku plitice sustava VERITAS Vision.
4. Umetnite KASETU u panel za tekućine sustava VERITAS Vision.
5. Gurnite KASETU sve dok sustav ne aktivira mehanizam zasuna kako bi se zadržala KASETA.
6. Pripremite izvor irigacijske tekućine.
7. Izvadite štitnik iz vrha ŠILJKA ZA ISPIRANJE.
8. Držeći izvor u uspravnom položaju, uvucite ŠILJAK ZA ISPIRANJE ravno u centar gumenog graničnika izvora bez okretanja.
9. Okačite izvor na nosač za intravensku terapiju, a zatim stišćite i otpuštajte komoru za kapanje dok ne bude 1/2 do 3/4 puna.
10. Samo za pakiranje za napredno upravljanje tekućinama VERITAS: INFUZIJSKI VOD ima crni INFUZIJSKI PRIKLJUČAK na slobodnom kraju. Umetnite INFUZIJSKI PRIKLJUČAK u bočnu ploču sustava VERITAS Vision, a zatim ga okrenite nadesno dok uz škljocaj potpuno ne sjedne na mjesto.
11. Za sonde bez priključka za ispiranje sa zaključavanjem izvucite ovojnicu na LUER LOCK PRIKLJUČKU ZA ISPIRANJE. Pričvrstite luer priključke I/A KOMPLETA CJEVČICA na sondu. Za sonde s priključkom za ispiranje sa zaključavanjem okrenite ovojnicu na LUER LOCK PRIKLJUČKU ZA ISPIRANJE udesno kako biste zaključali priključak na sondu.
12. Pričvrstite vrh i cjevčice za irigaciju na sondu prema uputama za sastavljanje.
13. Na zaslonu PRIPREMA/UGAĐANJE na sustavu VERITAS Vision aktivirajte neprekidnu irigaciju s vrhom sonde okrenutim prema dolje u ispitnoj komori koja nije zabrtvljena u odnosu na cjevčicu za irigaciju.
14. Ispunite ispitnu komoru tekućinom istiskujući sav zrak i umećući ispitnu komoru ravno u sredinu iznad vrha i cjevčice za irigaciju dok se ne zabrtvi.
15. Deaktivirajte neprekidnu irigaciju i izvedite redoslijed pokretanja u skladu s priručnikom za korisnike.

Općenito:
Proizvod ne sadrži ftalate.

Pakiranje je sterilizirano etilen-oksidom i osmišljeno za jednokratnu uporabu.

Proizvod čuvajte na hladnom i suhom mjestu.

Mjere predostrožnosti:

- Ne upotrebljavajte proizvod nakon isteka roka valjanosti na naljepnicama na pakiranju proizvoda.
- Sadržaj je sterilan ako je plitica proizvoda hermetički zatvorena poklopcem i neoštećena.
- Ako se učinak proizvoda pogorša tijekom uporabe, prekinite uporabu i izvedite odgovarajuća ispitivanja kao što je opisano u priručniku za korisnika. Ako rezultati ne budu zadovoljavajući, zamijenite pakiranje prema uputama navedenim u priručniku za korisnika.
- Prilikom upotrebe pakiranja za napredno upravljanje tekućinama VERITAS efektivna ukupna visina izvora irigacije ne može ići ispod 30 cm kada je aktivirana napredna infuzija.

Ovaj je dokument važeći samo na datum ispisa. Ako niste sigurni u datum ispisa, ponovo ispišite da biste osigurali uporabu najnovije revizije uputa za uporabu (dostupno na www.e-ifu.com). Korisnik snosi odgovornost osiguravanja uporabe posljednje inačice uputa za uporabu.

Johnson & Johnson VISION

- Pakiranje za napredno upravljanje tekućinama VERITAS može se upotrebljavati s irigacijskom otopinom u boci ili vrećici nakon uspješnog dovršetka pripreme/ugađanja. Možda neće sve vrećice uspješno dovršiti pripremu, što može dovesti do odgode liječenja.

Upozorenje:
Isključivo za jednokratnu uporabu. Nemojte ponovno sterilizirati, ponovno obrađivati ni ponovno upotrebljavati ovaj proizvod.

Medicinski proizvodi za jednokratnu upotrebu tvrtke Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. označeni su uputama za upotrebu i rukovanje da bi se izbjeglo izlaganje uvjetima koji bi mogli ugroziti proizvod, pacijenta ili korisnika. Ponovna sterilizacija ili ponovna obrada medicinskih proizvoda za jednokratnu upotrebu tvrtke Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. može uzrokovati fizička oštećenja ili nepravilno funkcioniranje medicinskog proizvoda, kao i oboljenja ili ozljede pacijenta uzrokovane infekcijom i upalom i/ili oboljenja uzrokovana onečišćenjem proizvoda, prijenosom infekcije i nesterilnošću proizvoda.

Odlaganje u otpad:
Pakiranjem VERITAS kontaminiranim krvlju, tkivom i/ili tjelesnim tekućinama/tvarima potrebno je rukovati kao biološki opasnim medicinskim otpadom u skladu s protokolom zdravstvene ustanove i primjenjivim lokalnim zahtjevima.

Ako pakiranje VERITAS dobijete u nezadovoljavajućem stanju, odmah se obratite lokalnom prodajnom predstavniku tvrtke Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Svako pakiranje VERITAS ima broj serije na naljepnicama na ambalaži koji trebate navesti u svakoj prepisci ili razgovorima.

U SAD-u: besplatan poziv na 1-877-266-4543.

Prijavljivanje ozbiljnih incidenata:
Obratite se lokalnom predstavniku kako biste prijavili sve prigovore i/ili nuspojave tvrtki Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Ako ste proizvod primili u nezadovoljavajućem stanju, obratite se lokalnom uredu tvrtke Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Svaki dio ima broj serije koji trebate navesti u svim korespondencijama ili razgovorima. Telefonski broj u SAD-u: besplatan poziv na 1-877-266-4543.

Prijavljivanje ozbiljnog štetnog događaja (EU):
Za pacijenta / korisnika / treću stranu u Europskoj uniji i zemljama s identičnim regulatornim režimom: ako je tijekom upotrebe ovog proizvoda ili kao rezultat njegove upotrebe došlo do ozbiljnog incidenta, prijavite ga tvrtki Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. i/ili njezinu ovlaštenom predstavniku te mjerodavnom tijelu države članice u kojoj korisnik i/ili pacijent boravi.

Simbol/naslov (objašnjenje):

SIMBOL	NASLOV (OBJAŠNJENJE)
	Pogledajte upute za uporabu ili elektroničke upute za uporabu
	Nije za višekratnu upotrebu
	Sterilizirano etilen-oksidom
	Kataloški broj
	Šifra serije
	Upotrijebiti do datuma
	Proizvođač
	Ovlašteni predstavnik za Europsku zajednicu / Europsku uniju
	Nije za ponovnu sterilizaciju
	Uvoznik
	Jedinstveni identifikacijski broj uređaja

SIMBOL	NASLOV (OBJAŠNJENJE)
	Ovlašteni predstavnik za Švicarsku
	Datum proizvodnje
	Nemojte upotrebljavati ako je pakiranje oštećeno i pogledajte upute za uporabu
	Europska zajednica / Europska unija
	Švicarska
	Jedinica ambalaže
	Oprez
	Označava sustav s jednom sterilnom barijerom
	Oprez: prema saveznom zakonu ovaj proizvod smije prodavati samo ovlašteni zdravstveni djelatnik ili se smije prodavati samo na njegov nalog.
	Ovdje otvoriti
	Medicinski proizvod
	Lomljivo, pažljivo rukovati
	Držite suho
	Ova strana treba biti okrenuta prema gore

Oprez: savezni zakon (SAD-a) ograničava prodaju ovog uređaja na liječnika ili prema njegovom nalogu.

Proizvedeno u Meksiku

Ovaj je dokument važeći samo na datum ispisa. Ako niste sigurni u datum ispisa, ponovo ispišite da biste osigurali uporabu najnovije revizije uputa za uporabu (dostupno na www.e-ifu.com). Korisnik snosi odgovornost osiguravanja uporabe posljednje inačice uputa za uporabu.

℞ only

Εισαγωγή/Περιγραφή:

Το Προηγμένο πακέτο έγχυσης VERITAS ή το Προηγμένο πακέτο διαχείρισης υγρών VERITAS αποτελεί ένα πακέτο ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ που παρέχει όλες τις σωληνώσεις και τα παρελκόμενα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση μιας διαδικασίας καταιονισμού και αναρρόφησης ή μιας διαδικασίας φακοθρυψίας. Το Προηγμένο πακέτο έγχυσης VERITAS περιλαμβάνει μια επιπλέον γραμμή σωλήνωσης που παρέχει αέρα υπό πίεση στην πηγή του διαλύματος καταιονισμού. Κάθε πακέτο αποτελείται από τα ακόλουθα είδη:

1. Διάταξη κασέτας και σωλήνωσης
2. Κάλυμμα μόνιτορ
3. Κάλυμμα βάσης Mayo
4. Θάλαμος εξέτασης

Σκοπός για τον οποίο προορίζεται:

Το Προηγμένο πακέτο έγχυσης VERITAS ή το Προηγμένο πακέτο διαχείρισης υγρών VERITAS περιέχει τη Διάταξη κασέτας και σωλήνωσης και προορίζεται για τη διεξαγωγή καταιονισμού και αναρρόφησης κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης καταρράκτη πρόσθιου τμήματος. Χρησιμοποιείται με το Σύστημα VERITAS™ Vision. Ο Θάλαμος εξέτασης προορίζεται για την επαλήθευση της σωστής συνδεσιμότητας και λειτουργικότητας της λειτουργίας καταιονισμού/αναρρόφησης πριν από τη χειρουργική επέμβαση.

Σχεδιαγράμματα του προϊόντος:

Προηγμένο πακέτο διαχείρισης υγρών VERITAS

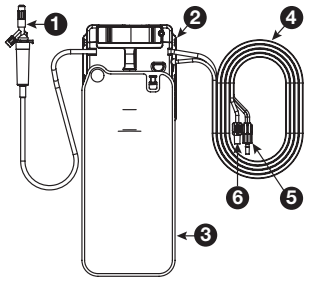

Προηγμένο πακέτο έγχυσης VERITAS

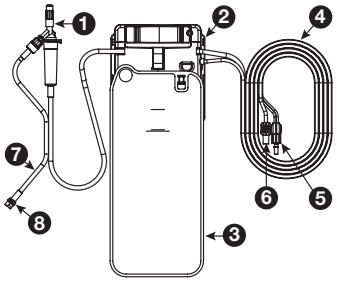

1. Ακίδα καταιονισμού (Προς πηγή καταιονισμού)
2. Κασέτα
3. Ασκός παροχέτευσης
4. Σετ σωλήνωσης Καταιονισμού και Αναρρόφησης (προς όργανο χειρός)
5. Εξάρτημα luer lock καταιονισμού
6. Εξάρτημα αναρρόφησης

Μόνο για το Προηγμένο πακέτο έγχυσης VERITAS:

7. Γραμμή έγχυσης
8. Σύνδεσμος έγχυσης (προς κονσόλα)

Ενδείξεις/Αντενδείξεις/Προβλεπόμενοι ασθενείς/Προβλεπόμενος χρήστης:

Όλες οι σχετικές πληροφορίες για τις Ενδείξεις/Αντενδείξεις/Προβλεπόμενους ασθενείς/Προβλεπόμενο χρήστη περιγράφονται στο Εγχειρίδιο χειριστή του Συστήματος φακοθρυψίας Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. («Εγχειρίδιο χειριστή»). Αντενδείξεις: Τυχόν προϋπάρχουσες καταστάσεις ασθενούς οι οποίες αποτελούν αντένδειξη σε χειρουργική επέμβαση καταρράκτη σύμφωνα με τον επαγγελματία υγείας. Στους προβλεπόμενους ασθενείς περιλαμβάνονται ενήλικοι ασθενείς με καταρράκτη ή ενήλικοι ασθενείς που θα υποβληθούν σε οφθαλμολογική χειρουργική επέμβαση στο πρόσθιο τμήμα του οφθαλμού (δηλαδή αφαίρεση του κρυσταλλοειδούς φακού). Σημείωση: Στην/Στις κλινική(ές) δοκιμή(ές) που διενεργήθηκε(αν), δεν έλαβαν μέρος έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες και παιδιά. Το Σύστημα φακοθρυψίας της Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. προορίζεται για χρήση από οφθαλμίατρο και υποστηρικτικό προσωπικό υπό την καθοδήγηση χειρουργού.

Κλινικά οφέλη/Ανεπιθύμητες ενέργειες/Ανεπιθύμητα συμβάντα:

Όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα Κλινικά οφέλη/Ανεπιθύμητες ενέργειες/Ανεπιθύμητα συμβάντα περιγράφονται στο Εγχειρίδιο χειριστή. Στα κλινικά οφέλη του Συστήματος φακοθρυψίας Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. περιλαμβάνονται τα εξής: Ταχεία οπτική αποκατάσταση, έγκαιρη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες, ελάχιστη οφθαλμική φλεγμονή, ελάχιστος μετεγχειρητικός αστιγματισμός, μειωμένες πιθανότητες οφθαλμικών επιπλοκών. Οι επιπλοκές που ενδέχεται να σχετίζονται με το Σύστημα φακοθρυψίας της Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. περιλαμβάνουν θραύση περιφακίου, έγκαυμα κερατοειδούς, μόλυνση/φλεγμονή και οίδημα κερατοειδούς.

Οδηγίες χρήσης:

Παρακαλούμε ανατρέξτε στις ακόλουθες οδηγίες για τον σωστό τρόπο εγκατάστασης του Πακέτου VERITAS. Το Προηγμένο πακέτο έγχυσης VERITAS έχει ένα επιπλέον βήμα, όπως επισημαίνεται παρακάτω. Για να χρησιμοποιήσετε το Προηγμένο πακέτο έγχυσης VERITAS, πρέπει να επιλεχθεί Προηγμένη έγχυση στις Ρυθμίσεις προγράμματος πριν από τη χειρουργική επέμβαση. Για επιπλέον οδηγίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χειριστή. Πριν από τη χρήση, επιθεωρήστε οπτικά τον δίσκο του προϊόντος για παραβιάσεις της ακεραιότητας της συσκευασίας. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η ακεραιότητα της συσκευασίας έχει παραβιαστεί.

1. Μετά τη στείρα απομάκρυνση όλων των περιεχομένων από τον δίσκο προϊόντων που είναι σφραγισμένος με καπάκι, δώστε την ΚΑΣΕΤΑ και την ΑΚΙΔΑ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ στον/ην Υπεύθυνο/η κίνησης (Νοσηλευτή/τρια) ενώ το ΣΕΤ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ διατηρείται στο στείρο πεδίο.
2. Τοποθετήστε το Κάλυμμα μόνιτορ επάνω από το μόνιτορ στο Σύστημα VERITAS Vision.
3. Τοποθετήστε τα χέρια σας στο Κάλυμμα βάσης Mayo σύμφωνα με τις σημάνσεις καθοδήγησης στο κάλυμμα και καλύψτε τον βραχίονα δίσκου του Συστήματος VERITAS Vision.
4. Εισαγάγετε την ΚΑΣΕΤΑ στον πίνακα του συστήματος ροής του Συστήματος VERITAS Vision.
5. Ωθήστε την ΚΑΣΕΤΑ μέχρι το σύστημα να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό ασφάλισης ώστε να συγκρατήσει την ΚΑΣΕΤΑ.
6. Προετοιμάστε την πηγή του διαλύματος καταιονισμού.
7. Αφαιρέστε το προστατευτικό από το άκρο της ΑΚΙΔΑΣ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ.
8. Έχοντας την πηγή σε όρθια θέση, εισαγάγετε την ΑΚΙΔΑ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ στο κέντρο του ελαστικού πώματος πηγής χωρίς περιστροφή.
9. Αναρτήστε την πηγή στο στατό Ε/Φ ορού και στη συνέχεια σφίξτε και αφήστε τον θάλαμο στάλαξης έως ότου γεμίσει κατά το 1/2 έως τα 3/4.
10. Μόνο για το Προηγμένο πακέτο έγχυσης VERITAS: Η ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΧΥΣΗΣ διαθέτει μαύρο ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΓΧΥΣΗΣ στο ελεύθερο άκρο. Εισαγάγετε τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΓΧΥΣΗΣ στον πλευρικό πίνακα του συστήματος VERITAS Vision και, στη συνέχεια, περιστρέψτε τον δεξιόστροφα μέχρι να συνδεθεί πλήρως με ένα κλικ.
11. Για όργανα χειρός χωρίς ασφαλιζόμενη θύρα καταιονισμού, ανασύρετε το κολάρο στο ΕΞΑΡΤΗΜΑ LUER LOCK ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ. Συνδέστε τα εξαρτήματα luer του ΣΕΤ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ στο όργανο χειρός. Για όργανα χειρός εξοπλισμένα με ασφαλιζόμενη θύρα καταιονισμού, περιστρέψτε το κολάρο στο ΕΞΑΡΤΗΜΑ LUER LOCK ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ δεξιόστροφα για να ασφαλίσετε το εξάρτημα στο όργανο χειρός.
12. Προσαρτήστε το άκρο και το χιτώνιο καταιονισμού στο όργανο χειρός σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης.
13. Από την οθόνη ΠΛΗΡΩΣΗ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ στο σύστημα VERITAS Vision, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Συνεχής καταιονισμός με το άκρο του οργάνου χειρός να κοιτάζει προς τα κάτω στο εσωτερικό ενός θαλάμου ελέγχου που δεν είναι σφραγισμένος ως προς το χιτώνιο καταιονισμού.
14. Πληρώστε τον θάλαμο εξέτασης με υγρό που εξαλείφει τυχόν παρουσία αέρα και εισαγάγετε τον θάλαμο εξέτασης ευθεία και κεντραρισμένο επάνω από το άκρο και το χιτώνιο καταιωνισμού μέχρι να σφραγίσει.
15. Απενεργοποιήστε τον Συνεχή καταιονισμό και εκτελέστε ακολουθία πλήρωσης σύμφωνα με το Εγχειρίδιο χειριστή.

Γενικά:

Η συσκευή δεν περιέχει φθαλικές ενώσεις.

Το Πακέτο είναι αποστειρωμένο με χρήση οξειδίου του αιθυλενίου και είναι σχεδιασμένο για μία χρήση.

Φυλάσσετε το προϊόν σε δροσερό, ξηρό μέρος.

Προφυλάξεις:

- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στις ετικέτες συσκευασίας του προϊόντος.
- Τα περιεχόμενα είναι αποστειρωμένα όταν ο δίσκος είναι σφραγισμένος με καπάκι και δεν έχει υποστεί ζημιά.

Αυτό το έγγραφο περιέχει έγκυρες πληροφορίες οι οποίες ισχύουν κατά την ημερομηνία που εκτυπώθηκε. Εάν δεν είστε βέβαιοι για την ημερομηνία εκτύπωσης, επανεκτυπώστε το έγγραφο για να διασφαλίσετε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη αναθεώρηση των οδηγιών χρήσης (διατίθεται στη διεύθυνση www.e-ifu.com). Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιεί την πιο ενημερωμένη έκδοση των οδηγιών χρήσης.

Johnson&Johnson VISION

- Εάν διακυβευτεί η απόδοση του προϊόντος κατά τη διάρκεια της χρήσης, διακόψτε τη χρήση και εκτελέστε τις κατάλληλες εξετάσεις, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στο Εγχειρίδιο χειριστή του συστήματος. Εάν τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά, αντικαταστήστε το Πακέτο σύμφωνα με τις οδηγίες που ορίζονται στο Εγχειρίδιο χειριστή.
- Όταν χρησιμοποιείτε το Προηγμένο πακέτο έγχυσης VERITAS, το ενεργό συνολικό ύψος της πηγής καταιονισμού δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 30 cm όταν η Προηγμένη έγχυση είναι ενεργοποιημένη.
- Το Προηγμένο πακέτο έγχυσης VERITAS μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάλυμα καταιονισμού σε φιάλη ή ασκό μετά την ολοκλήρωση μιας επιτυχημένης διαδικασίας Πλήρωσης/Συντονισμού. Ενδέχεται να μην ολοκληρώσουν όλοι οι ασκοί την Πλήρωση, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε καθυστέρηση της θεραπείας.

Προειδοποίηση:

Για μία μόνο χρήση. Μην επαναποστειρώνετε, επανεπεξεργάζεστε ή επαναχρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή.

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα μίας χρήσης της Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. φέρουν ετικέτες οδηγιών χρήσης και χειρισμού, για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε συνθήκες που ενδέχεται να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις για το προϊόν, τον ασθενή ή τον χρήστη. Η επαναποστείρωση/επανεπεξεργασία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας χρήσης της Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. ενδέχεται να οδηγήσει σε υλική βλάβη του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, σε διακύβευση της προοριζόμενης απόδοσής του και σε ασθένεια ή τραυματισμό του ασθενούς λόγω λοίμωξης, φλεγμονής ή/και σε ασθένεια λόγω επιμόλυνσης του προϊόντος, μετάδοση λοίμωξης και απώλεια της στειρότητας του προϊόντος.

Απόρριψη:

Οποιοδήποτε Πακέτο VERITAS έχει μολυνθεί με αίμα, ιστό ή/και σωματικά υγρά/ύλη, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως βιολογικά επικίνδυνο ιατρικό απόβλητο σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος υγειονομικής περίθαλψης και τις ισχύουσες τοπικές απαιτήσεις.

Εάν το πακέτο VERITAS παραληφθεί σε μη ικανοποιητική κατάσταση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό σας γραφείο πωλήσεων της Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. αμέσως. Κάθε πακέτο VERITAS αναγνωρίζεται από έναν αριθμό παρτίδας στις ετικέτες της συσκευασίας του προϊόντος και αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε αλληλογραφία ή συνομιλίες.

Στις Η.Π.Α. καλέστε: χωρίς χρέωση 1-877-266-4543.

Αναφορά σοβαρών συμβάντων:

Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για αναφορά όλων των παραπόνων ή/και ανεπιθύμητων συμβάντων σχετικά με το προϊόν στην Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Εάν το προϊόν παραληφθεί σε μη ικανοποιητική κατάσταση, επικοινωνήστε αμέσως με το τοπικό γραφείο πωλήσεων της Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Κάθε εξάρτημα ταυτοποιείται από έναν αριθμό παρτίδας, ο οποίος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε οποιαδήποτε αλληλογραφία ή συνομιλία. Στις Η.Π.Α. καλέστε: χωρίς χρέωση 1-877-266-4543.

Αναφορά σοβαρών συμβάντων (ΕΕ):

Για ασθενή/χρήστη/τρίτα μέρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες με πανομοιότυπο ρυθμιστικό καθεστώς: εάν, κατά τη χρήση αυτής της συσκευής ή ως αποτέλεσμα της χρήσης της, λάβει χώρα κάποιο σοβαρό συμβάν, αναφέρετέ το στην Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. ή/και στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό της και στις αρχές του κράτους-μέλους όπου διαμένει ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Σύμβολο/Τίτλος (Επεξήγηση):

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΤΙΤΛΟΣ (ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ)
	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης ή τις ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης
	Μην επαναχρησιμοποιείτε
STERILE EO	Αποστειρώθηκε με χρήση αιθυλενοξειδίου
REF	Αριθμός καταλόγου
LOT	Κωδικός παρτίδας
	Ημερομηνία λήξης
	Κατασκευαστής
EC REP	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα/Ευρωπαϊκή Ένωση
	Μην επαναποστειρώνετε
	Εισαγωγέας
UDI	Αποκλειστικό αναγνωριστικό τεχνολογικού προϊόντος
CH REP	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ελβετία
	Ημερομηνία κατασκευής
	Να μην χρησιμοποιείται αν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά και συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
EC	Ευρωπαϊκή Κοινότητα/Ευρωπαϊκή Ένωση
CH	Ελβετία
	Μονάδα συσκευασίας
	Προσοχή
	Σύστημα μονού αποστειρωμένου φραγμού
Rx only	Προσοχή: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία επιτρέπει την πώληση της συσκευής αυτής μόνο από αδειοδοτημένο επαγγελματία υγείας ή κατόπιν εντολής αυτού.
	Ανοίξτε εδώ
MD	Ιατροτεχνολογικό προϊόν
	Εύθραυστο, να το χειρίζεστε με προσοχή
	Διατηρείτε στεγνό
	Αυτή η πλευρά προς τα επάνω

Προσοχή: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία (Η.Π.Α.) επιτρέπει την πώληση της συσκευής αυτής μόνο από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.

Προϊόν Μεξικού

Αυτό το έγγραφο περιέχει έγκυρες πληροφορίες οι οποίες ισχύουν κατά την ημερομηνία που εκτυπώθηκε. Εάν δεν είστε βέβαιοι για την ημερομηνία εκτύπωσης, επανεκτυπώστε το έγγραφο για να διασφαλίσετε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη αναθεώρηση των οδηγιών χρήσης (διατίθεται στη διεύθυνση www.e-ifu.com). Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιεί την πιο ενημερωμένη έκδοση των οδηγιών χρήσης.

Johnson & Johnson VISION

℞ only

Uvod/opis:
Napredni infuzioni komplet VERITAS ili Napredni komplet za fluidiku VERITAS predstavlja komplet DVOSTRUKE PUMPE koje sadrži sva creva i dodatni pribor koji su potrebi za obavljanje postupka irigacije i aspiracije ili postupka fakoemulzifikacije. Napredni infuzioni komplet VERITAS sadrži dodatnu cevčicu koja dovodi vazduh pod pritiskom do izvora rastvora za irigaciju. Svaki komplet sadrži sledeće delove:

1. Sklop kasete i cevi
2. Kompresa za prekrivanje monitora
3. Mayo kompresa za prekrivanje stalka
4. Test-komora

Predviđena namena:
Napredni infuzioni komplet VERITAS ili Napredni komplet za fluidiku VERITAS sadrži sklop kasete i cevi i namenjen je za obavljanje irigacije i aspiracije tokom operacije katarakte prednjeg segmenta. Koristi se sa sistemom VERITAS™ Vision. Test-komora je namenjena da potvrdi pravilnu povezanost i funkcionalnost funkcije irigacije/aspiracije pre hirurškog zahvata.

Crteži proizvoda:

Napredni komplet za fluidiku VERITAS

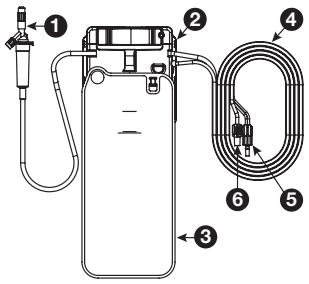

1. Šiljak za irigaciju (do izvora irigacije)
2. Kaseta
3. Kesa za drenažu

Napredni infuzioni komplet VERITAS



4. CREVA ZA IRIGACIJU I ASPIRACIJU (do ručnog instrumenta)
5. Luer Lock priključak za irigaciju
6. Priključak za aspiraciju

Samo Napredni infuzioni komplet VERITAS:
7. Infuziona linija
8. Priključak za infuziju (do konzole)

Indikacije/kontraindikacije/predviđeni pacijenti/predviđeni korisnik:
Sve relevantne informacije za indikacije/kontraindikacije/predviđene pacijente i predviđenog korisnika opisane su u priručniku za operatera sistema za fakoemulzifikaciju („Priručnik za operatera“) Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Kontraindikacije: Sva stanja prethodno prisutna kod pacijenta za koje zdravstveni radnik utvrdi da predstavljaju kontraindikaciju za operaciju katarakte. Predviđeni pacijenti su odrasli pacijenti sa kataraktom ili odrasli pacijenti koji se podvrgavaju očnoj operaciji u prednjem segmentu (npr. uklanjanje kristalnog sočiva). Napomena: Obavljena klinička ispitivanja nisu uključila trudnice, dojilje ni decu. Sistem za fakoemulzifikaciju kompanije Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. je predviđen da ga koriste oftalmolog i pomoćno osoblje koje radi pod neposrednim nadzorom hirurga.

Kliničke koristi/neželjena sporedna dejstva/štetna dejstva:
Sve relevantne informacije u pogledu kliničkih koristi/neželjenih sporednih dejstava/štetnih dejstava opisane su u priručniku za operatera. Kliničke koristi sistema za fakoemulzifikaciju Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. obuhvataju sledeće: brzu rehabilitaciju vida, rano uspostavljanje svakodnevnih aktivnosti, minimalno zapaljenje oka, minimalni postoperativni astigmatizam, smanjenu mogućnost nastanka okularnih komplikacija. Komplikacije koje se mogu dovesti u vezu sa sistemom za fakoemulzifikaciju kompanije Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. obuhvataju pucanje kapsule, opekotinu rožnjače, infekciju/zapaljenje i edem rožnjače.

Uputstvo za upotrebu:
Pridržavajte se sledećeg uputstva da biste pravilno postavili komplet za višekratnu upotrebu kompleta VERITAS. Napredni infuzioni komplet VERITAS ima jedan dodatan korak, kao što je opisano u nastavku. Da biste koristili Napredni infuzioni komplet VERITAS, pre operacije u postavkama programa mora da bude izabrana napredna infuzija. Dodatna uputstva potražite u priručniku za operatera. Pre upotrebe pregledajte posudu proizvoda u pogledu oštećenja celovitosti pakovanja. Nemojte koristiti proizvod ukoliko je ugrožena celovitost sterilnog pakovanja.

1. Nakon sterilnog uklanjanja svih sadržaja iz posude proizvoda zaptivene poklopcem, predajte KASETU i ŠILJAK ZA IRIGACIJU instrumentarki dok CREVO ZA IRIGACIJU I ASPIRACIJU držite u sterilnom polju.
2. Stavite tkaninu za pokrivanje monitora na sistem VERITAS Vision.
3. Stavite šake u Mayo tkaninu za prekrivanje stalka prema oznakama na tkanini i prekrijte krak posude sistema VERITAS Vision.
4. Umetnite KASETU u ploču za fluidiku na sistemu VERITAS Vision.
5. Gurajte KASETU dok sistem ne aktivira mehanizam reze za fiksiranje KASETE.
6. Pripremite izvor rastvora za irigaciju.
7. Uklonite štitnik sa vrha ŠILJKA ZA IRIGACIJU.
8. Dok je izvor u uspravnom položaju, umetnite ŠILJAK ZA IRIGACIJU u sredinu gumenog graničnika izvora bez uvrtanja.
9. Okačite izvor na stalak za infuziju i pritisnite i pustite drip komoru dok ne bude puna do 1/2 ili 3/4.
10. Samo za Napredni infuzioni komplet VERITAS: INFUZIONA LINIJA ima crni PRIKLJUČAK ZA INFUZIJU na slobodnom kraju. Umetnite PRIKLJUČAK ZA INFUZIJU u bočni panel sistema VERITAS Vision i okrećite ga u smeru kretanja kazaljke na satu sve dok ne škljocne kada nalegne.
11. Za ručne instrumente bez otvora za irigaciju sa zaključavanjem, povucite manžetnu na LUER LOCK PRIKLJUČKU ZA IRIGACIJU. Povežite luer priključke CREVA ZA IRIGACIJU I ASPIRACIJU na ručni instrument. Za ručne instrumente sa otvorom za irigaciju sa zaključavanjem, okrećite manžetnu na LUER LOCK PRIKLJUČKU ZA IRIGACIJU u smeru kretanja kazaljke na satu, kako biste priključak fiksirali na ručni instrument.
12. Pričvrstite vrh i navlaku za irigaciju na ručni instrument u skladu sa uputstvom za sklapanje.
13. Na ekranu PUNJENJE/PODEŠAVANJE na sistemu VERITAS Vision aktivirajte neprekidnu irigaciju sa vrhom ručnog instrumenta okrenutim nadole, unutar test-komore koja nije zaptivena u odnosu na navlaku za irigaciju.
14. Napunite test-komoru tečnošću uz eliminaciju svog vazduha i uvedite test-komoru pravolinijski i centrirano preko vrha i navlake za irigaciju do zaptivanja.
15. Deaktivirajte neprekidnu irigaciju i obavite niz za punjenje prema priručniku za operatera.

Opšte:
Medicinsko sredstvo ne sadrži ftalate.

Komplet je sterilisan etilen-oksidom i projektovan za jednokratnu upotrebu.

Proizvod čuvajte na hladnom i suvom mestu.

Mere opreza:
- Nemojte da koristite proizvod nakon isteka roka upotrebe navedenog na nalepnicama na pakovanju.
- Sadržaj je sterilan ukoliko je posuda sa proizvodom zatvorena poklopcem i neoštećena.
- Ukoliko se funkcionisanje proizvoda ugrozi tokom upotrebe, prekinite dalju upotrebu i obavite odgovarajuće testove prema uputstvima iz priručnika za operatera sistema. Ako rezultati ne budu zadovoljavajući, zamenite komplet prema uputstvima iz priručnika za operatera.
- Kada se koristi Napredni infuzioni komplet VERITAS, efektivna ukupna visina izvora irigacije ne sme da bude manja od 30 cm pri aktiviranju napredne infuzije.

Овај документ је важећи само на датум штампања. Ако нисте сигурни који је то датум штампања, одштампајте поново како бисте били сигурни да користите најновију ревизију упутства за употребу (доступно на адреси www.e-ifu.com). Обавеза корисника је да осигура коришћење најновијег упутства за употребу

Johnson & Johnson VISION

- Napredni infuzioni komplet VERITAS sme da se koristi sa rastvorom za irigaciju u boci ili kesi, po završetku uspešnog punjenja/podešavanja. Moguće je da neće sve vreće uspešno proći postupak punjenja, što može da uzrokuje kašnjenje terapije.

Upozorenje:

Samo jedna veličina. Medicinsko sredstvo nemojte ponovo sterilisati, ponovno obrađivati niti ponovno koristiti.

Medicinska sredstva za jednokratnu upotrebu kompanije Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. imaju uputstvo za upotrebu i rukovanje kako bi se na najmanju moguću meru svela izloženost uslovima koji mogu da ugroze proizvod, pacijenta ili korisnika. Ponovna sterilizacija/ponovna obrada medicinskih sredstava za jednokratnu upotrebu kompanije Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. može dovesti do fizičkog oštećenja medicinskog sredstva, nemogućnosti medicinskog sredstva da funkcioniše kao što je predviđeno, te bolesti ili povrede pacijenta usled infekcije, zapaljenja i/ili bolesti usled kontaminacije proizvoda, prenosa infekcije i nesterilnosti proizvoda.

Odlaganje na otpad:

Sa svakim kompletom VERITAS koje je kontaminirano krvlju, tkivom i/ili telesnim tečnostima/materijama mora se postupati kao sa biološki opasnim medicinskim otpadom u skladu sa protokolom zdravstvene ustanove i važećim lokalnim zahtevima.

Ako primite komplet VERITAS u nezadovoljavajućem stanju, odmah se obratite lokalnom prodajnom mestu kompanije Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Svaki komplet VERITAS se identifikuje brojem serije na nalepnicama pakovanja proizvoda koji treba navesti u okviru svake korespondencije ili razgovora.

Broj telefona u SAD: besplatan poziv 1-877-266-4543.

Prijavljivanje ozbiljnih incidenata:

Obratite se lokalnom predstavniku da biste prijavili sve pritužbe i/ili neželjene događaje u vezi sa proizvodom kompaniji Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Ako se proizvod primi u nezadovoljavajućem stanju, odmah se obratite lokalnoj prodajnoj kancelariji kompanije Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Svaka komponenta se identifikuje brojem serije koji treba navesti u okviru svake korespondencije ili razgovora. Broj telefona u SAD: besplatan poziv 1-877-266-4543.

Prijavljivanje ozbiljnih incidenata (EU):

Za pacijenta / korisnika / treću stranu u Evropskoj uniji i u zemljama sa istim regulatornim režimom; ako, tokom upotrebe ovog medicinskog sredstva ili kao rezultat njegove upotrebe, dođe do ozbiljnog incidenta, prijavite ga kompaniji Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. i/ili njenom ovlašćenom predstavniku i nadležnom telu zemlje članice u kojim korisnik i/ili pacijent ima prebivalište.

Simbol/naziv (objašnjenje):

SIMBOL	NAZIV (OBJAŠNJENJE)
	Pogledati uputstvo za upotrebu ili elektronsko uputstvo za upotrebu
	Ne koristite ponovo
	Sterilisano etilen-oksidom
	Kataloški broj
	Šifra serije
	Rok upotrebe
	Proizvođač
	Ovlašćeni predstavnik u Evropskoj zajednici / Evropskoj uniji

SIMBOL	NAZIV (OBJAŠNJENJE)
	Ne sterilisati ponovo
	Uvoznik
	Jedinstveni identifikator sredstva
	Ovlašćeni predstavnik za Švajcarsku
	Datum proizvodnje
	Ne koristiti ako je pakovanje oštećeno i pogledati uputstvo za upotrebu
	Evropska zajednica / Evropska unija
	Švajcarska
	Jedinica pakovanja
	Oprez
	Sistem jedne sterilne barijere
	Oprez: Savezni zakon nalaže da se ovo medicinsko sredstvo može prodavati isključivo po nalogu ovlašćenog zdravstvenog radnika.
	Otvoriti ovde
	Medicinsko sredstvo
	Lomljivo, pažljivo rukujte
	Ne izlažite vodi
	Ova strana gore

Oprez: Savezni zakon (SAD) nalaže da ovaj uređaj može prodavati ili naručivati isključivo lekar.

Proizvedeno u Meksiku

Овај документ је важећи само на датум штампања. Ако нисте сигурни који је то датум штампања, одштампајте поново како бисте били сигурни да користите најновију ревизију упутства за употребу (доступно на адреси www.e-ifu.com). Обавеза корисника је да осигура коришћење најновијег упутства за употребу

Johnson & Johnson VISION

Rx only

Introdução/Descrição:
O pacote de infusão avançado VERITAS ou o pacote de fluidos avançado VERITAS é um pacote com BOMBA DUPLA que fornece todos os tubos e acessórios necessários para realizar um procedimento de irrigação e aspiração ou um procedimento de facoemulsificação. O pacote de infusão avançado VERITAS contém uma linha de tubulação adicional para fornecer ar pressurizado à fonte da solução de irrigação. Cada pacote é composto pelos seguintes itens:

1. Cassete e conjunto de tubos
2. Capa protetora do monitor
3. Capa protetora do suporte Mayo
4. Câmara de teste

Finalidade prevista:
O pacote de infusão avançado VERITAS ou o pacote de fluidos avançado VERITAS contém o cassete e o conjunto de tubos e se destina a realizar irrigação e aspiração durante a cirurgia de catarata do segmento anterior. Ele é utilizado com o sistema VERITAS™ Vision. A câmara de teste se destina a verificar a conectividade e funcionalidade corretas da função de irrigação/aspiração antes do procedimento cirúrgico.

Desenhos do produto:

Pacote de fluidos avançado VERITAS

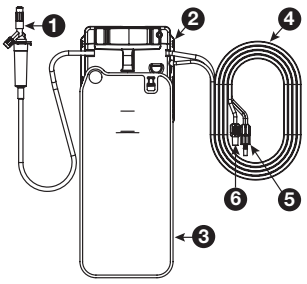

Pacote de infusão avançado VERITAS



1. Agulha de Irrigação (para Fonte de Irrigação)
2. Cassete
3. Bolsa de drenagem
4. Conjunto de tubos de E/S (para a manopla)
5. Conexão de irrigação do tipo Luer Lock
6. Conexão de aspiração

Somente o pacote de infusão avançado VERITAS:

7. Linha de infusão
8. Conector de infusão (para o console)

Indicações/Contraindicações/Paciente pretendido/Usuário pretendido:
Todas as informações relevantes para Indicações/Contraindicações/Paciente pretendido/Usuário pretendido estão descritas no Manual do Operador do Sistema de Facoemulsificação da Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. ("Manual do Operador"). Contraindicações: Qualquer condição preexistente do paciente que o profissional de saúde determine ser uma contraindicação à cirurgia de catarata. Os pacientes pretendidos incluem pacientes adultos com catarata ou pacientes adultos submetidos à cirurgia oftálmica do segmento anterior (por exemplo, remoção da lente do cristalino). Nota: Grávidas, lactantes ou crianças não foram incluídas no(s) ensaio(s) clínico(s) conduzido(s). O Sistema de Facoemulsificação da Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. se destina a ser utilizado por oftalmologistas e pessoal de apoio que trabalhe sob a orientação do cirurgião.

Benefícios clínicos/efeitos colaterais indesejáveis/efeitos adversos:
Todas as informações relevantes sobre benefícios clínicos/efeitos colaterais indesejáveis/efeitos adversos estão descritas no Manual do Operador. Os benefícios clínicos do Sistema de Facoemulsificação da Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. incluem o seguinte: Rápida reabilitação visual, Retomada precoce das atividades diárias, Inflamação ocular mínima, Astigmatismo pós-operatório mínimo, Potencial reduzido de complicações oculares. As complicações que podem estar associadas ao sistema de facoemulsificação da Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. incluem: cápsula quebrada, queimadura da córnea, infecção/inflamação e edema da córnea.

Instruções de uso:
Consulte as instruções a seguir para saber como instalar corretamente o pacote VERITAS. O pacote de infusão avançado VERITAS tem uma etapa adicional, conforme indicado abaixo. Para usar o pacote de infusão avançado VERITAS, é necessário selecionar "Infusão avançada" nas configurações do programa antes da cirurgia. Para obter informações adicionais, consulte o Manual do Operador. Antes de usar, inspecione visualmente a bandeja do produto para verificar se há violação da integridade da embalagem. Não use o produto se a integridade da embalagem tiver sido comprometida.

1. Após a remoção estéril de todo o conteúdo da bandeja do produto selada com tampa, entregue o CASSETE e a AGULHA DE IRRIGAÇÃO ao Circulador (Enfermeiro), mantendo o CONJUNTO DE TUBOS I/A no campo estéril.
2. Coloque a cobertura do monitor sobre o monitor no sistema VERITAS Vision.
3. Coloque as mãos na cobertura do suporte Mayo de acordo com as marcações de orientação na cobertura e cubra o braço da bandeja do sistema VERITAS Vision.
4. Insira o CASSETE no painel de fluidos do sistema VERITAS Vision.
5. Empurre o CASSETE até que o sistema ative o mecanismo de trava para reter o CASSETE.
6. Prepare a fonte da solução de irrigação.
7. Remova o protetor da ponta da AGULHA DE IRRIGAÇÃO.
8. Com a fonte na posição vertical, insira a AGULHA DE IRRIGAÇÃO diretamente no centro da tampa de borracha da fonte, sem torcer.
9. Pendure a fonte no suporte para soro e, em seguida, aperte e solte a câmara de gotejamento até que ela esteja entre 1/2 e 3/4 cheia.
10. Apenas para o pacote de infusão avançado VERITAS: A LINHA DE INFUSÃO tem um CONECTOR DE INFUSÃO preto na extremidade livre. Insira o CONECTOR DE INFUSÃO no painel lateral do Sistema VERITAS Vision e, em seguida, gire-o no sentido horário até ouvir um clique quando estiver totalmente conectado.
11. Para peças de mão sem porta de irrigação com travamento, retraia o colar no CONECTOR DE IRRIGAÇÃO TIPO LUER LOCK. Conecte os encaixes luer do CONJUNTO DE TUBOS I/A à peça de mão. Para peças de mão equipadas com uma porta de irrigação com travamento, gire o colar no CONECTOR DE IRRIGAÇÃO TIPO LUER LOCK no sentido horário para travar o encaixe na peça de mão.
12. Fixe a ponta e a manga de irrigação na peça manual de acordo com as instruções de montagem.
13. Na tela PREPARAÇÃO/AJUSTE no sistema VERITAS Vision, ative a Irrigação contínua com a ponta da manopla voltada para baixo dentro de uma câmara de teste não vedada contra a luva de irrigação.
14. Encha a câmara de teste com fluido eliminando todo o ar e insira a câmara de teste reta e centralizada sobre a ponta e a manga de irrigação até que esteja vedada.
15. Desative a irrigação contínua e realize a sequência de preparação de acordo com o Manual do Operador.

Geral:
O dispositivo não contém ftalatos.

O pacote é esterilizado com óxido de etileno e foi concebido para uso único.

Armazene o produto em um local fresco e seco.

Precauções:

- Não use o produto após sua data de validade marcada nas etiquetas de embalagem do produto.
- O conteúdo é estéril quando a bandeja do produto está selada com a tampa e não está danificada.

Este documento é válido apenas na data de impressão. Se não tiver certeza da data de impressão, reimprima para garantir o uso da revisão mais recente da IFU (disponível em www.e-ifu.com). O ônus é de responsabilidade do usuário, garantindo, assim, que a versão mais recente da IFU seja usada.

Johnson & Johnson VISION

- Se o desempenho do produto ficar comprometido durante o uso, interrompa o uso e realize os testes apropriados, conforme detalhado no Manual do Operador do sistema. Se os resultados não forem satisfatórios, substitua o Pacote de acordo com as instruções definidas no Manual do Operador.
- Ao usar o pacote de infusão avançado VERITAS, a altura efetiva total da fonte de irrigação não pode ser inferior a 30 cm quando a infusão avançada é ativada.
- O pacote de Infusão avançado VERITAS pode ser usado com solução de irrigação em uma garrafa ou bolsa após a conclusão de uma Preparação/Ajuste bem-sucedido. Nem todas as bolsas podem concluir a Preparação com sucesso, o que pode resultar em atraso no tratamento.

Advertência:

Somente para uso único. Não re-esterilize, reprocesse ou reutilize este dispositivo.

Os dispositivos médicos de uso único da Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. são rotulados com instruções de uso e manuseio para minimizar a exposição a condições que possam comprometer o produto, o paciente ou o usuário. A reutilização/re-esterilização/reprocessamento dos dispositivos de uso único da Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. pode resultar em danos físicos ao dispositivo médico, falha do dispositivo médico em ter o desempenho esperado e doença ou lesão do paciente devido a infecção, inflamação e/ou doença devido à contaminação do produto, transmissão de infecção e falta de esterilidade do produto.

Descarte:

Qualquer pacote VERITAS que tenha sido contaminado por sangue, tecidos e/ou fluidos/matérias corporais deve ser manuseado como resíduo médico com risco biológico, de acordo com o protocolo da instituição de saúde e os requisitos locais aplicáveis.

Se o pacote VERITAS for recebido em condições insatisfatórias, entre em contato imediatamente com o escritório de vendas local da Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Cada pacote VERITAS é identificado por um número de lote nas etiquetas da embalagem do produto, que deve ser incluído em qualquer correspondência ou discussão.

Nos EUA, telefone: ligação gratuita 1-877-266-4543.

Relatório de incidentes graves:

Entre em contato com o representante local para relatar todas as reclamações sobre o produto e/ou eventos adversos à Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Se o produto for recebido em condições insatisfatórias, entre em contato imediatamente com o escritório de vendas local da Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Cada componente é identificado por um número de lote e ele deve ser incluído em toda correspondência ou discussão. Nos EUA, telefone: ligação gratuita 1-877-266-4543.

Relatório de incidentes graves (UE):

Para um paciente/usuário/terceiro na União Europeia e em países com regime regulatório idêntico; se, durante o uso deste dispositivo ou como resultado de seu uso, ocorrer um incidente grave, informe a Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. e/ou seu representante autorizado e a autoridade competente do Estado-Membro em que o usuário e/ou paciente está estabelecido.

Símbolo/título (explicação):

SÍMBOLO	TÍTULO (EXPLICAÇÃO)
	Consulte as instruções de uso ou consulte as instruções eletrônicas de uso
	Não reutilize
	Esterilizado com óxido de etileno
	Número de catálogo

SÍMBOLO	TÍTULO (EXPLICAÇÃO)
	Código de lote
	Data de validade
	Fabricante
	Representante autorizado na Comunidade Europeia/União Europeia
	Não re-esterilize
	Importador
	Identificador exclusivo do dispositivo
	Representante autorizado na Suíça
	Data de fabricação
	Não utilize se a embalagem estiver danificada e consulte as instruções de uso
	Comunidade Europeia/União Europeia
	Suíça
	Unidade de embalagem
	Cuidado
	Sistema de barreira estéril única
	Cuidado: As leis federais restringem a venda deste dispositivo a profissionais de saúde licenciados ou mediante prescrição destes.
	Abra aqui
	Dispositivo médico
	Frágil, manuseie com cuidado
	Manter em local seco
	Este lado para cima

Cuidado: A Legislação Federal (EUA) restringe a venda deste dispositivo a médicos ou sob prescrição médica.

Produto do México

Este documento é válido apenas na data de impressão. Se não tiver certeza da data de impressão, reimprima para garantir o uso da revisão mais recente da IFU (disponível em www.e-ifu.com). O ônus é de responsabilidade do usuário, garantindo, assim, que a versão mais recente da IFU seja usada.

℞ only

Вступ / опис

Покращений інфузійний набір VERITAS або покращений набір для переливання рідин VERITAS — це набір для ДВОХ НАСОСІВ, який містить усі трубки та аксесуари, необхідні для виконання процедури іригації та аспірації або процедури факоемульсифікації. Покращений інфузійний набір VERITAS містить додаткову трубку для подання стисненого повітря у флакон з іригаційним розчином. Кожен набір складається з таких предметів:

1. Касета та трубки в зборі
2. Футляр монітора
3. Футляр підставки Мауо
4. Тестова камера

Призначення

Покращений інфузійний набір VERITAS або покращений набір для переливання рідин VERITAS містить касету й трубки в зборі й призначений для виконання іригації та аспірації під час операції з видалення катаракти переднього сегмента ока. Використовується із системою VERITAS™ Vision. Тестова камера призначена для перевірки правильності підключення та функціонування системи іригації/аспірації перед хірургічною процедурою.

Схема виробу

Покращений набір для переливання рідин VERITAS

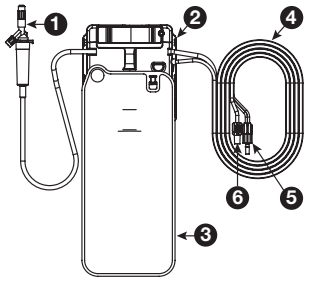

Покращений інфузійний набір VERITAS



1. Шип (до флакона з іригаційним розчином)
2. Касета
3. Дренажний пакет
4. Набір іригаційних/аспіраційних трубок (до наконечника)
5. Фітинг Люера для іригації
6. Фітинг для аспірації

Лише покращений інфузійний набір VERITAS:

7. Інфузійна лінія
8. Інфузійний роз'єм (до консолі)

Показання / протипоказання / цільовий пацієнт / цільовий користувач

Уся відповідна інформація про показання / протипоказання / цільового пацієнта / цільового користувача надається в посібнику користувача системи факоемульсифікації компанії Джонсон-енд-Джонсон Сьорджікал Віжін Інк. (далі — посібник користувача). Протипоказання: будь-який наявний стан пацієнта, який лікар визначає як протипоказання до операції з видалення катаракти. Цільові пацієнти — це дорослі пацієнти з катарактою або дорослі пацієнти, яким призначена операція на передньому сегменті ока (наприклад, видалення кришталика). Примітка. Вагітні жінки, жінки, які годують груддю, і діти не брали участь у проведених клінічних дослідженнях. Система факоемульсифікації компанії Джонсон-енд-Джонсон Сьорджікал Віжін Інк. призначена для використання офтальмологом і допоміжним персоналом, який працює під керівництвом хірурга.

Клінічні переваги / небажані побічні дії / несприятливі ефекти

Уся відповідна інформація про клінічні переваги / небажані побічні дії / несприятливі ефекти описана в посібнику користувача. Клінічні переваги, пов'язані із системою факоемульсифікації компанії Джонсон-енд-Джонсон Сьорджікал Віжін Інк. включають таке: швидке відновлення зору, раннє відновлення повсякденної діяльності, мінімальне запалення очей, мінімальний післяопераційний астигматизм, зниження імовірності очних ускладнень. До ускладнень, які можуть бути пов'язані із системою факоемульсифікації компанії Джонсон-енд-Джонсон Сьорджікал Віжін Інк., належать розрив капсули, опік рогівки, інфекція/запалення та набряк рогівки.

Інструкція із застосування

виконайте наведені нижче вказівки, щоб правильно встановити набір VERITAS. Покращений інфузійний набір VERITAS має один додатковий крок, як зазначено нижче. Щоб використовувати покращений інфузійний набір VERITAS, перед операцією необхідно вибрати «Покращена інфузія» у налаштуваннях програми. Додаткові інструкції див. в посібнику користувача. Перед використанням візуально огляньте лоток із виробом на наявність порушень цілісності паковання. Не використовуйте виріб, якщо цілісність паковання порушена.

1. Після виймання в стерильних умовах усього вмісту з лотка з виробом, закритого кришкою, передайте КАСЕТУ та ШИП асистенту (медсестрі), утримуючи НАБІР ІРИГАЦІЙНИХ/АСПІРАЦІЙНИХ ТРУБОК у стерильному полі.
2. Натягніть футляр монітора на монітор системи VERITAS Vision.
3. Помістіть руки у футляр підставки Мауо згідно з напрямними мітками на футлярі та накрийте кронштейн підставки системи VERITAS Vision.
4. Уставте КАСЕТУ в рідинну панель системи VERITAS Vision.
5. Натискайте на КАСЕТУ, доки система не активує механізм блокування для фіксації КАСЕТИ.
6. Підготуйте флакон з іригаційним розчином.
7. Зніміть протектор із наконечника ШИПА.
8. Поставте флакон вертикально, вставте ШИП прямо в центр гумової пробки флакона, не закручуючи.
9. Підвісьте флакон на стійку для внутрішньовенних вливань, а потім стисніть і відпустіть крапельницю, доки вона не заповниться на ½—¾.
10. Лише для покращеного інфузійного набору VERITAS. На вільному кінці ІНФУЗІЙНА ЛІНІЯ має чорний ІНФУЗІЙНИЙ РОЗ'ЄМ. Уставте ІНФУЗІЙНИЙ РОЗ'ЄМ у бічну панель системи VERITAS Vision, а потім поверніть його за годинниковою стрілкою до клацання за умови повного з'єднання.
11. Для наконечників без запірного іригаційного порту натягніть муфту на ФІТИНГ ЛЮЕРА ДЛЯ ІРИГАЦІЇ. Під'єднайте фітинги Люера НАБОРУ ІРИГАЦІЙНИХ/АСПІРАЦІЙНИХ ТРУБОК до наконечника. Для наконечників, оснащених запірним іригаційним портом, натягніть муфту на ФІТИНГ ЛЮЕРА ДЛЯ ІРИГАЦІЇ за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати фітинг на наконечнику.
12. Приєднайте наконечник та іригаційний рукав до насадки згідно з інструкціями зі збирання.
13. На екрані ПІДГОТОВКИ/НАЛАШТУВАННЯ в системі VERITAS Vision активуйте безперервну іригацію, спрямувавши насадку наконечника вниз усередині тестової камери, не закритої герметично від іригаційного рукава.
14. Заповніть тестову камеру рідиною, повністю видаливши все повітря, і вставте тестову камеру прямо та по центру відносно наконечника та іригаційного рукава до досягнення герметичності.
15. Вимкніть безперервну іригацію та виконайте процедуру заправлення згідно з посібником користувача.

Загальна інформація

Виріб не містить фталатів.

Набір стерилізований етиленоксидом та призначений для одноразового використання.

Зберігайте виріб у прохолодному сухому місці.

Застереження

- Не використовуйте виріб після терміну придатності, зазначеного на етикетках пакування.
- Вміст стерильний, якщо лоток із виробом закритий кришкою та не пошкоджений.
- Якщо характеристики виробу погіршаться під час використання, припиніть використання та виконайте відповідні тести, як описано в посібнику користувача системи. Якщо результати є незадовільними, замініть набір згідно з указівками, зазначеними в посібнику користувача.
- У разі використання покращеного інфузійного набору VERITAS ефективна висота флакона не може бути нижче 30 cm (см) у разі активації опції «Покращена інфузія».
- Покращений інфузійний набір VERITAS можна використовувати з іригаційним розчином у флаконі або пакеті після успішного завершення підготовки/налаштування. Не всі пакети можуть успішно пройти етап підготовки, що може спричинити затримку під час лікування.

Цей документ чинний тільки станом на день друку. Якщо ви не маєте точних відомостей щодо дати друку цих інструкцій, роздрукуйте їх знову, щоб гарантувати використання найновішої версії (інструкції доступні на сайті www.e-ifu.com). Відповідальність за використання найбільш актуальної версії інструкцій несе користувач.

Johnson & Johnson VISION

Попередження

Тільки для одноразового використання. Цей виріб не підлягає повторній стерилізації, повторній обробці та повторному використанню.

Одноразові медичні вироби компанії Джонсон-енд-Джонсон Сьорджікал Віжін Інк. постачаються в комплекті з інструкцією із застосування та правилами поводження, щоб зменшити вплив обставин, що можуть становити загрозу для виробу, пацієнта чи користувача. Повторне використання / повторна стерилізація/ повторна обробка одноразових медичних виробів Джонсон-енд-Джонсон Сьорджікал Віжін Інк. може призвести до фізичного пошкодження медичного виробу, порушення функціонування медичного виробу за призначенням, а також захворювання чи травми пацієнта через інфекцію, запалення та (або) захворювання внаслідок забруднення виробу, передачі інфекції та відсутності стерильності.

Утилізація

З будь-яким набором VERITAS, забрудненим кров'ю, тканинами та (або) біологічними рідинами / речовинами, слід поводитися як із біологічно небезпечними медичними відходами згідно з протоколом медичного закладу та застосовуваними місцевими вимогами.

Якщо набір VERITAS отримано в незадовільному стані, негайно зв'яжіться з місцевим торговельним представництвом компанії Джонсон-енд-Джонсон Сьорджікал Віжін Інк. Кожен набір VERITAS ідентифікується номером партії на етикетках паковання виробу, і це має бути зазначено в будь-якому листуванні чи обговореннях.

Номер телефону для безкоштовних дзвінків у США: 1-877-266-4543.

Звітування про серйозні інциденти

Зв'яжіться зі своїм місцевим представником, щоб повідомити про всі скарги на виріб та (або) несприятливі події в Джонсон-енд-Джонсон Сьорджікал Віжін Інк. Якщо виріб отримано в незадовільному стані, негайно зв'яжіться з місцевим відділом продажів Джонсон-енд-Джонсон Сьорджікал Віжін Інк. Кожен компонент ідентифікується номером партії, і це має бути зазначено в будь-якому листуванні чи обговореннях. Номер телефону для безкоштовних дзвінків у США: 1-877-266-4543.

Звітування про серйозні інциденти (ЄС)

Для пацієнта / користувача / третьої сторони в Європейському Союзі та країнах з ідентичною регуляторною базою: якщо під час використання цього виробу або через його застосування стався серйозний інцидент, сповістить про це компанію Джонсон-енд-Джонсон Сьорджікал Віжін Інк. та (або) її уповноваженого представника, а також компетентний орган держави — члена, у якій проживає користувач і/або пацієнт.

Символ / назва (пояснення)

СИМВОЛ	НАЗВА (ПОЯСНЕННЯ)
	Користуйтеся інструкцією із застосування або користуйтеся електронною інструкцією із застосування
	Повторно не використовувати
STERILE EO	Стерилізація оксидом етилену
REF	Номер за каталогом
LOT	Код партії
	Використати до
	Виробник
EC REP	Уповноважений представник у Європейському співтоваристві / Європейському Союзі
	Повторно не стерилізувати.
	Імпортер
UDI	Унікальний ідентифікатор виробу
CH REP	Уповноважений представник у Швейцарії
	Дата виготовлення

СИМВОЛ	НАЗВА (ПОЯСНЕННЯ)
	Не застосовувати в разі пошкодження паковання та див. інструкцію із застосування
EC	Європейське співтовариство / Європейський Союз
CH	Швейцарія
	Пакувальна одиниця
	Попередження. Зверніться до інструкції із застосування.
	Одинарна стерильна бар'єрна система
Rx only	Попередження. Федеральний закон (США) обмежує продаж цього пристрою лікарем або за призначенням ліцензованого практикуючого лікаря.
	Відкривати тут
MD	Медичний виріб
	Крихке, поводитися обережно
	Зберігати в сухому місці
	Цією стороною догори. Указує правильне вертикальне положення упаковки під час транспортування

Попередження. Федеральний закон (США) обмежує продаж цього пристрою лікарем або за його призначенням.

Вироблено у Мексиці

Джонсон-енд-Джонсон Сьорджікал Віжін Інк.
31 Текнолоджі Драйв, Сьют 200,
Ірвайн, Каліфорнія 92618 США

UA.TR.116

Цей документ чинний тільки станом на день друку. Якщо ви не маєте точних відомостей щодо дати друку цих інструкцій, роздрукуйте їх знову, щоб гарантувати використання найновішої версії (інструкції доступні на сайті www.e-ifu.com). Відповідальність за використання найбільш актуальної версії інструкцій несе користувач.