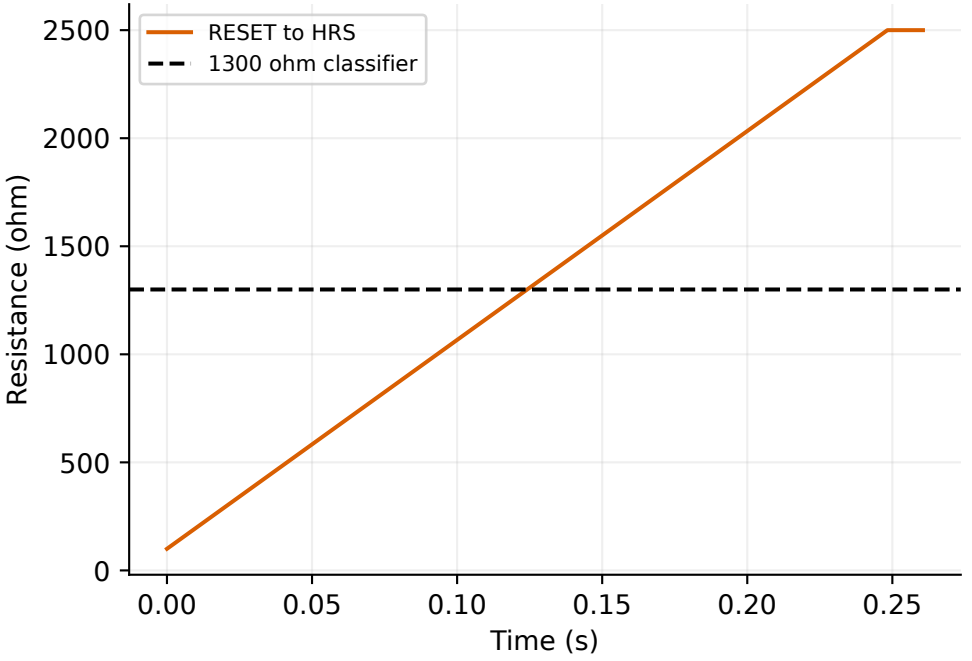
RESET to HRS
1300 ohm classifier
Resistance (ohm)
2500
2000
1500
1000
500
0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
Time (s)

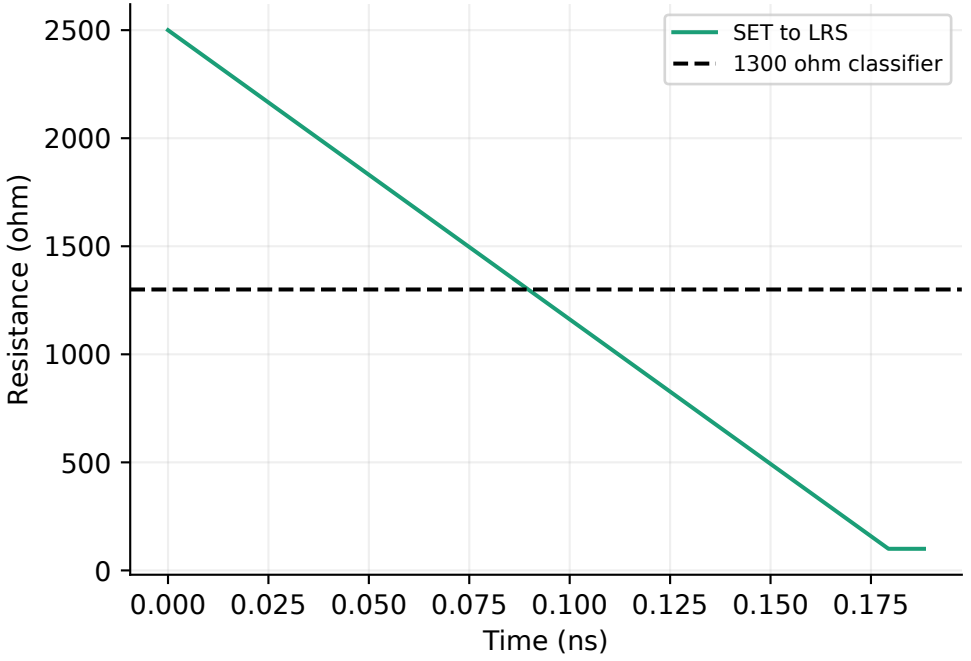
SET to LRS
1300 ohm classifier
Resistance (ohm)
2500
2000
1500
1000
500
0
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150
0.175
Time (ns)