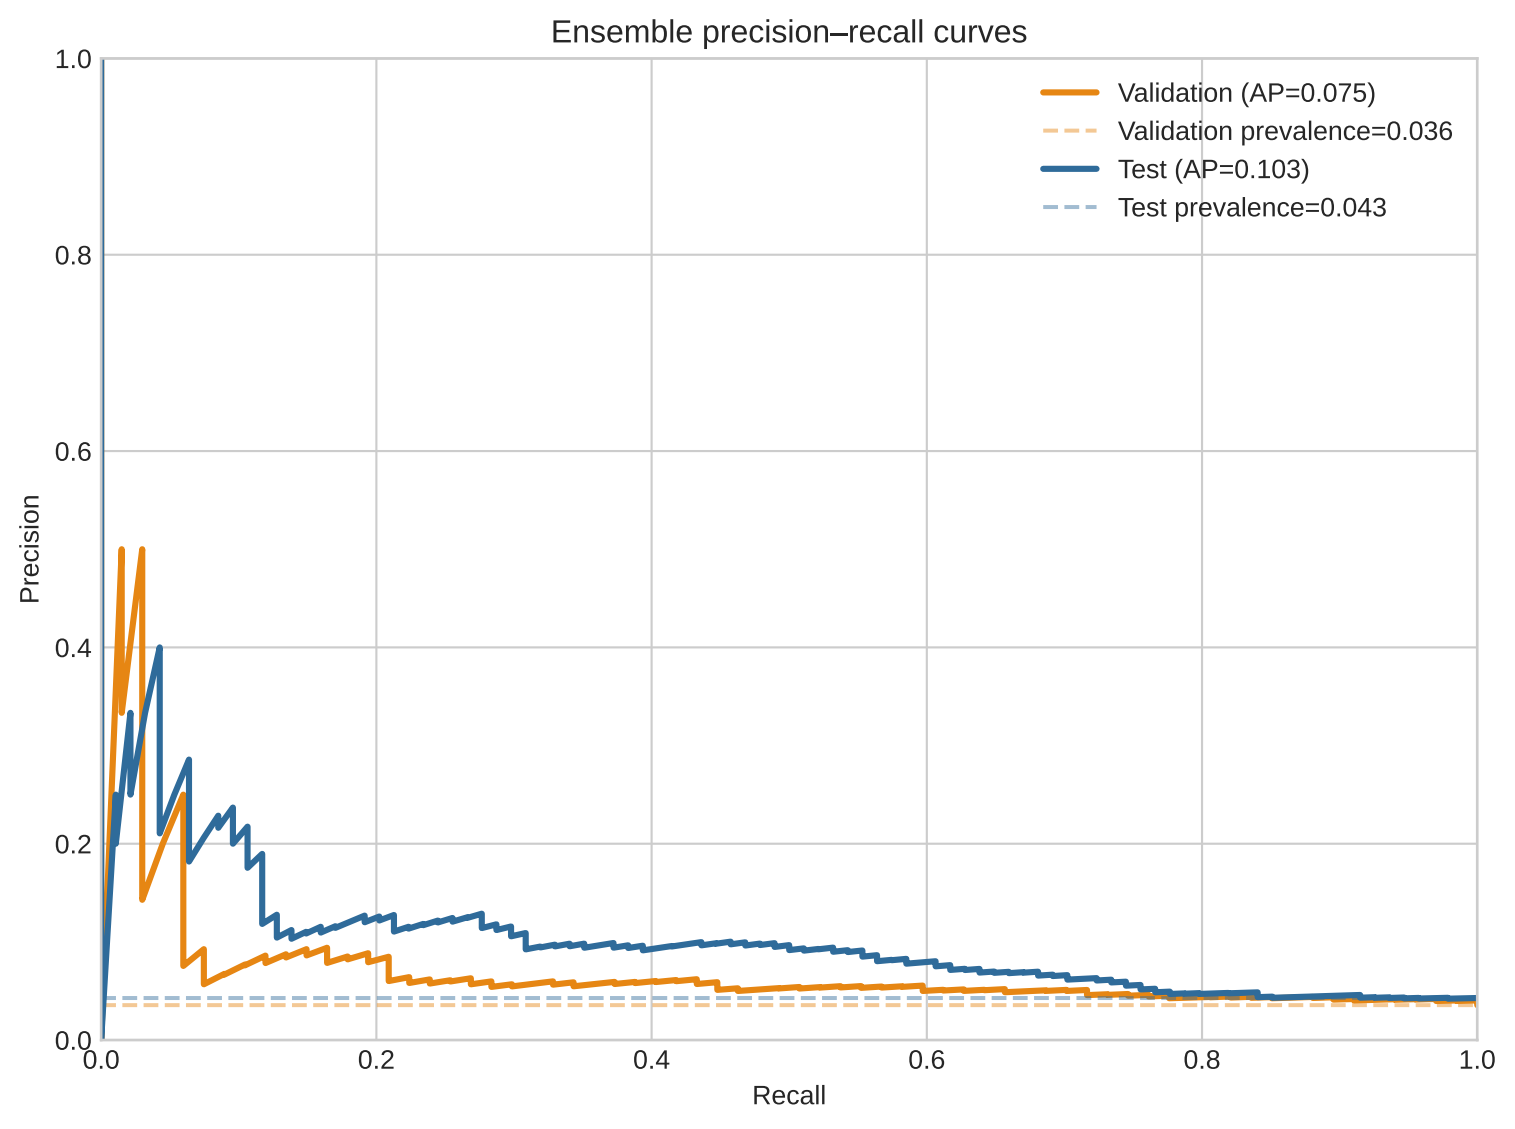
Ensemble precision–recall curves
Validation (AP=0.075)
Validation prevalence=0.036
Test (AP=0.103)
Test prevalence=0.043
Precision
Recall
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0