




ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO

UNIDADE I

*Central de Material e
Esterilização – CME*




Centro de Material e Esterilização (CME)

É uma unidade destinada a recepção, limpeza, desinfecção, preparo, esterilização, armazenamento, distribuição e controle dos materiais para as demais unidades hospitalares, como CC, centro obstétrico (CO), unidades de internação (UI), pronto atendimento (PA), unidade de terapia intensiva (UTI), ambulatorios, entre outras.

Finalidade e objetivos do CME



O CME deve ser considerado o cartão de visitas de uma instituição, pois é a unidade que responde por preparo, distribuição e controle dos materiais hospitalares e que tem por finalidade assegurar a quantidade e a qualidade de materiais necessários a todo o hospital, para que os pacientes possam ser assistidos com segurança.



Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n. 15 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Define o CME como uma “unidade funcional destinada ao processamento de produtos para saúde dos serviços de saúde”

- **Classe I:** realiza o processamento de produtos para a saúde não críticos, semicríticos e críticos de **conformação não complexa**, passíveis de processamento.
- **Classe II:** realiza o processamento de produtos para a saúde não críticos, semicríticos e críticos de **conformação complexa e não complexa**, passíveis de processamento.

RDC 15- Conformação complexa e não complexa

Produtos com conformação complexa:


- ✓ Lúmen menor do que cinco milímetros ou fundo cego;
- ✓ Espaços internos que não sejam acessíveis para a realização de fricção direta;
- ✓ Válvulas ou reentrâncias.

Produtos com conformação não complexa:

- ✓ Superfícies externas e internas possam ser alcançadas por escovação durante o processo de limpeza;
- ✓ Apresentem diâmetro superior a cinco milímetros em suas estruturas tubulares.

Critérios para o planejamento da área física

- ✓ Demanda de produtos a serem processados
- ✓ Número e especificidade de leitos do hospital
- ✓ Existência de Centro Cirúrgico
- ✓ Quantidade de salas de operações e média diária de cirurgias
- ✓ Especialidades cirúrgicas a serem atendidas
- ✓ Adoção de material ou não de uso único
- ✓ Inventário do arsenal cirúrgico
- ✓ Forma de armazenagem e distribuição dos produtos esterilizados às unidades consumidoras

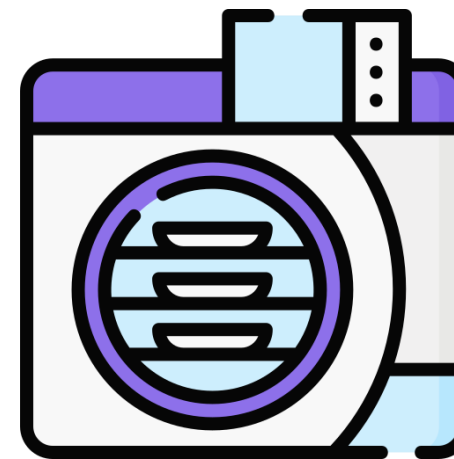

RDC 307

CME é o setor responsável pelo desenvolvimento das seguintes atividades:


- Receber, desinfetar e separar os artigos que requerem reproprocessamento;
- Lavar os artigos de maneira cuidadosa e sistemática;
- Receber as roupas provenientes da lavanderia;
- Empacotar os artigos a serem reproprocessados e as roupas a serem esterilizadas;
- Esterilizar os artigos e as roupas, por meio de métodos adequados;
- Realizar controle microbiológico e de validade dos artigos esterilizados;
- Armazenar e distribuir os artigos e as roupas esterilizados para outras unidades;
- Zelar pela proteção e pela segurança dos pacientes e dos funcionários.

ESTRUTURA FÍSICA

ÁREA CONTAMINADA: receber os artigos contaminados ou sujos e executar os procedimentos de descontaminação prévia e lavagem de todos os materiais.

ÁREA LIMPA: executar os procedimentos de desinfecção, secagem, preparo, acondicionamento, esterilização, armazenamento, controle e distribuição dos materiais.

ESTRUTURA FÍSICA

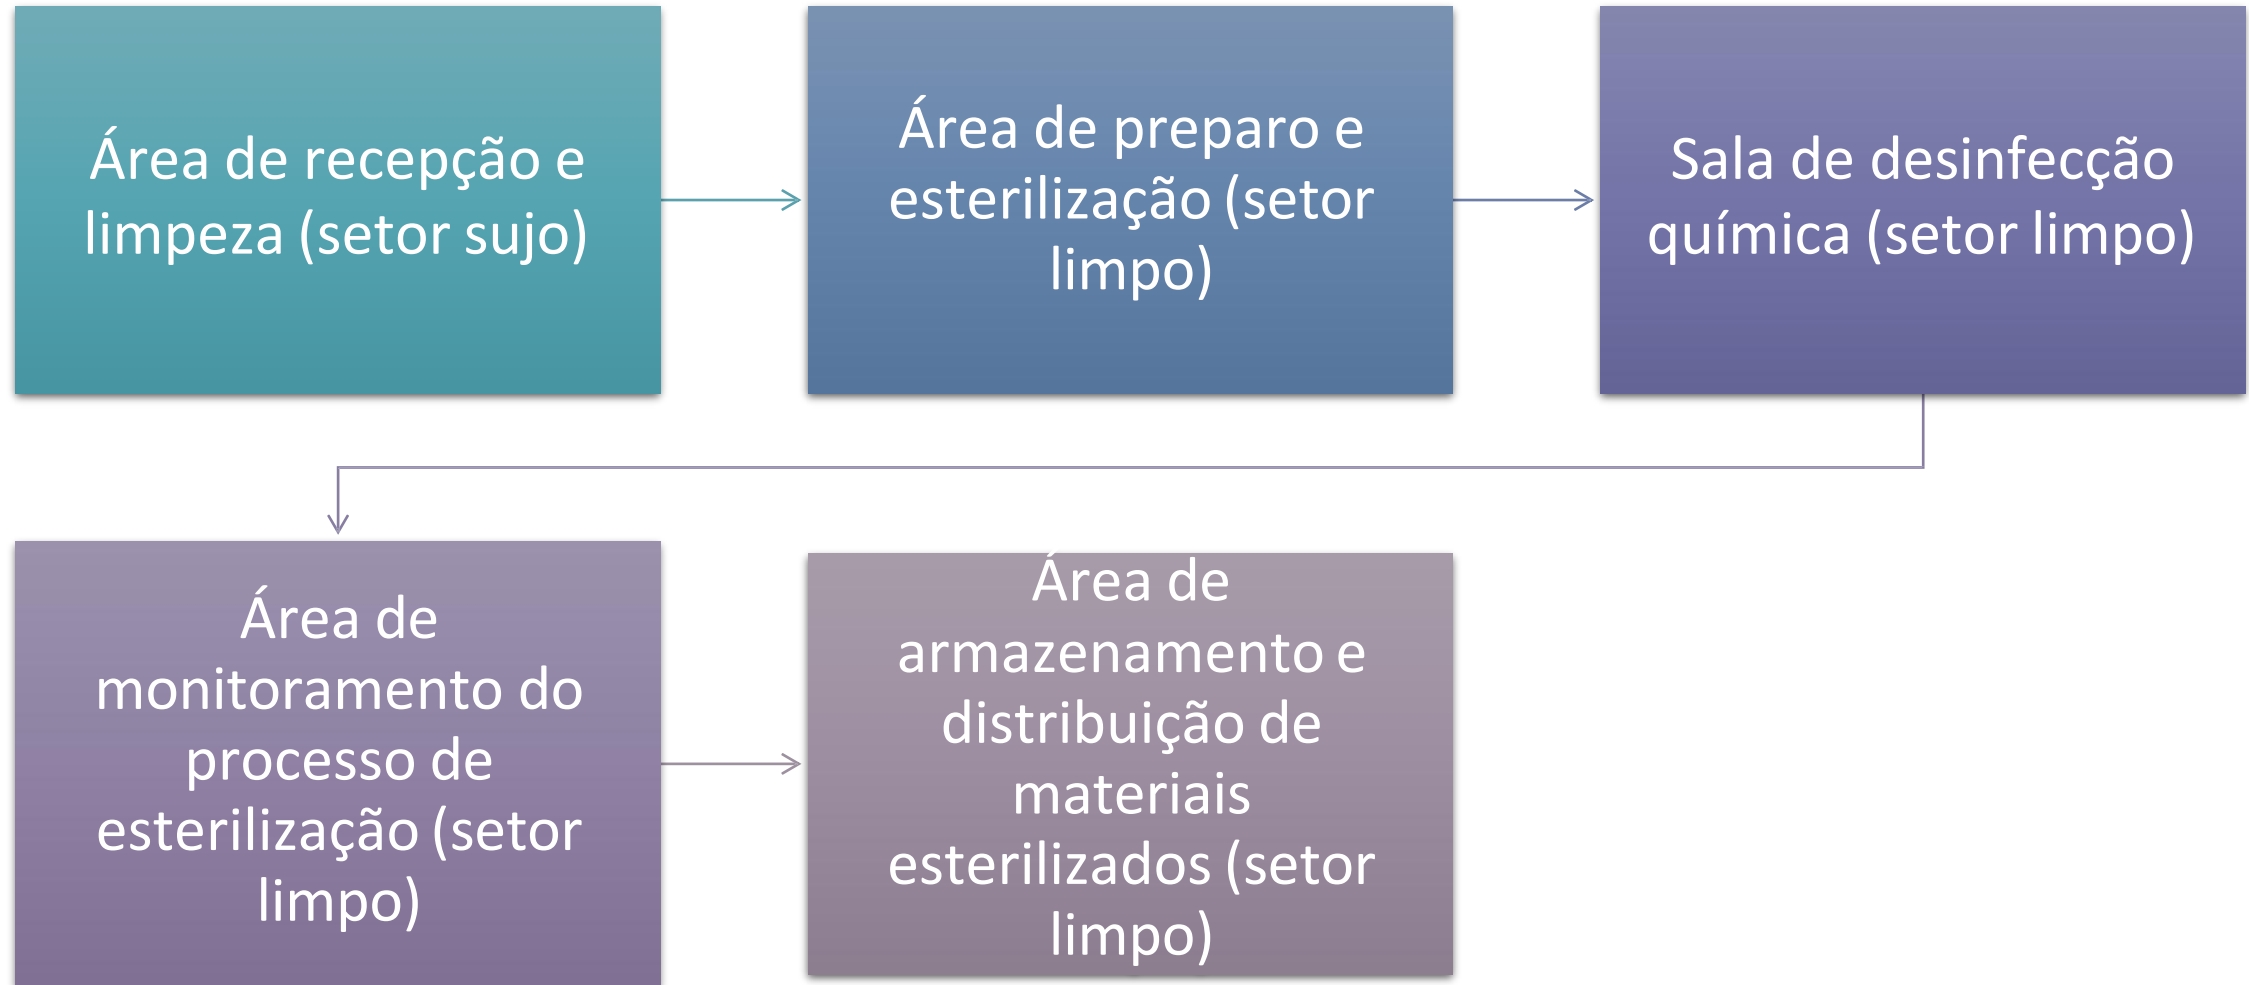

Uso de EPI em CME

O uso de EPI é obrigatório aos trabalhadores de Enfermagem no CME, em razão dos riscos físicos, químicos e microbiológicos presentes.

Na área de recepção

- Óculos de proteção
- Máscara
- Luvas de procedimento
- Avental
- Calçado impermeável e antiderrapante




Na área de limpeza

- Óculos de proteção
- Máscara
- Luvas de cano longo
- Avental impermeável manga longa
- Calçado impermeável e antiderrapante

(RDC nº15, ANVISA, 2012)


Na área de inspeção, preparo e condicionamento

- Máscara
- Luvas de procedimento
- Protetor auricular(S/N)
- Calçado fechado




Na área de desinfecção química

- Óculos de proteção
- Máscara compatível com a toxicidade
- Luvas de látex ou sintética de cano longo
- Avental
- Calçado impermeável e antiderrapante



Na área de esterilização

- Luvas de proteção térmica

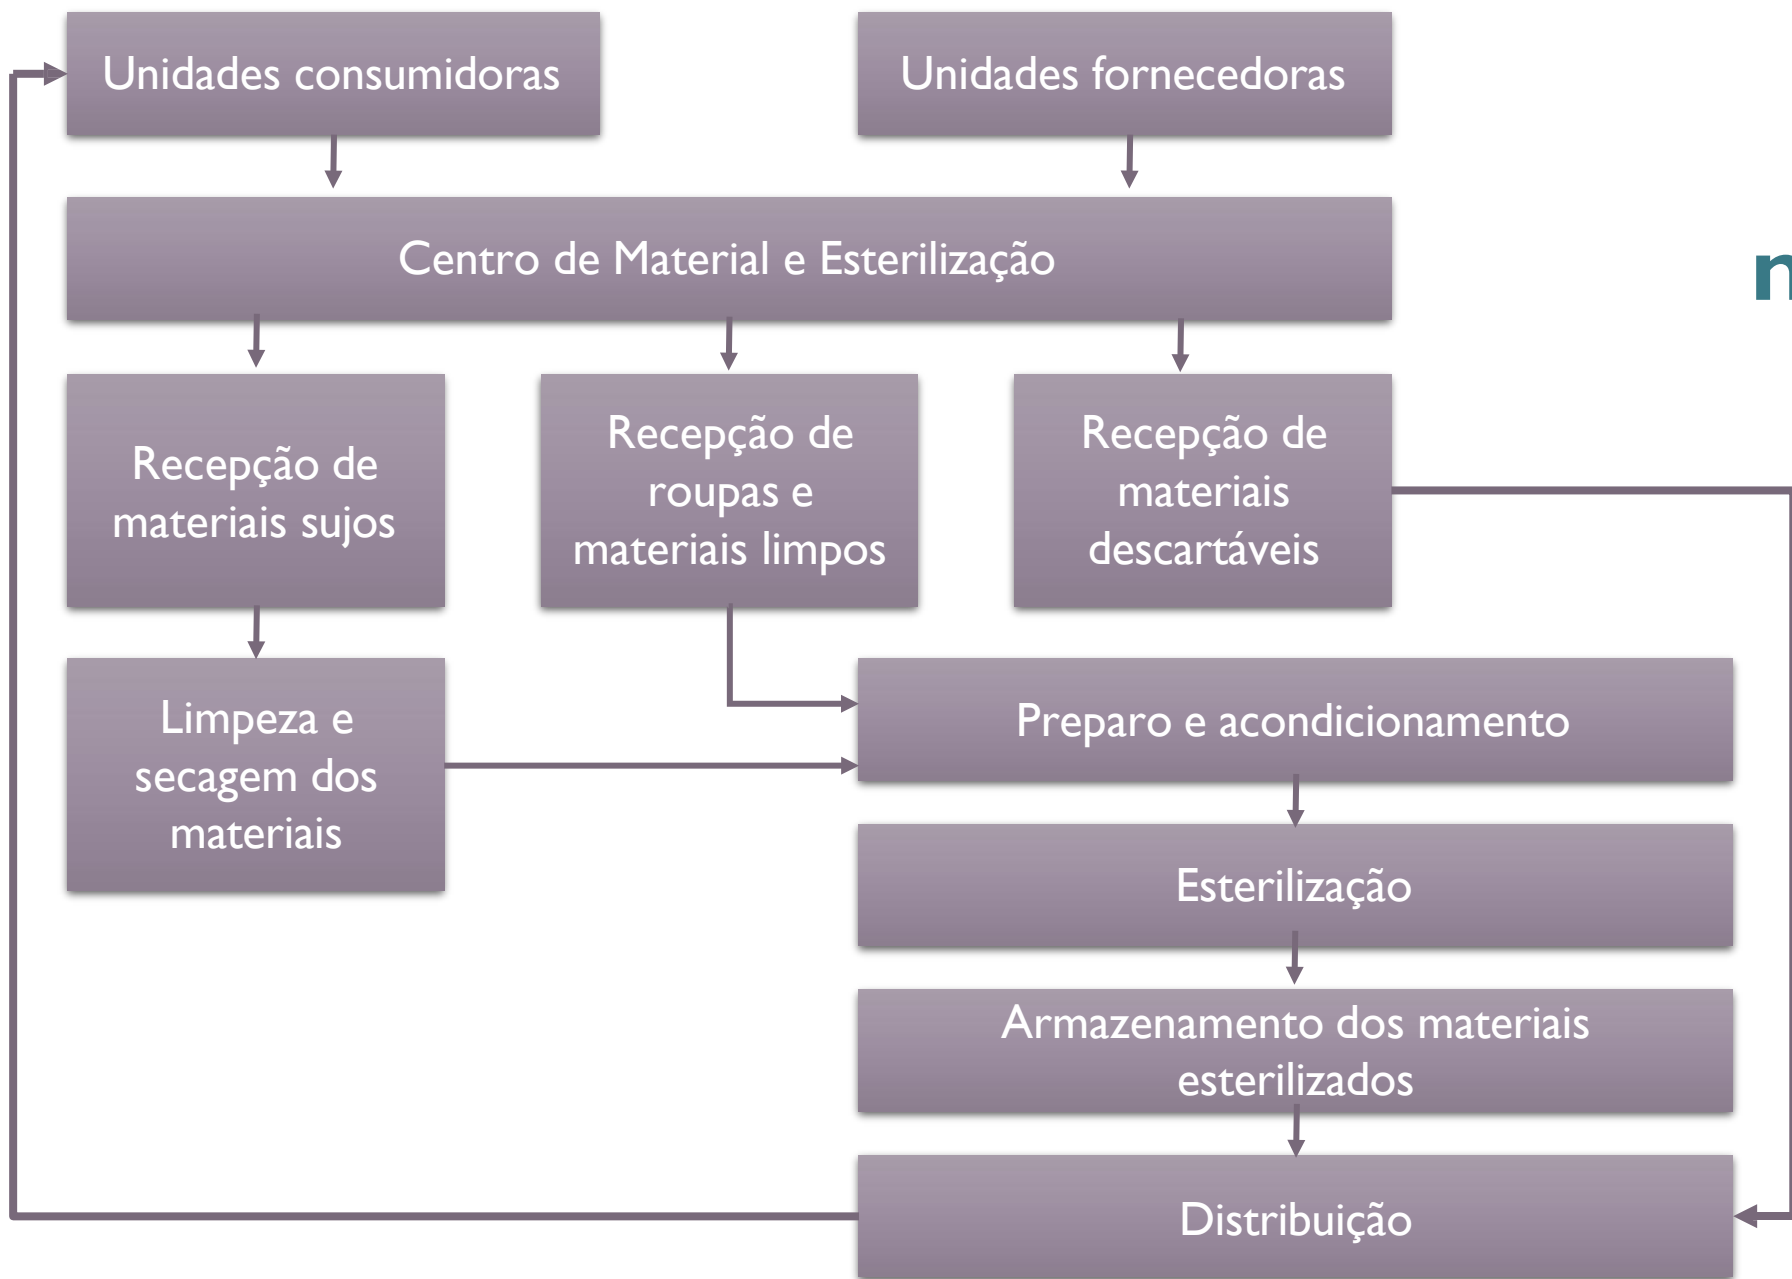

Fluxo de materiais no CME

Principais equipamentos utilizados no CME



Lavadoras ultrassônica, termodesinfetadoras e secadoras, utilizadas no processo de limpeza



Autoclave vapor saturado, autoclave de plasma de peróxido de hidrogênio, utilizadas no processo de esterilização mais comumente em ambiente hospitalar




Seladoras utilizadas na selagem dos invólucros para acondicionamento dos materiais



Incubadoras para indicadores biológicos, utilizadas para validação dos processos de esterilização.

Recursos Humanos no CME

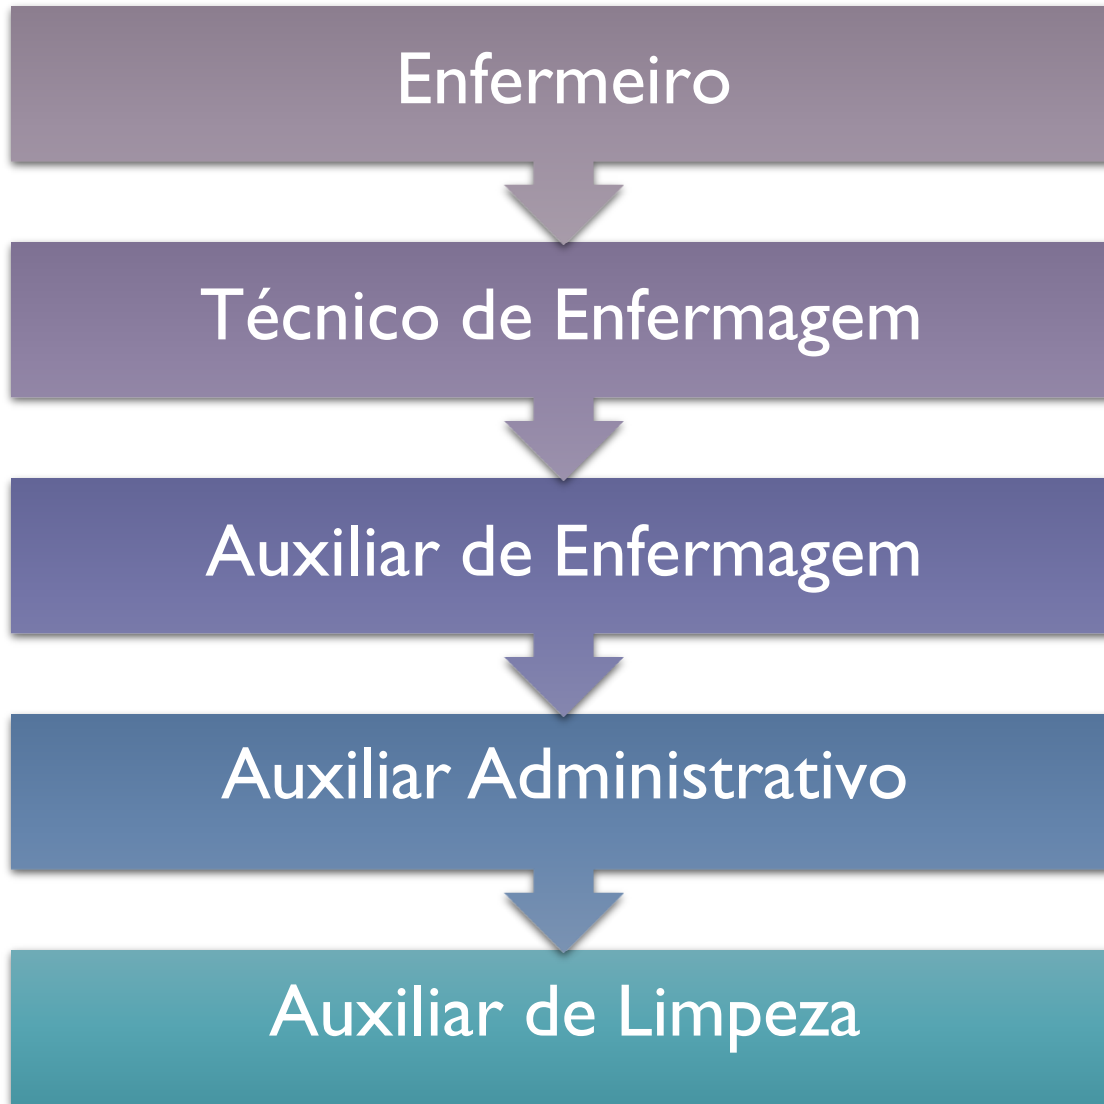

Devem utilizar vestimenta privativa, touca e calçado fechado em todas as áreas do setor, além da utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) específicos de acordo com a atividade a ser desenvolvida.

Enfermeiro no CME

Exige competências gerenciais, na medida em que ele atuará diretamente na administração da unidade, competências técnico-assistenciais relacionadas aos processos de trabalho da unidade e de gestão de pessoas que compõem a equipe de trabalho.

O enfermeiro precisa ter desenvolvido habilidades e competências que o tornem capaz de gerenciar uma unidade que exige um alto grau de responsabilização

Atribuições do RT em CME

1. Garantir a implementação das normas de processamento de produtos para saúde;
 2. Prever e prover os recursos humanos e materiais necessários ao funcionamento da unidade;
 3. Garantir que todas as atribuições e responsabilidades profissionais estejam formalmente sendo cumpridas.
 4. Garantir a rastreabilidade das etapas do processamento de produtos para saúde;
 5. Participar do processo de capacitação, educação continuada e avaliação do desempenho dos profissionais que atuam no CME;
 6. Propor os indicadores de controle de qualidade;
 7. Orientar as unidades usuárias dos produtos quanto ao transporte e armazenamento destes produtos;
-

Gestão dos recursos materiais

- Inicia com a escolha dos materiais que serão utilizados no reprocessamento, que vai desde a escolha dos detergentes e produtos químicos destinados à limpeza dos materiais até o invólucro que será utilizado para o preparo, esterilização e armazenamento.
- Deve-se garantir que estejam esterilizados e prontos para o uso em qualquer Unidade do ambiente hospitalar.
- O enfermeiro do CME é responsável pela manutenção e bom funcionamento dos equipamentos utilizados no processamento dos materiais.



Gestão de instrumentais cirúrgicos

Tem como principal objetivo oferecer recursos adequados à produção com qualidade, em quantidade suficiente, em tempo satisfatório e ao menor custo possível.

A gestão e controle de materiais no CME apontam dois aspectos: a qualidade do processamento e armazenamento, objetivando estabilidade, conservação, segurança; e a quantidade, que está relacionada à previsão – necessidades e provisão margem de segurança para atendimento de situações não previstas.