
Comparación de percentiles

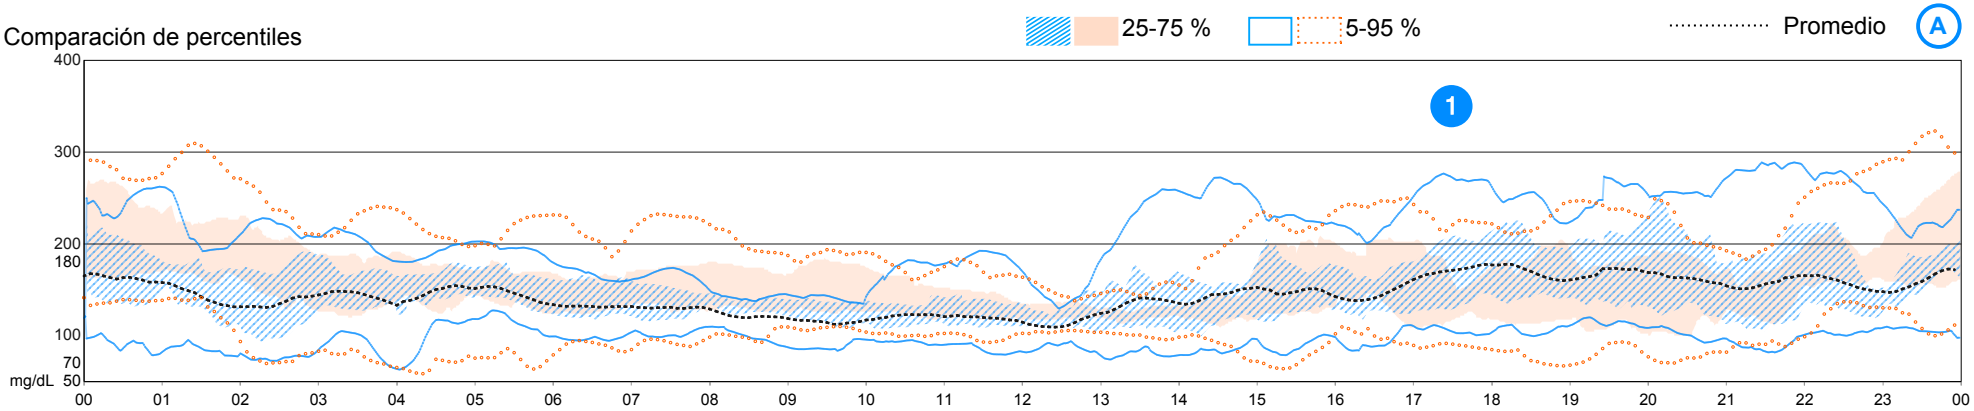


Ratio de HC (g/U)
A 10.0
B 10.0

A

Patrones hipoglucémicos (0)	N.º de episodios (diarios): 0.4	Patrones hiperglucémicos (1)	N.º de episodios (diarios): 0.8
Ninguna		1 17:00 - 17:59 (3 casos)	

Tiempo en rango

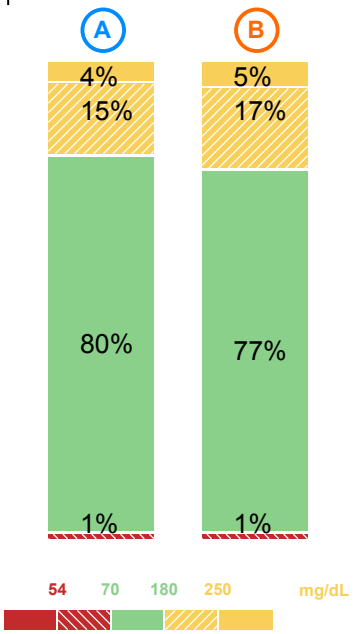


3 Indicador de control de glucosa
4 Total programado de 24 horas en el modo manual del patrón basal activo


Salidas de SmartGuard

	A	B
No hay calibración	0	0
Infusión máxima de SmartGuard	0	0
Infusión mínima de SmartGuard	0	0
GS necesaria para SmartGuard	0	0
Algoritmo del sensor con lecturas infer. a las reales	0	0
Actualización del sensor	0	0
Sin valores glucosa sensor	0	0
Fin sensor	0	0
SmartGuard desactivada por el usuario	• 1	2 • •
Suspensión prolongada	0	0
Inicio de SmartGuard	0	0
Sin identificar	0	0

Estadísticas

	A	B
SmartGuard (a la semana)	95% (6d 15h)	98% (6d 21h)
Modo manual (a la semana)	1% (02h)	2% (03h)
Uso del sensor (a la semana)	95% (6d 16h)	98% (6d 20h)
Promedio SG ± DE	144 ± 48 mg/dL	149 ± 50 mg/dL
ICG³	6.7%	6.9%
Coeficiente de variación (%)	33.2%	33.6%
Alertas SG baja/alta (al día)	4.0 / 4.6	4.8 / 5.9
Promedio GS	285 ± 17 mg/dL	218 ± 101 mg/dL
GS/Calibración (al día)	0.4 / 0.4	0.9 / 0.8
Dosis diaria total (al día)	48.9 unidades	53.7 unidades
Cantidad de bolus (al día)	27.4U (56%)	32.9U (61%)
Cantidad autocorrección (diaria)	8.7U (32%)	7.6U (23%)
Valor basal/basal automático (al día)	21.5U (44%)	20.8U (39%)
Cambio de eq. infusión/reservorio	2.2 / 2.2 días	2.6 / 1.9 días
HC introducidos/comida (al día)	171 ± 82 g / 5.7	249 ± 124 g / 7.4
Dur. insulina activa	3:00 h	3:00 h
Basal manual programado de 24 h ⁴	44.400U	44.400U
Objetivo de SmartGuard	100 mg/dL	100 mg/dL

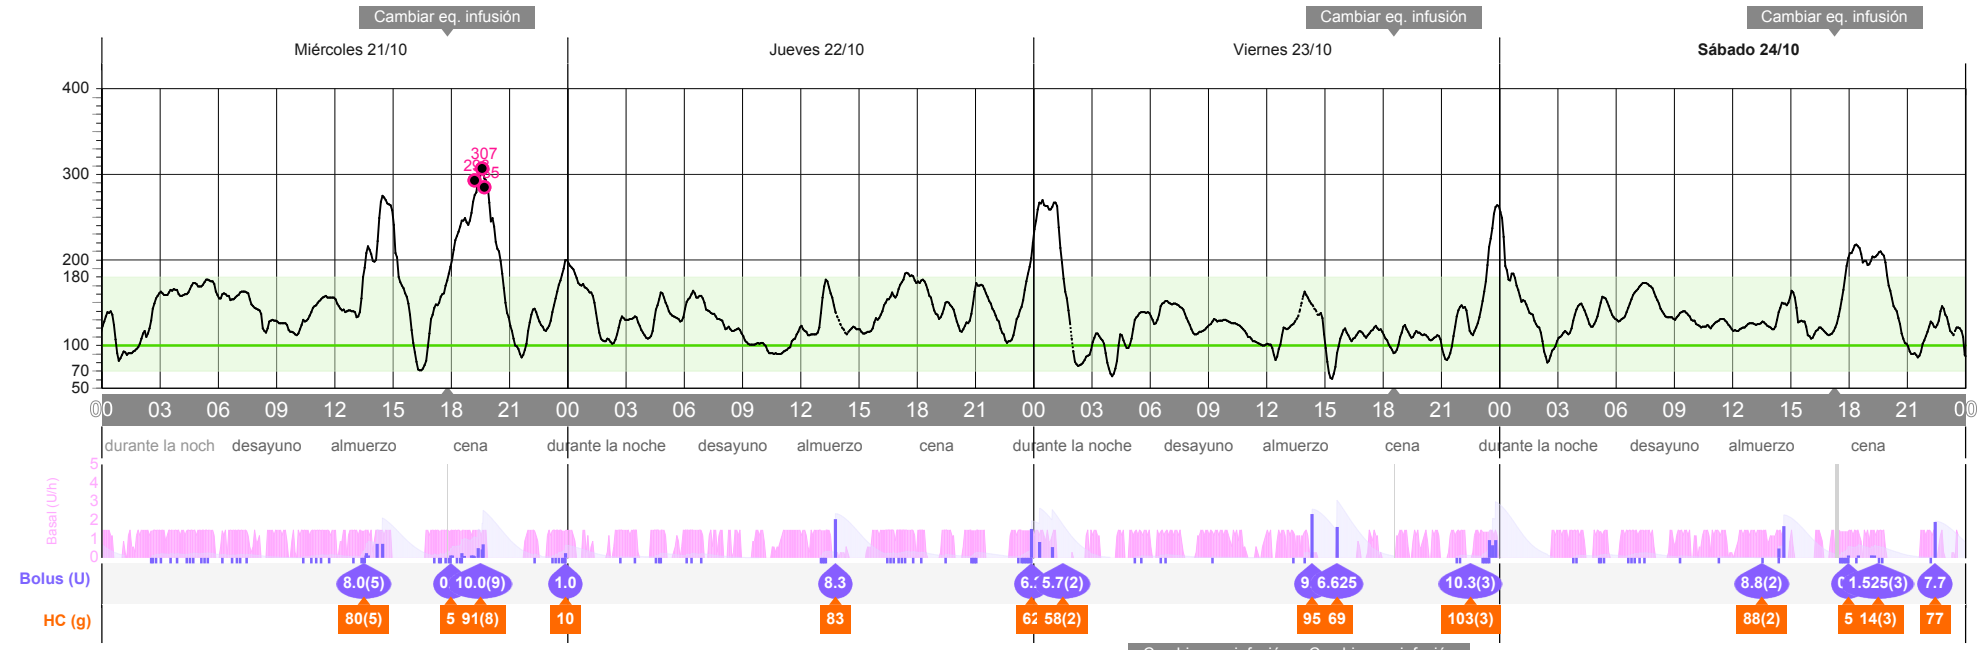


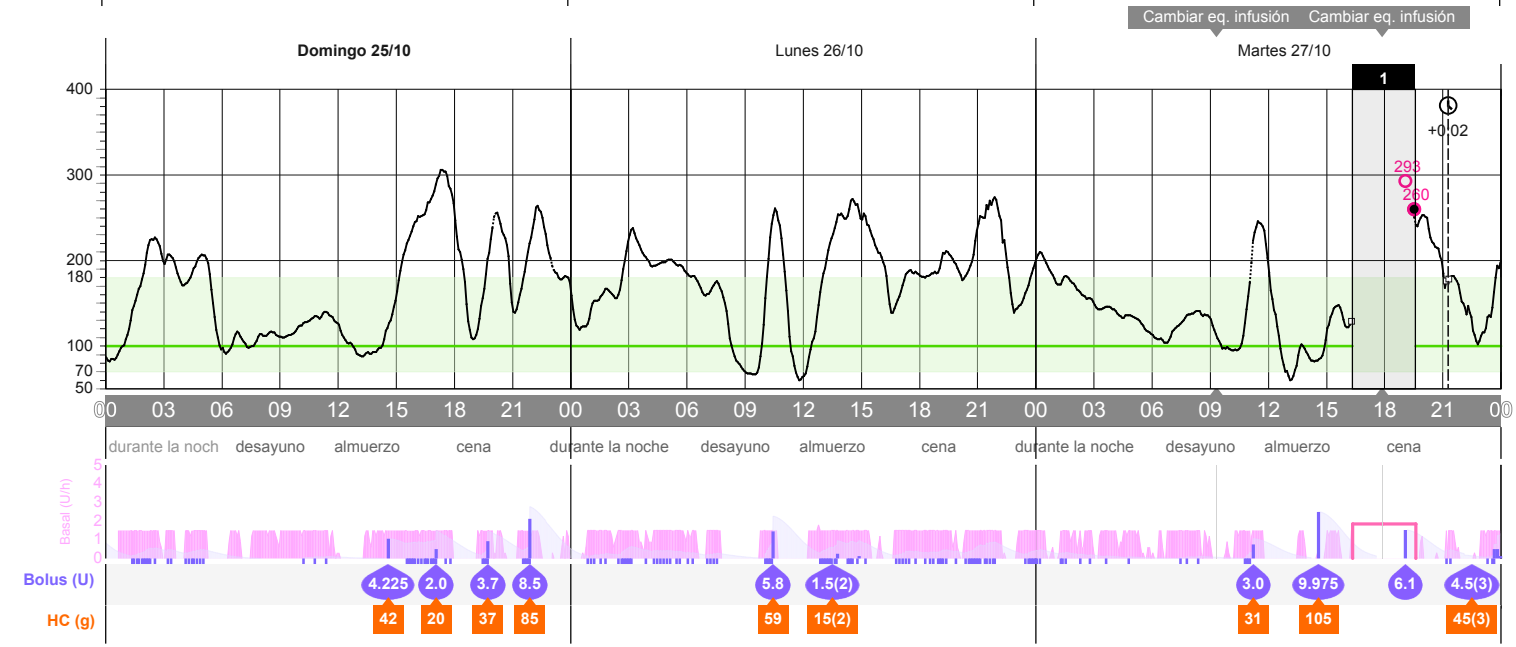


Detalles sobre la razón de la finalización

1 - SmartGuard desactivada por el usuario
Los ajustes de SmartGuard se desactivaron.

Glucosa en sangre
Calibración
Autobasal
Basal
Susp. límite bajo
Susp. antes de límite bajo
Autocorrección + Insulina activa
Bolus + Insulina activa
Modo Manual
Suspen. manual
Objetivo + objet. temp.
Cambio de hora
Retr. rec. sensor

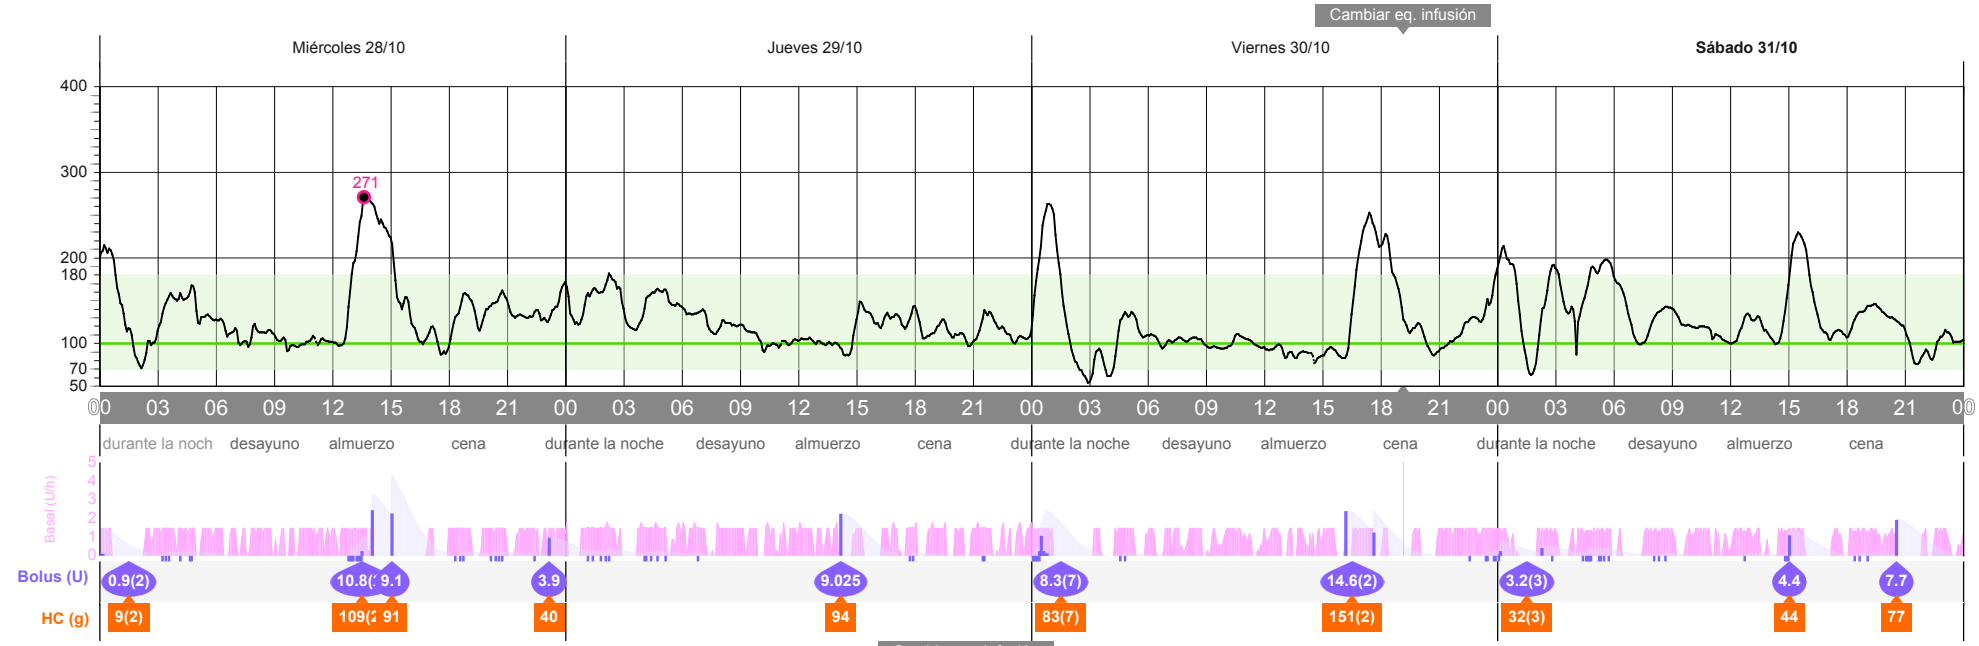

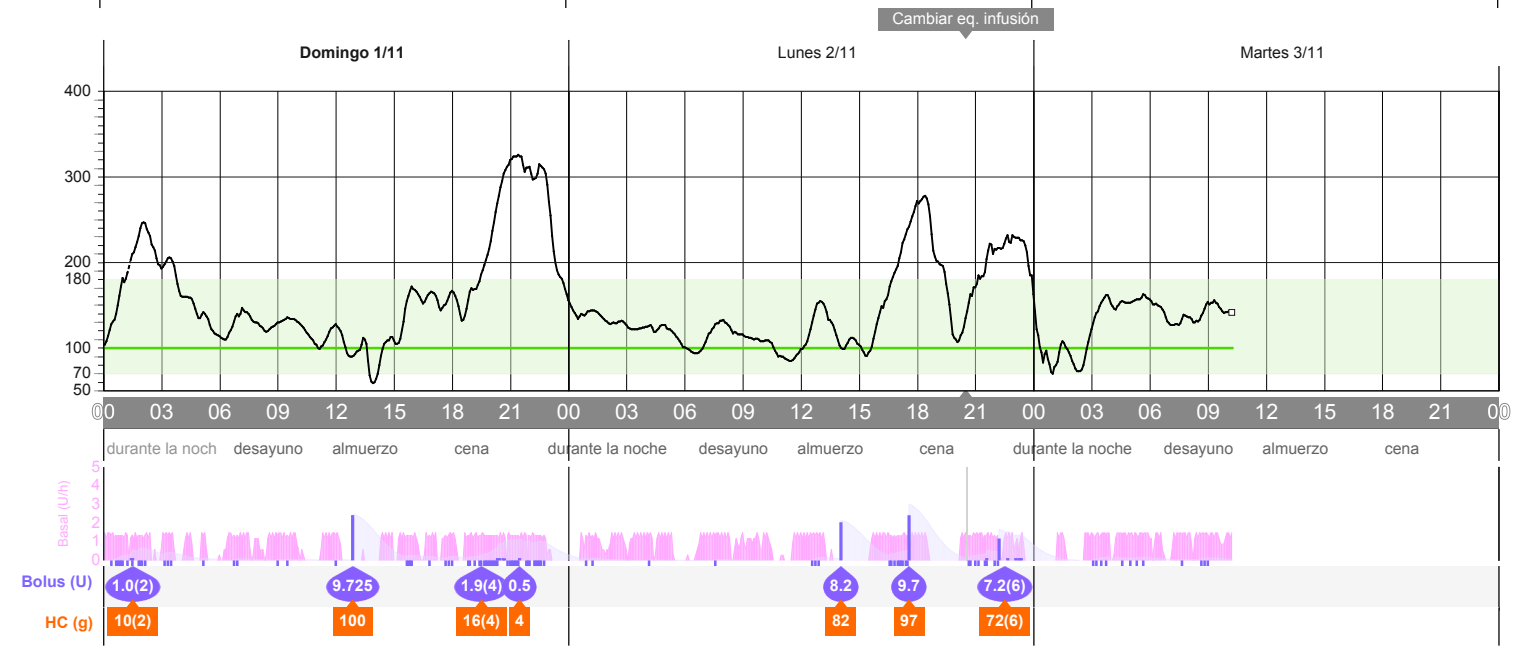


Detalles sobre la razón de la finalización

Glucosa en sangre
Calibración
Autobasal
Basal
Susp. límite bajo
Susp. antes de límite bajo
Autocorrección + Insulina activa
Bolus + Insulina activa
Modo Manual
Suspen. manual
Objetivo + objet. temp.
Cambio de hora
Retr. rec. sensor

Todos los bolus de comida

Desayuno - Todos los bolus

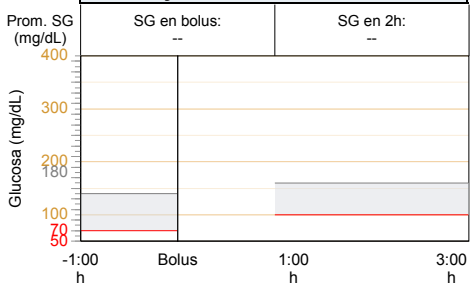


Estad.	
Hora	06:00 - 10:00
Recuento de bolus	0
Ratio de HC (g/U)	10.0
Prom. HC (g)	--
Prom. bolus (U)	--

Desayuno - Comidas analizadas

Observaciones

Almuerzo - Todos los bolus

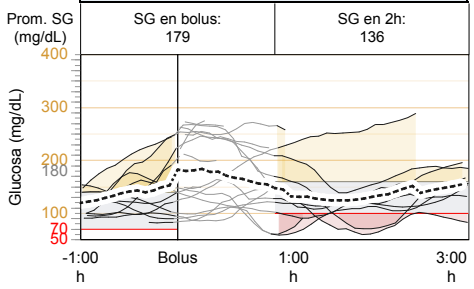


Estad.	
Hora	11:00 - 15:00
Recuento de bolus	19
Ratio de HC (g/U)	10.0
Prom. HC (g)	49 ± 39
Prom. bolus (U)	4.9 ± 3.9

Almuerzo - Comidas analizadas

Observaciones

Cena - Todos los bolus

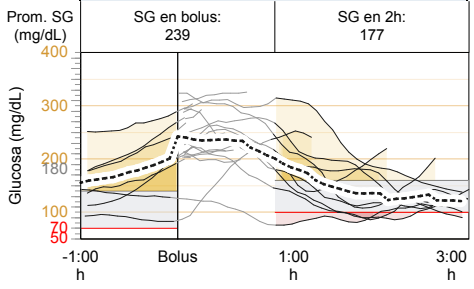


Estad.	
Hora	16:00 - 22:00
Recuento de bolus	26
Ratio de HC (g/U)	10.0
Prom. HC (g)	23 ± 31
Prom. bolus (U)	2.3 ± 3.1

Cena - Comidas analizadas

Observaciones

Durante la noche - Todos los bol

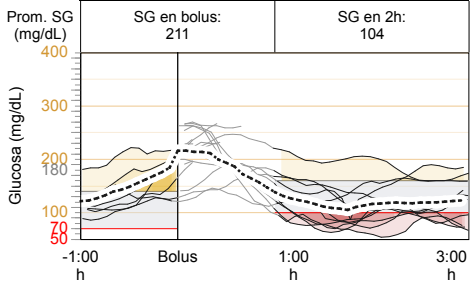

Estad.	
Hora	22:00 - 06:00
Recuento de bolus	31
Ratio de HC (g/U)	10.0
Prom. HC (g)	19 ± 19
Prom. bolus (U)	1.9 ± 1.9


Durante la noche - Comidas analiz

Observaciones

	Mediciones de glucosa		Eventos de bolus					Eventos de llenado					
	Lecturas de GS	Duración del sensor (h:mm)	Bolus manuales	Eventos de Bolus Wizard	Con comida	Con corrección	Anulado	Rebobinar	Llenados de cánula	Cantidad en cánula (U)	Llenados de tubo	Cantidad en tubo (U)	Duración de la susp. (h:mm)
Miércoles 21/10/26	3	24:00		16	15	2		1	1	1	1	14.4	0:03
Jueves 22/10/26		24:00		2	2								
Viernes 23/10/26		24:00		7	7	3		1					0:03
Sábado 24/10/26		24:00		7	7	1		1	1	1	1	14.2	0:12
Domingo 25/10/26		24:00		4	4	1							
Lunes 26/10/26		24:00		3	3	1							
Martes 27/10/26	2	20:55		6	5	3		2	1	1	1	15.2	0:05
Miércoles 28/10/26	1	24:00		6	6	2							
Jueves 29/10/26		24:00		1	1	1							
Viernes 30/10/26		24:00		9	9	1		1	1	1	1	14.4	0:03
Sábado 31/10/26		24:00		5	5								
Domingo 1/11/26		24:00		8	8	4							
Lunes 2/11/26		24:00		8	8			1	1	1	1	15.3	0:05
Martes 3/11/26		10:15											
Resumen	0.4/día	13d 07h 10m	0.0/día	5.9/día	97.6%	23.2%	0%	7	5	1U /llenado	5	14.7U /llenado	31m

Día parcial Suspender Susp. límite bajo Suspensión antes de límite bajo

Superposición de glucosa del medidor durante 24 horas: lecturas y promedios (mg/dL)

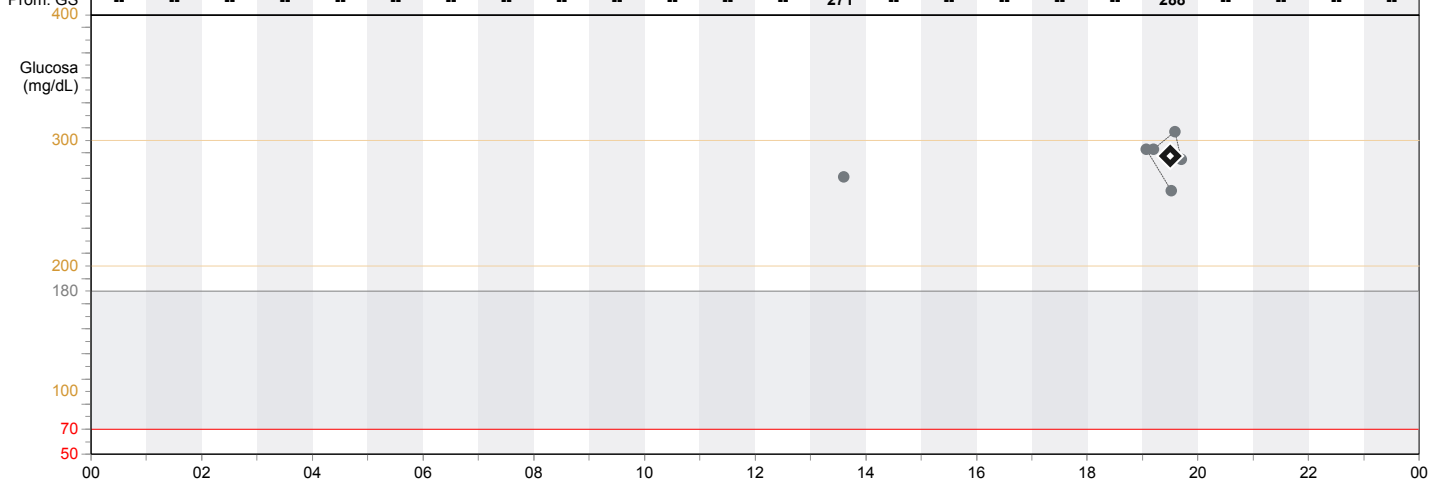

Estadísticas	21/10 - 3/11	
Prom. GS (mg/dL)	285 ± 17	
Lecturas de GS	6	0.4/día
Lecturas por encima del rango objetivo	6	100%
Lecturas por debajo del rango objetivo	--	0%

Prom. HC diarios (g)	*171 ± 82*	
HC/Insulina en bolus (g/U)	6.7	

Prom. insulina diaria total (U)	48.9 ± 6.5	
Basal diaria media (U)	21.5	44%
En bolus diaria media (U)	27.4	56%

Períodos de superposición de glucosa del medidor nocturno y de comidas: lecturas y promedios (mg/dL)


Período nocturno
Hora de acostarse: 20:00 - 00:00
Hora de levantarse: 05:00 - 09:00

Desayuno: 06:00 - 10:00
Comidas analizadas: 0
Prom. HC: --
Prom. insulina: --
Prom. HC/insulina: --

Almuerzo: 11:00 - 15:00
Comidas analizadas: 1
Prom. HC: *10g*
Prom. insulina: 1.0U
Prom. HC/insulina: 10.0g/U

Cena: 16:00 - 22:00
Comidas analizadas: 3
Prom. HC: *16g*
Prom. insulina: 1.8U
Prom. HC/insulina: 8.9g/U

Durante la noche: 22:00 - 06:00
Comidas analizadas: 0
Prom. HC: --
Prom. insulina: --
Prom. HC/insulina: --

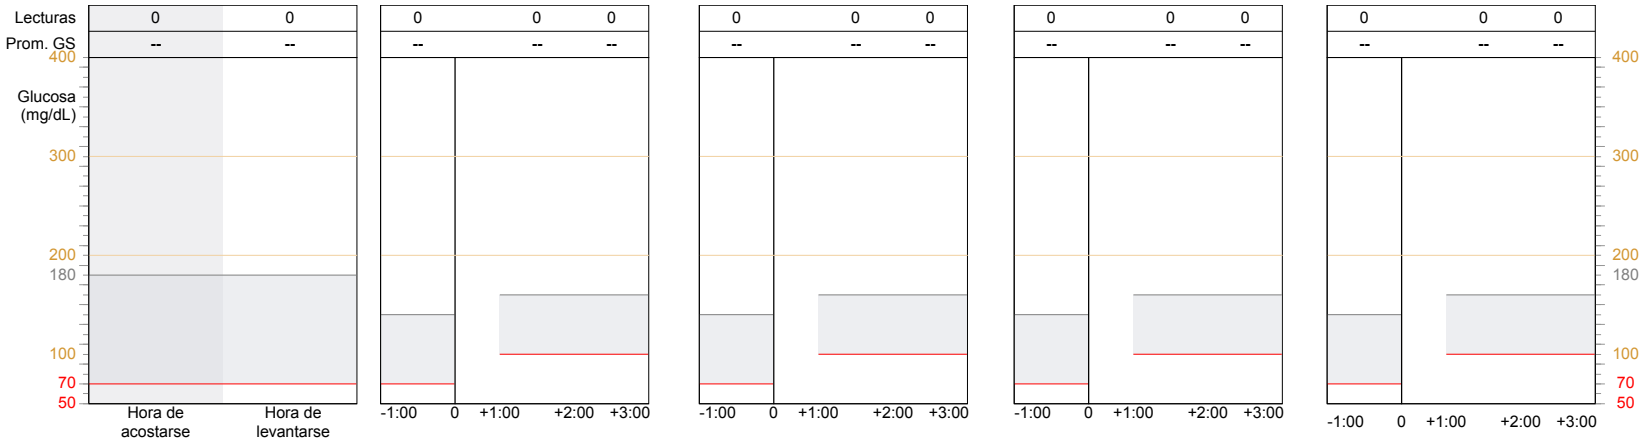

Lectura de GS Lectura de GS Fuera del gráfico Promedio dentro del rango objetivo Promedio fuera del rango objetivo

	Durante la noche						Desayuno				Almuerzo						Cena						Durante la noc		Totales diarios
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Miércoles 21/10/26				0.786	0.486	0.586	0.461	0.461	0.308		0.458	0.436	0.154	20 3.41	60 6.00				5 2.17	19 2.79	307° 72 8.10			0.279	10 2.72	**Promedio (3):** 295mg/dL **HC:** *186g* **Insulina:** 54.6U **Bolus:** 54%
Jueves 22/10/26			0.177	0.177	0.856		0.856							83 9.71			0.931	0.833	0.202	0.402	0.831	0.202		62 7.99	**Promedio (0):** -- **HC:** *145g* **Insulina:** 44.3U **Bolus:** 52%
Viernes 23/10/26	58 5.70					0.442	0.517			0.158				1.14	95 9.40	69 6.63						0.567		103 12.2	**Promedio (0):** -- **HC:** *325g* **Insulina:** 55.6U **Bolus:** 66%
Sábado 24/10/26				0.563		0.519	0.769	0.388		0.256		0.181		0.156	88 9.18			5 2.49	5 0.756	9 1.31			77 7.86		**Promedio (0):** -- **HC:** *184g* **Insulina:** 43.4U **Bolus:** 56%
Domingo 25/10/26		1.51	1.23	0.602	1.66	0.151					0.377	0.151			42 4.23	1.36	2.63	20 2.78		37 5.43		85 10.1			**Promedio (0):** -- **HC:** *184g* **Insulina:** 55.7U **Bolus:** 58%
Lunes 26/10/26	0.174	1.02	1.90	0.623	1.20	0.548	0.374	0.798			59 9.15		0.649	10 3.47	5 2.00	0.199	0.574	1.17	0.848	1.07	2.05	2.30		1.42	**Promedio (0):** -- **HC:** *74g* **Insulina:** 56.2U **Bolus:** 56%
Martes 27/10/26	0.452	0.678	0.402	0.176	0.176			0.352	0.151		0.878	31 3.40			105 9.98					293° 6.10				45 5.40	**Promedio (2):** 277mg/dL **HC:** *181g* **Insulina:** 51.2U **Bolus:** 57%
Miércoles 28/10/26	9 0.900			0.832	0.632								1.53	271 10 2.74	99 9.80	91 9.10			0.907		0.684		0.202	40 3.90	**Promedio (1):** 271mg/dL **HC:** *249g* **Insulina:** 52.7U **Bolus:** 59%
Jueves 29/10/26		0.641	0.944		0.914	0.172	0.172								94 9.03			0.544				0.419			**Promedio (0):** -- **HC:** *94g* **Insulina:** 36.0U **Bolus:** 36%
Viernes 30/10/26	83 10.1				0.379												101 9.60	50 5.00					0.227	1.26	**Promedio (0):** -- **HC:** *234g* **Insulina:** 46.6U **Bolus:** 57%
Sábado 31/10/26	15 1.88		17 2.08		1.27	0.688			0.454				0.310		1.08	44 4.40			0.394	0.135	77 7.70				**Promedio (0):** -- **HC:** *153g* **Insulina:** 39.7U **Bolus:** 51%
Domingo 1/11/26	1.19	10 2.08	0.186	1.01		0.161	0.348		0.136	0.161	0.136	100 9.73				1.10	0.136	0.609	0.423	1.62	16 3.94	4 2.34	1.94		**Promedio (0):** -- **HC:** *130g* **Insulina:** 48.5U **Bolus:** 56%
Lunes 2/11/26	0.187	0.187			0.112			0.187					0.661		82 8.20		1.32	97 11.0			1.14	5 1.55	52 5.36	15 1.50	**Promedio (0):** -- **HC:** *251g* **Insulina:** 51.6U **Bolus:** 61%
Martes 3/11/26				0.830	0.265	0.415		0.182	0.497																**Promedio (0):** -- **HC:** -- **Insulina:** -- **Bolus:** --

>180mg/dL
<70mg/dL
00° Varias lecturas (se muestra la más extrema)
Bolus manual o bolus con corrección
Suspender
Susp. activada por sensor
Día parcial
Reb. de bomba
Cambio de hora
Comida omitida

Índice basal

Índice basal máximo	2.00 U/h		Actuali.

Basal 1 (activo)

Total 24 horas	44.400 U	

Hora	U/h	
00:00	1.85	

Basal 2

Total 24 horas	--	

Hora	U/h	
--	--	

Basal 3

Total 24 horas	--	

Hora	U/h	
--	--	

Bolus

Bolus Wizard	ON
Unidades	g, mg/dL
Duración ins. activa (h:mm)	3:00
Bolus máximo	15.0 U

Easy Bolus	OFF
Incremento bolus	0.025 U
Velocidad de bolus	Rápida
Dual/Cuadrado	OFF/OFF

Ratio de HC (g/U)

Hora	Ratio	
0:00	10.0	

Sensibil. a la ins. (mg/dL por U)

Hora	Sensibil.	
0:00	30	

Objetivo de gluc. en sangre (mg/dL)

Hora	Baja	Alta	
0:00	90	110	

Bolus predefinido

Nombre	Normal	Cuadr.	Actuali.
Bolus 1			
Desayuno			
Cena			
Almuerzo			
Tentempié			
Bolus 2			
Bolus 3			
Bolus 4			

Temp predefinido

Nombre	Frecuenc.	Duración	
Actividad intensa			
Actividad media			
Actividad baja			
Enfermedad			

Nombre	Frecuenc.	Duración	
Temp 1			
Temp 2			
Temp 3			
Temp 4			

SmartGuard

SmartGuard	ON
Objetivo	100 mg/dL
Autocorrección	ON

Alertas alta

ON (Recordar en 1:00)

Hora inicio	Alto (mg/dL)	Alerta en límite alto	Aler. antes de lím. alto	Límite alerta ascenso (mg/dL)
0:00	200	x	x	^

Alertas baja

ON (Recordar en 0:20)

Hora inicio	Bajo (mg/dL)	Suspen.	Alerta en límite bajo	Aler. antes bajo	Reanu. alerta basal
0:00	70	Ant. bajo	x	x	x

Sensor

Sensor	ON

Aviso de calibración	OFF
Hora de aviso de calibración	OFF

Notas

Basal (Continuado)

Basal 4

Total 24 horas	--

Hora	U/h
--	--

Basal 5

Total 24 horas	--

Hora	U/h
--	--

Laborable

Total 24 horas	--

Hora	U/h
--	--

Festivo

Total 24 horas	--

Hora	U/h
--	--

Enfermedad

Total 24 horas	--

Hora	U/h
--	--

Avisos

Adver. reservorio bajo	Unidades insul.
Cantidad	20 U
Medir GS tras bolus	OFF
Cambiar eq. infusión	3 días

Bolus omitido (comidas)

Nombre	Inicio	Fin
Comida 1	OFF	OFF
Comida 2	OFF	OFF
Comida 3	OFF	OFF
Comida 4	OFF	OFF
Comida 5	OFF	OFF
Comida 6	OFF	OFF
Comida 7	OFF	OFF
Comida 8	OFF	OFF

Avisos personales


Nombre	Hora
Aviso 1	OFF
Aviso 2	OFF
Aviso 3	OFF
Aviso 4	OFF
Aviso 5	OFF
Aviso 6	OFF
Medir GS	OFF
Medicación	OFF

Utilidades

Modo de bloqueo	OFF
Formato hora	12 h
Brillo	Auto
Tiempo espera de luz de fondo	15 s
Opciones de audio	Audio y vibrac.
Volumen alarma	5
Autoapagado	OFF


Miércoles 21/10

DDT 54.6 U | Basal total 46 % | 25.0 U | Bolus total 54 % | 29.6 U { Bolus 66 % | 19.5 u + Autocorrección 34 % | 10.1 u

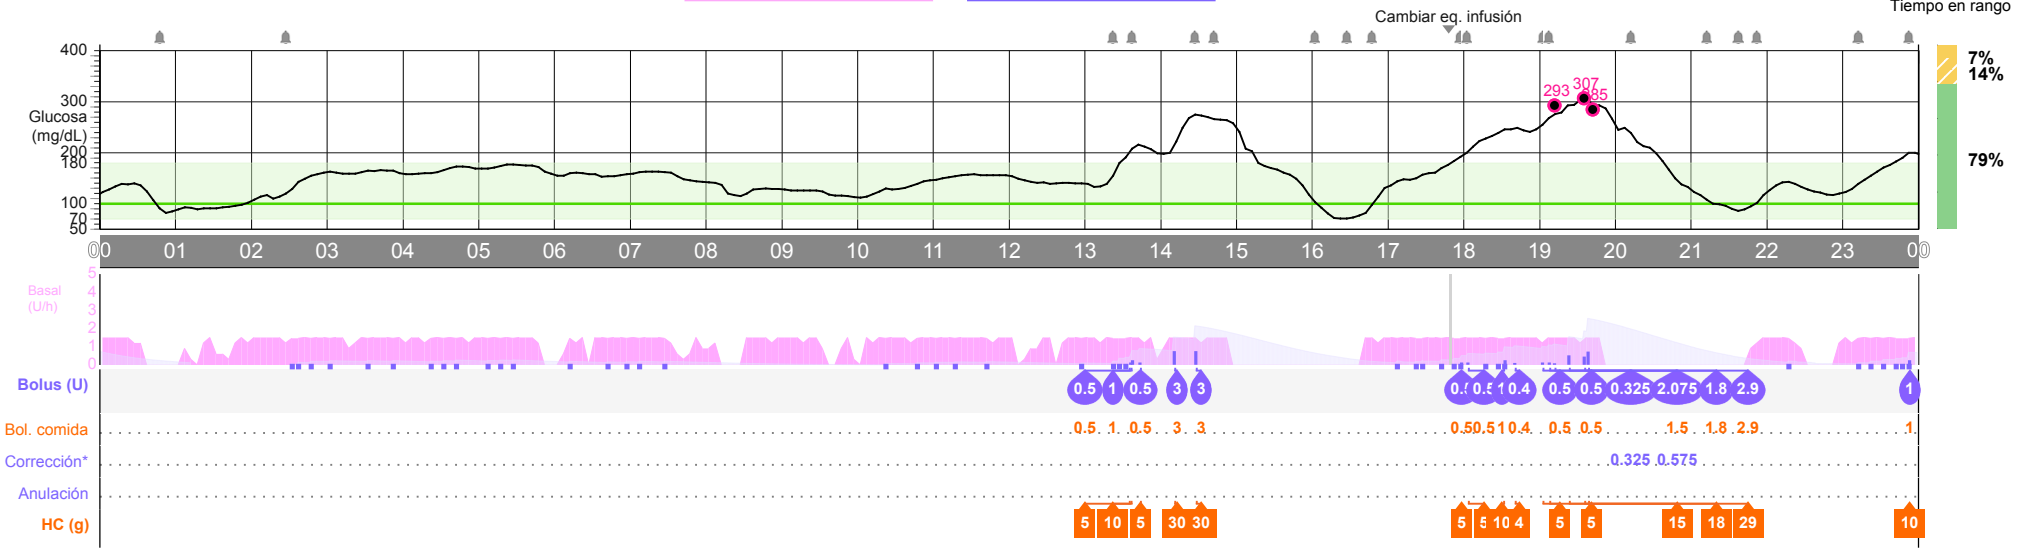

Jueves 22/10

DDT 44.3 U | Basal total 48 % | 21.1 U | Bolus total 52 % | 23.2 U { Bolus 63 % | 14.5 u + Autocorrección 38 % | 10.1 u

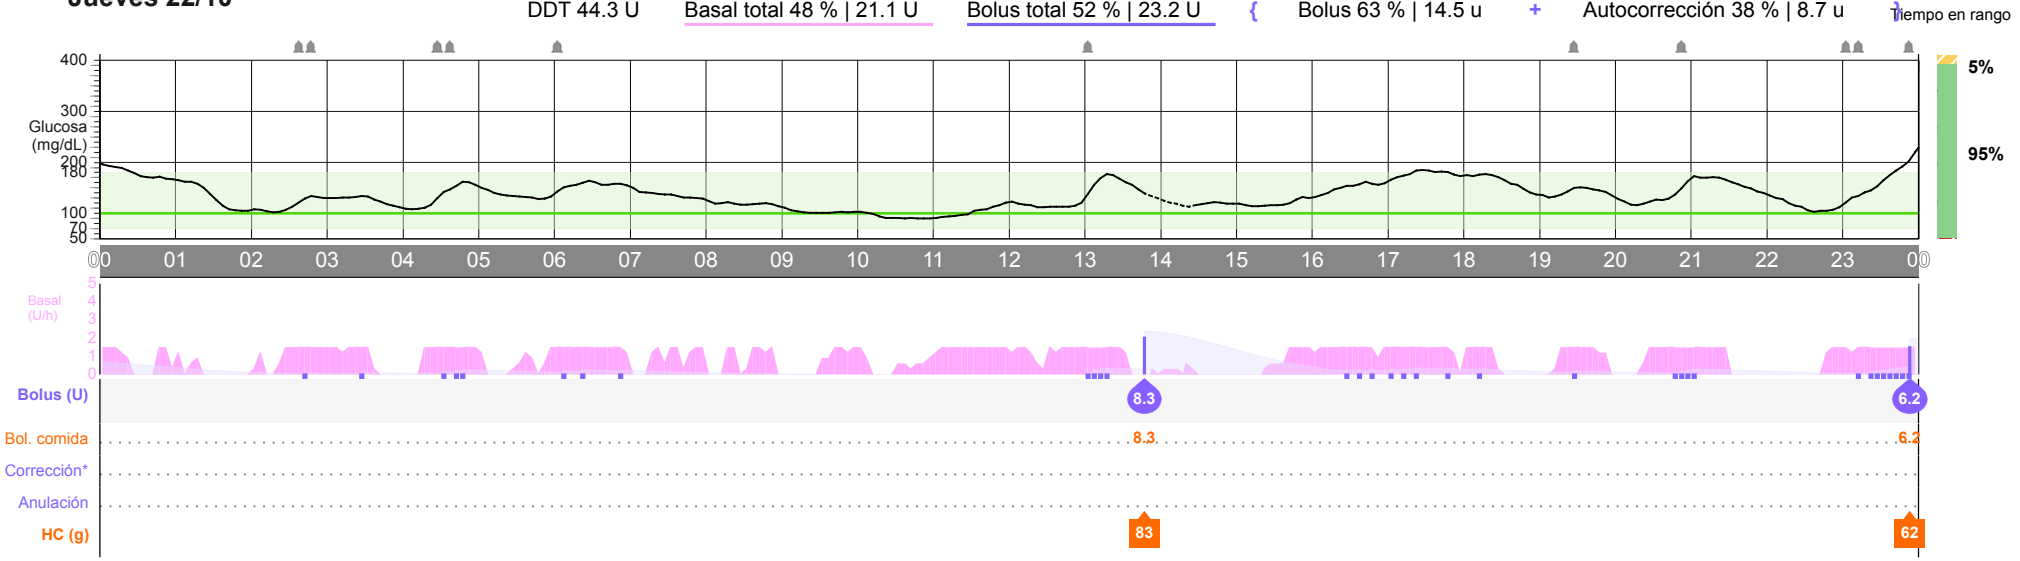


*Insulina activa considerada. SmartGuard también considera el ajuste de bolus de SmartGuard.

Glucosa sangre | Calibración | Autobasal | Susp. límite bajo | Basal | Susp. antes lím. bajo | Basal temporal | Alertas | Autocorrección + Insulina activa | Retr. rec. sensor | Bolus + Insulina activa | Objetivo + objet. temp. | Cambio de hora | Fuera gráfico | Modo Manual | Suspensión manual | Tiempo en rango (mg/dL) 54 70 180 250


Viernes 23/10

DDT 55.6 U | Basal total 34 % | 18.8 U | Bolus total 66 % | 36.8 U { Bolus 87 % | 32.1 u + Autocorrección 13 % | 4.7 u }

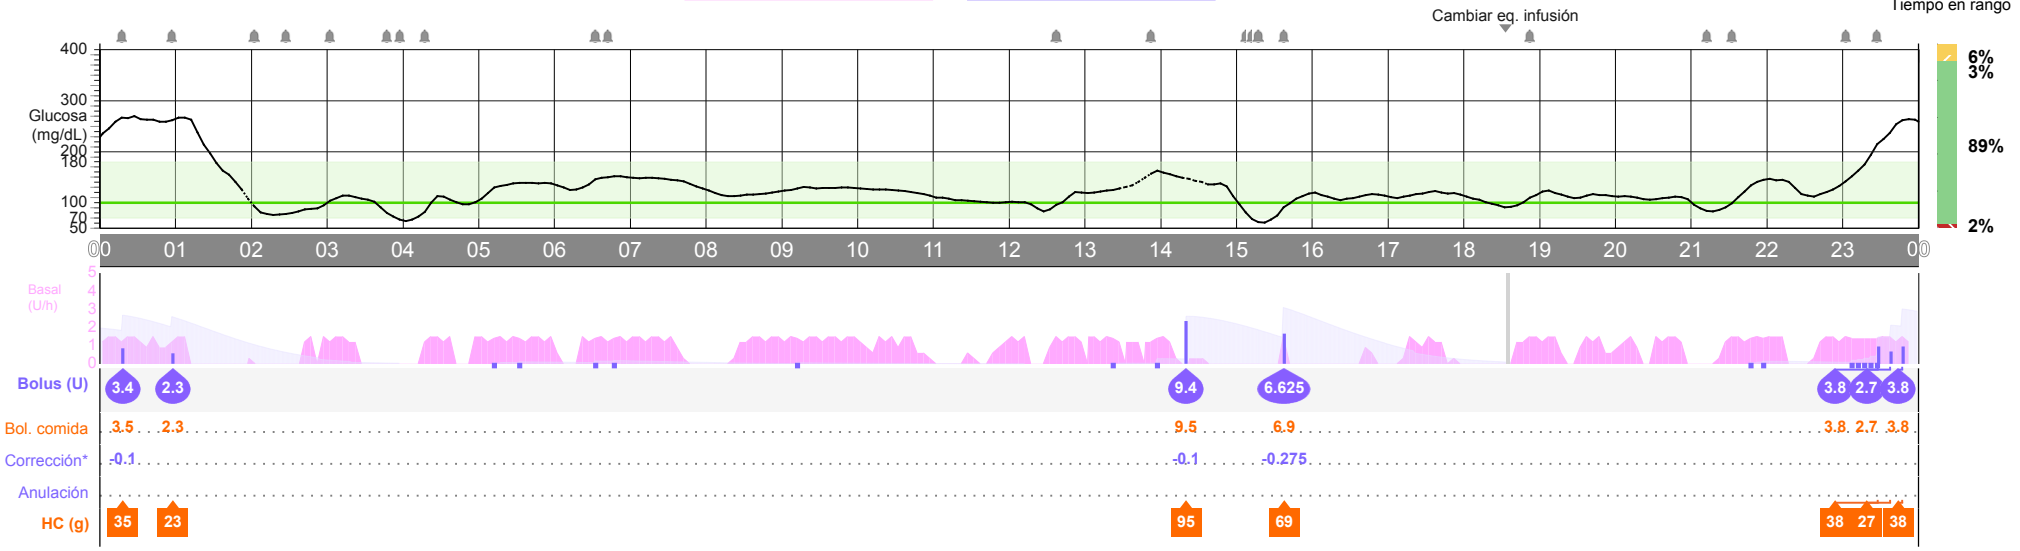

Sábado 24/10

DDT 43.4 U | Basal total 44 % | 19.0 U | Bolus total 56 % | 24.4 U { Bolus 76 % | 18.5 u + Autocorrección 24 % | 5.9 u }

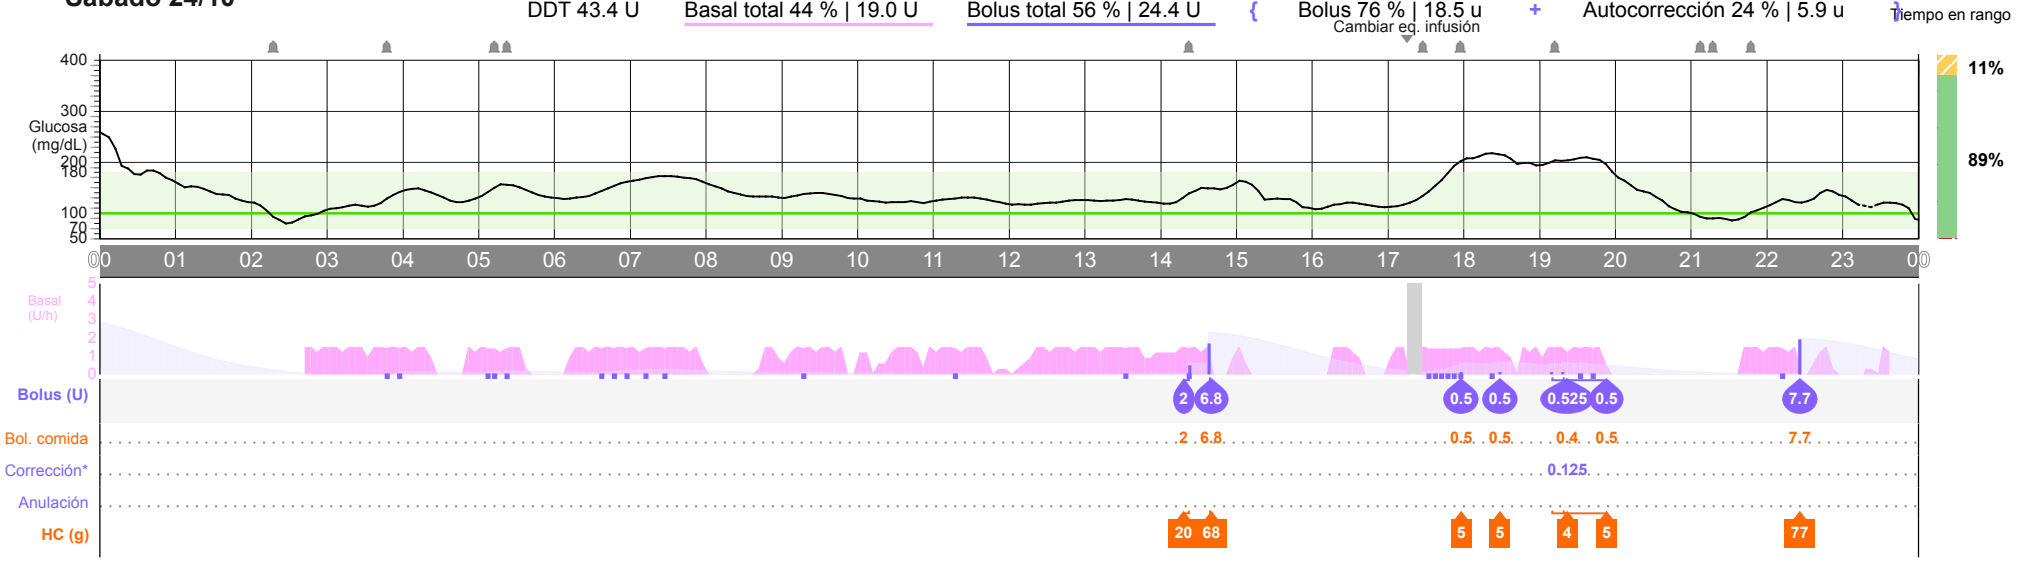


*Insulina activa considerada. SmartGuard también considera el ajuste de bolus de SmartGuard.

Glucosa sangre | Autobasal | Basal | Basal temporal | Autocorrección + Insulina activa | Bolus + Insulina activa | Objetivo + objet. temp. | Cambio de hora | Modo Manual
Calibración | Susp. límite bajo | Susp. antes lím. bajo | Alertas | Retr. rec. sensor | Fuera gráfico | Suspensión manual

Tiempo en rango (mg/dL): 54 70 180 250


Domingo 25/10

DDT 55.7 U | Basal total 42 % | 23.5 U | Bolus total 58 % | 32.2 U | Bolus 57 % | 18.4 u + Autocorrección 43 % | 13.8 u

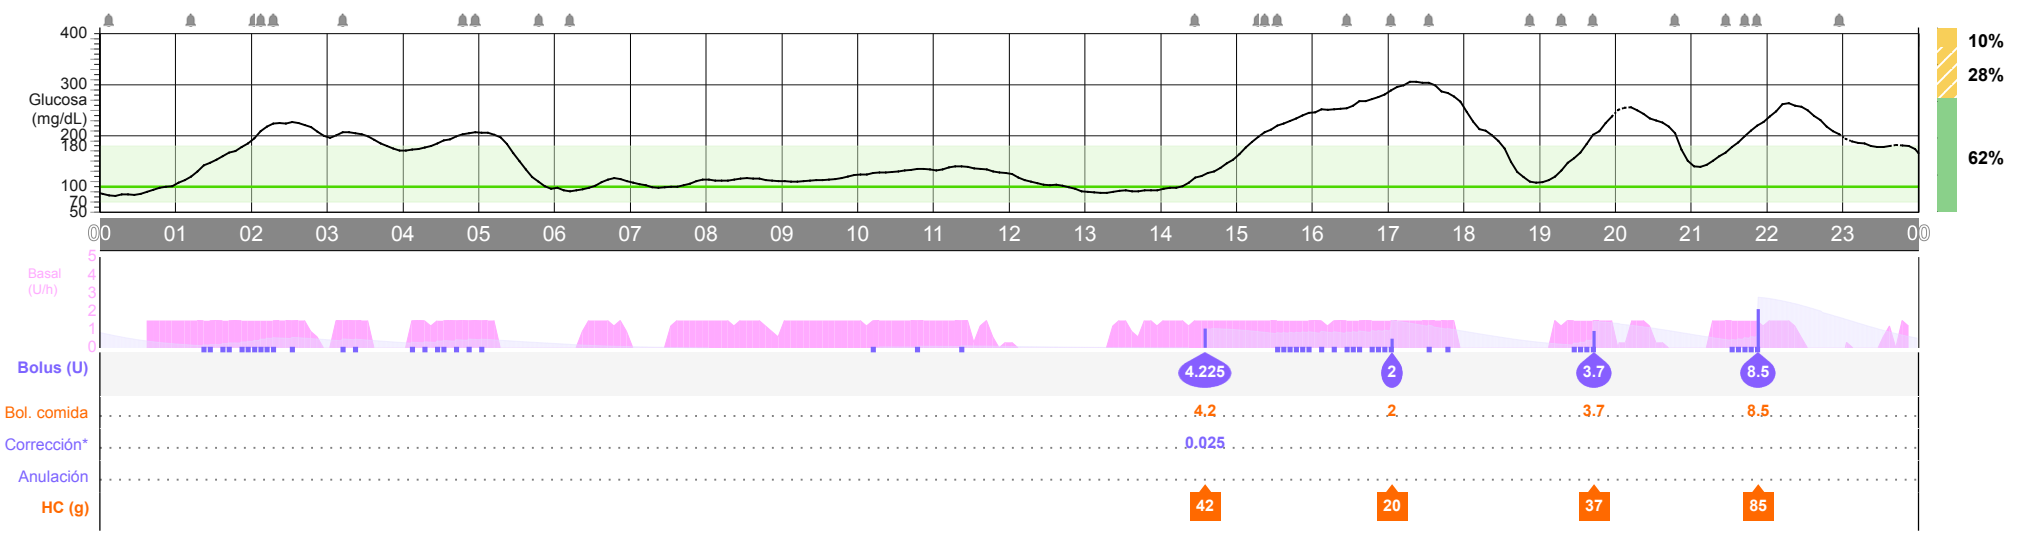

Lunes 26/10

DDT 56.2 U | Basal total 44 % | 24.7 U | Bolus total 56 % | 31.5 U | Bolus 23 % | 7.3 u + Autocorrección 77 % | 24.2 u

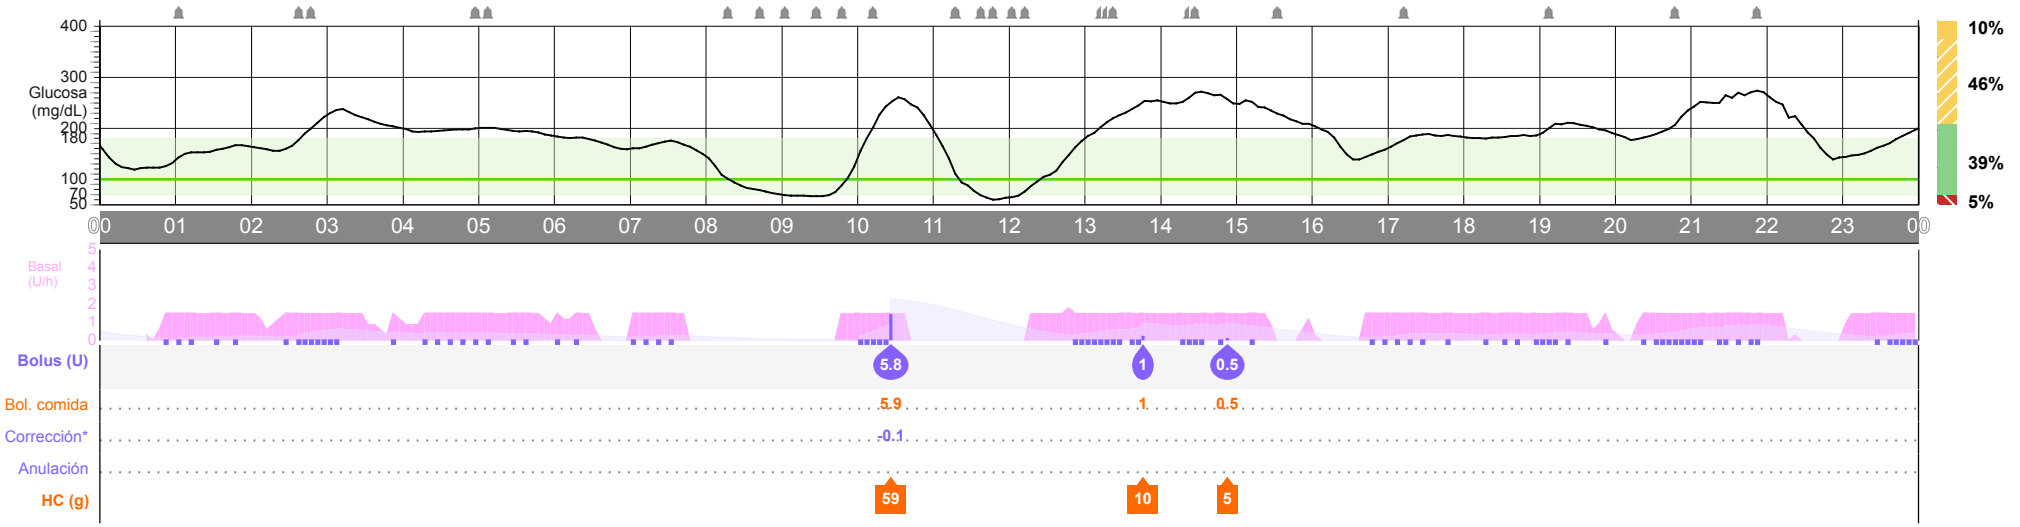


*Insulina activa considerada. SmartGuard también considera el ajuste de bolus de SmartGuard.

Glucosa sangre | Calibración | Autobasal | Susp. límite bajo | Basal | Susp. antes lím. bajo | Basal temporal | Alertas | Autocorrección + Insulina activa | Retr. rec. sensor | Bolus + Insulina activa | Objetivo + objet. temp. | Cambio de hora | Fuera gráfico | Modo Manual | Suspensión manual

Tiempo en rango (mg/dL)
54 70 180 250


Martes 27/10

DDT 51.2 U | Basal total 43 % | 22.1 U | Bolus total 57 % | 29.1 U { Bolus 81 % | 23.6 u + Autocorrección 19 % | 5.5 u }

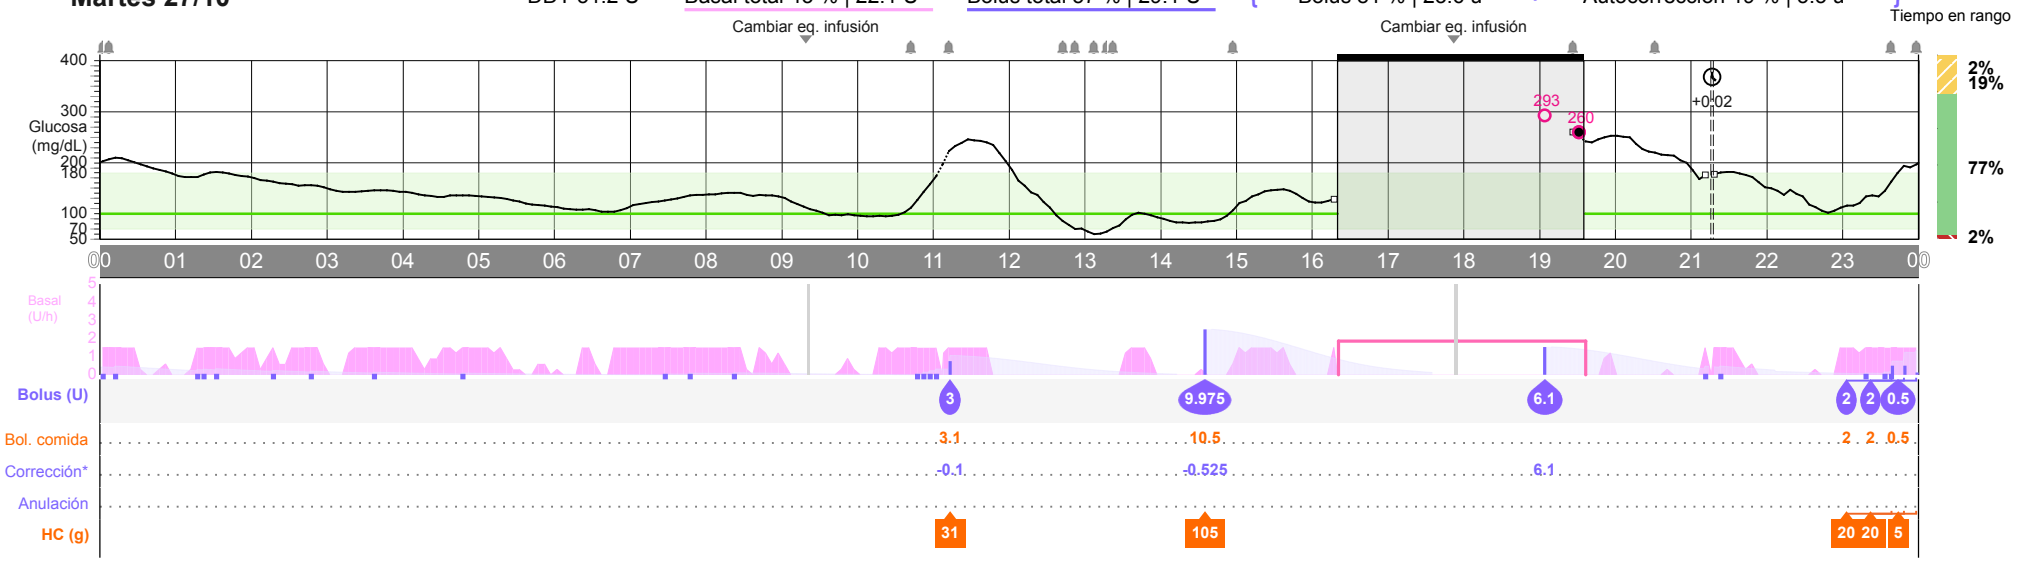

Miércoles 28/10

DDT 52.7 U | Basal total 41 % | 21.5 U | Bolus total 59 % | 31.2 U { Bolus 79 % | 24.7 u + Autocorrección 21 % | 6.5 u }

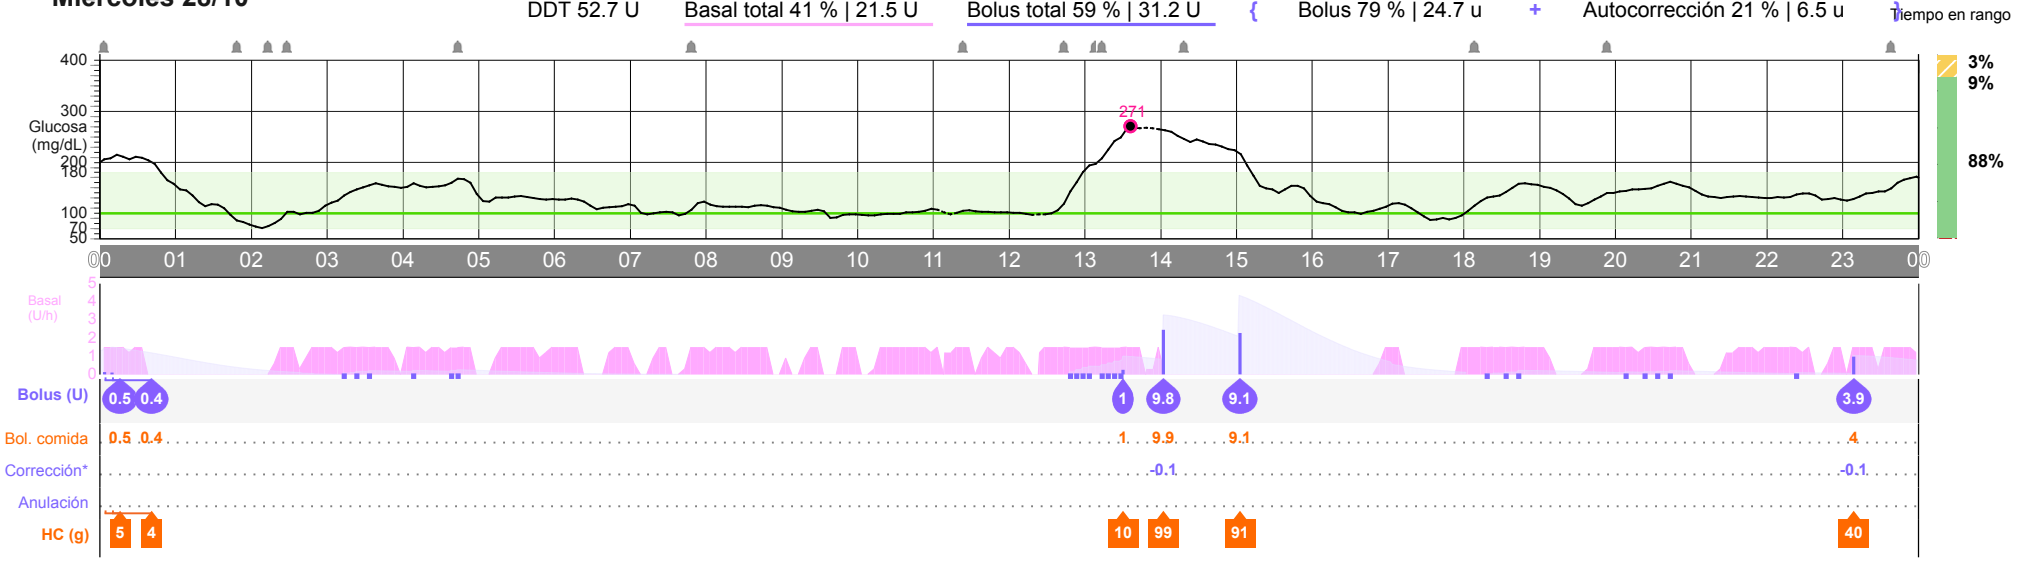


*Insulina activa considerada. SmartGuard también considera el ajuste de bolus de SmartGuard.

Glucosa sangre | Autobasal | Basal | Basal temporal | Autocorrección + Insulina activa | Bolus + Insulina activa | Objetivo + objet. temp. | Cambio de hora | Modo Manual
Calibración | Susp. límite bajo | Susp. antes lím. bajo | Alertas | Retr. rec. sensor | Fuera gráfico | Suspensión manual

Tiempo en rango (mg/dL): 54 70 180 250


Jueves 29/10

DDT 36.0 U | Basal total 64 % | 23.2 U | Bolus total 36 % | 12.8 U { Bolus 70 % | 9.0 u + Autocorrección 30 % | 3.8 u }

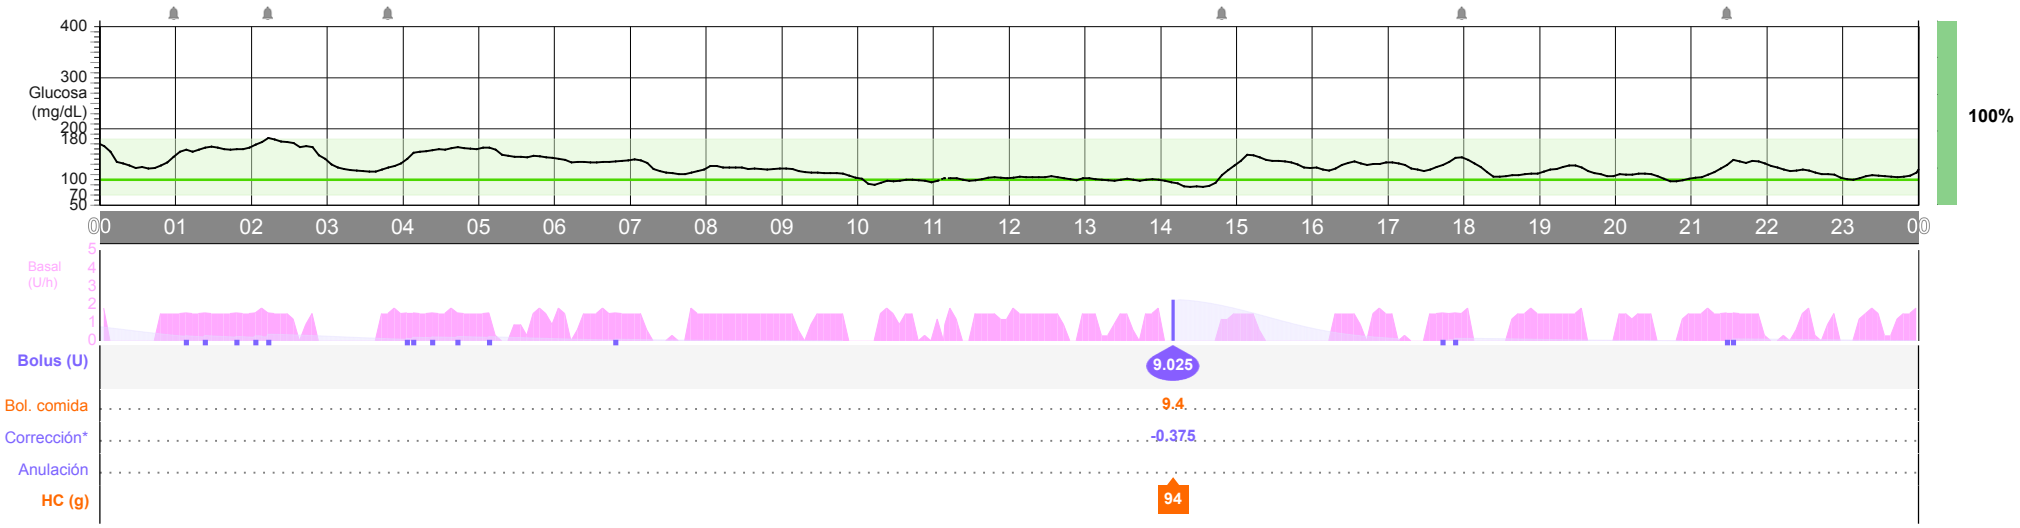

Viernes 30/10

DDT 46.6 U | Basal total 43 % | 20.0 U | Bolus total 57 % | 26.6 U { Bolus 86 % | 22.9 u + Autocorrección 14 % | 3.7 u }

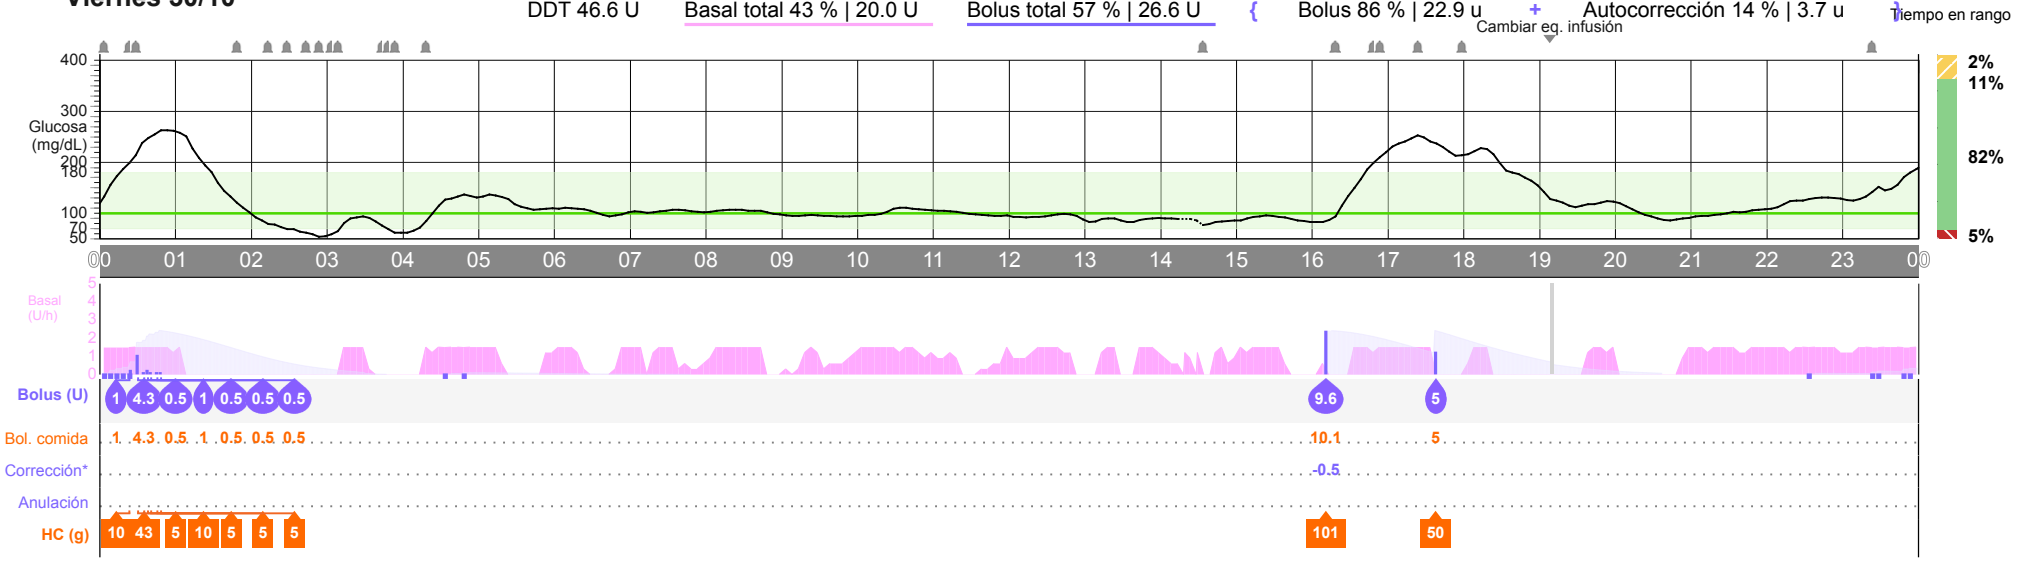


*Insulina activa considerada. SmartGuard también considera el ajuste de bolus de SmartGuard.

Glucosa sangre | Calibración | Autobasal | Susp. límite bajo | Basal | Susp. antes lím. bajo | Basal temporal | Alertas | Autocorrección + Insulina activa | Retr. rec. sensor | Bolus + Insulina activa | Objetivo + objet. temp. | Cambio de hora | Fuera gráfico | Modo Manual | Suspensión manual

Tiempo en rango (mg/dL)
54 70 180 250


Sábado 31/10

DDT 39.7 U | Basal total 49 % | 19.3 U | Bolus total 51 % | 20.4 U { Bolus 75 % | 15.3 u + Autocorrección 25 % | 5.1 u }

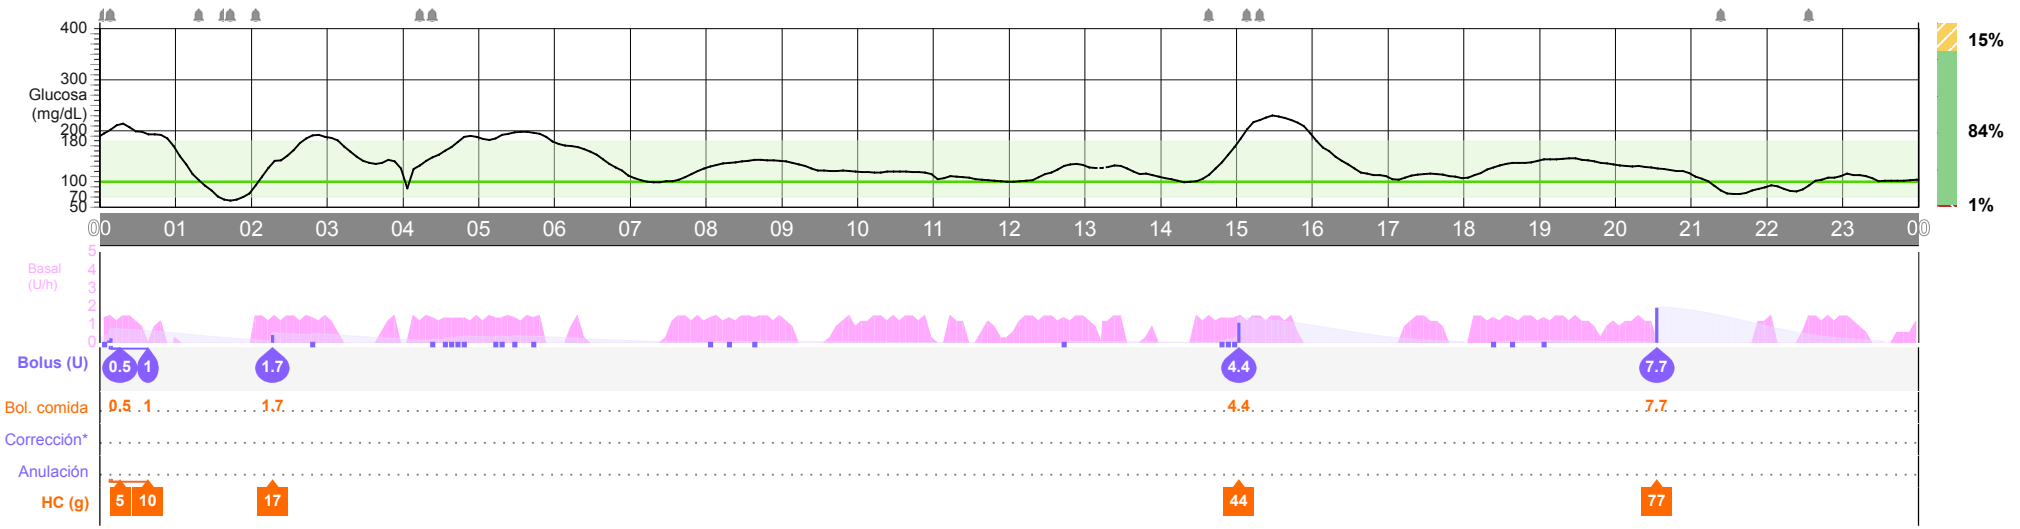

Domingo 1/11

DDT 48.5 U | Basal total 44 % | 21.3 U | Bolus total 56 % | 27.2 U { Bolus 48 % | 13.1 u + Autocorrección 52 % | 14.1 u

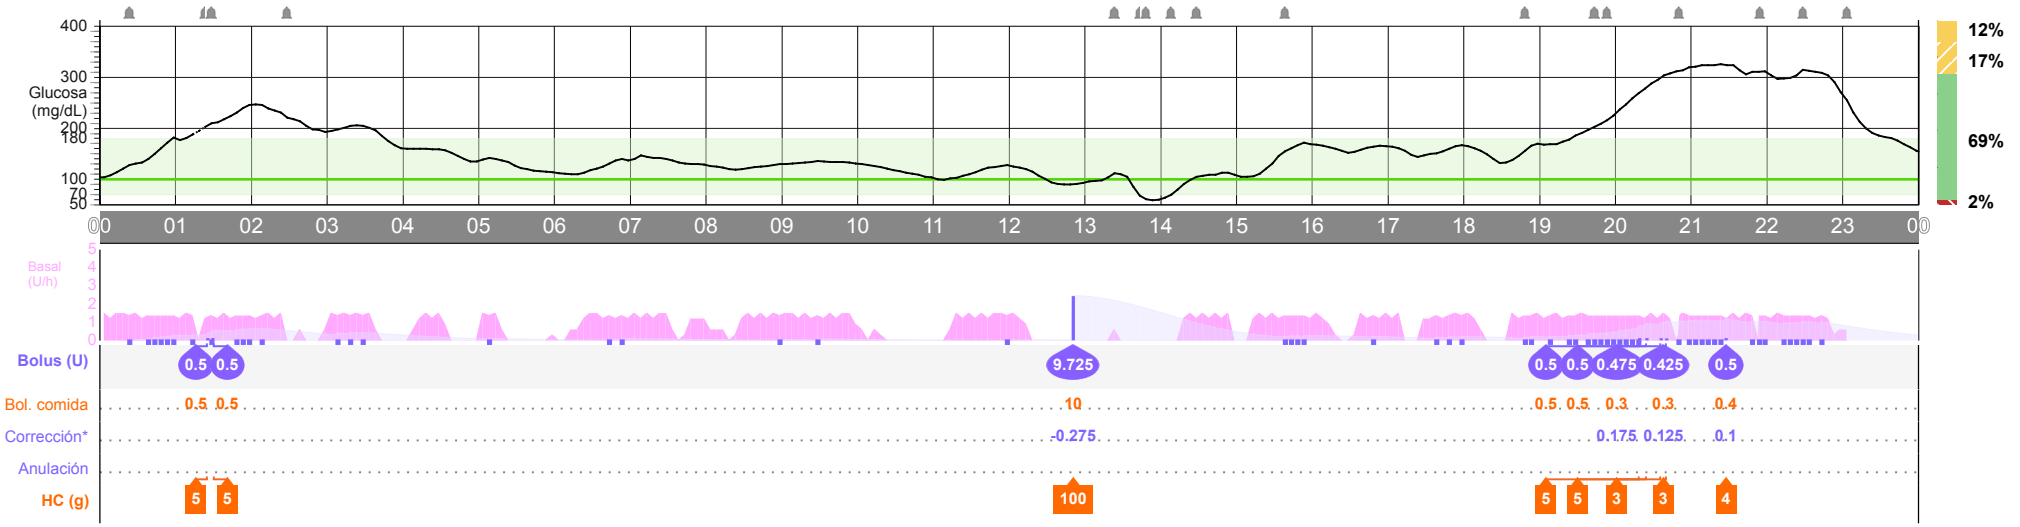


*Insulina activa considerada. SmartGuard también considera el ajuste de bolus de SmartGuard.

Glucosa sangre · Calibración · Autobasal · Susp. límite bajo · Basal · Susp. antes lím. bajo · Basal temporal · Alertas · Autocorrección + Insulina activa · Retr. rec. sensor · Bolus + Insulina activa · Objetivo + objet. temp. · Cambio de hora · Fuera gráfico · Modo Manual · Suspensión manual

Tiempo en rango (mg/dL)
54 70 180 250


Lunes 2/11

DDT 51.6 U | Basal total 39 % | 20.2 U | Bolus total 61 % | 31.4 U { Bolus 80 % | 25.1 u + Autocorrección 20 % | 6.3 u }

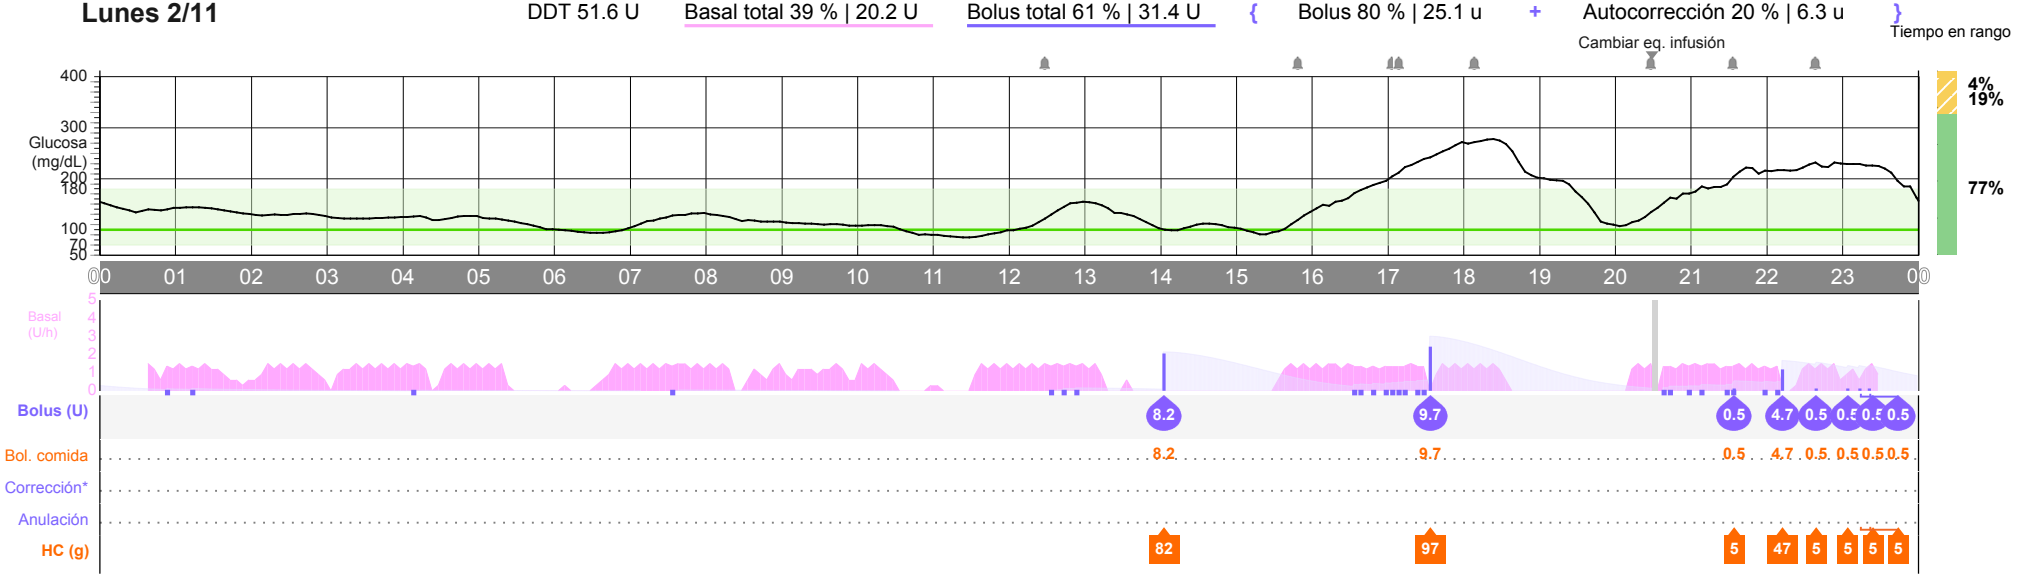

Martes 3/11

DDT -- | Basal total -- | -- | Bolus total -- | 2.2 U { Bolus -- | -- + Autocorrección -- | 2.2 u }

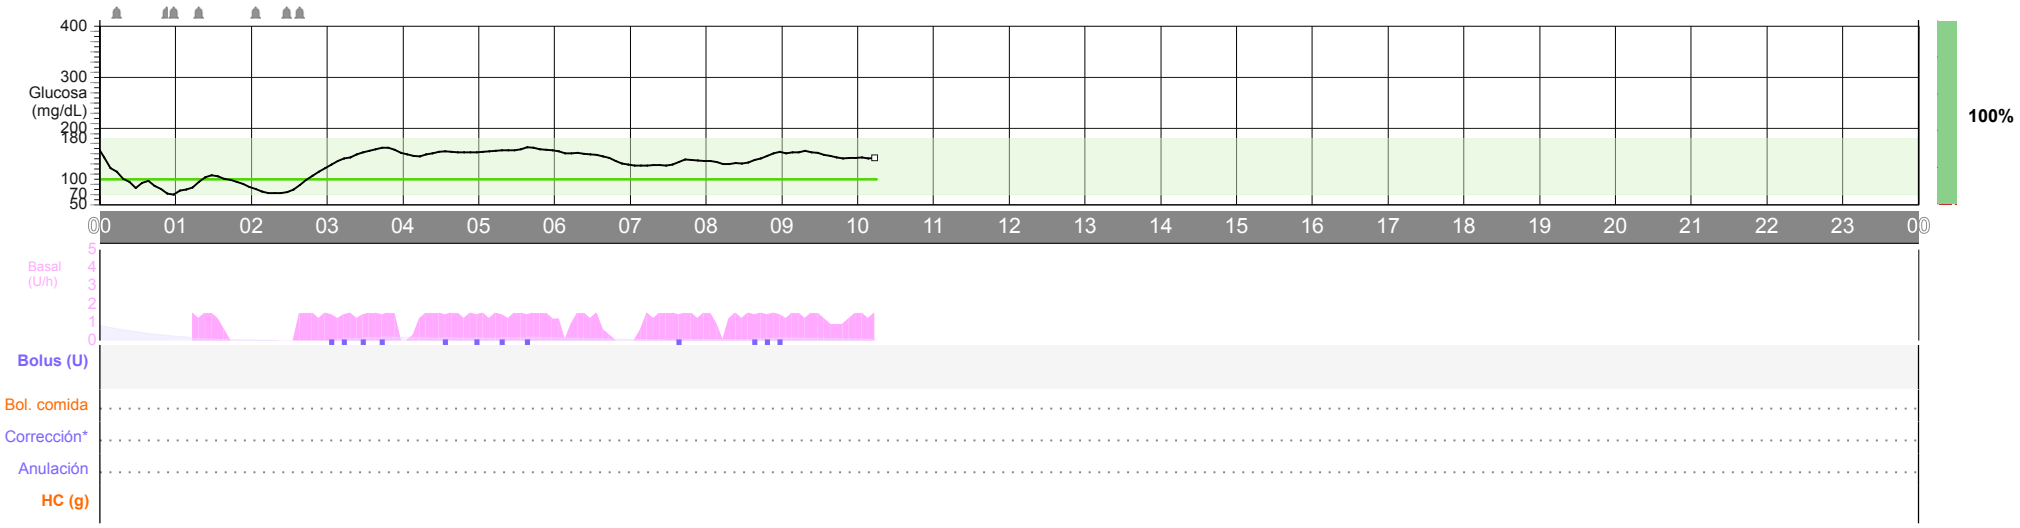

*Insulina activa considerada. SmartGuard también considera el ajuste de bolus de SmartGuard.

Glucosa sangre | Autobasal | Basal | Basal temporal | Autocorrección + Insulina activa | Bolus + Insulina activa | Objetivo + objet. temp. | Cambio de hora | Modo Manual

Calibración | Susp. límite bajo | Susp. antes lím. bajo | Alertas | Retr. rec. sensor | Fuera gráfico | Suspensión manual

Tiempo en rango (mg/dL)

54 70 180 250