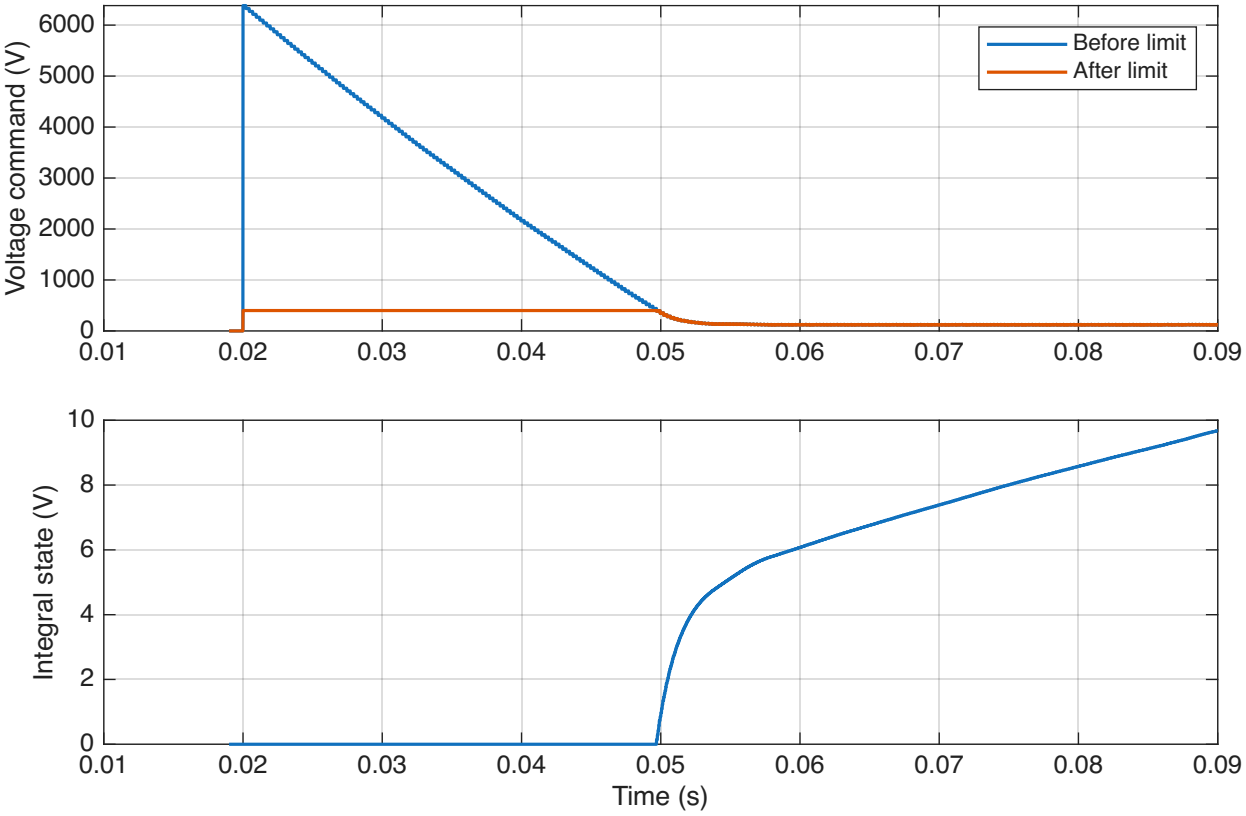

Before limit
After limit
Voltage command (V)
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
Integral state (V)
10
8
6
4
2
0
Time (s)