

Modelo do MRU: Measure MRU
Número de Série: 0001
Nº do Certificado: MO-20260601-4994
Data da Calibração: 01/06/2026
Versão do Firmware: v1.0.0
Técnico: Measure Offshore

Este certificado atesta que o sistema MRU foi calibrado conforme procedimentos internos.

Leticia Reis


Eng. de Calibração

1. TESTES DE ACURÁCIA DE ROLL & PITCH


O MRU foi submetido a movimentos dinâmicos conhecidos. Comparação entre medido e referência.

Parâmetro	Requisito	Roll	Pitch	Status
RMS estático (deg)	≤ 0.5000	0.0091	0.0075	Aprovado
RMS dinâmico (deg)	≤ 0.6000	0.1932	1.0407	Reprovado
Scale Factor (deg)	≤ 0.1000	0.3619	450.2795	Reprovado


Roll: Referência vs. Medido (99.87%)

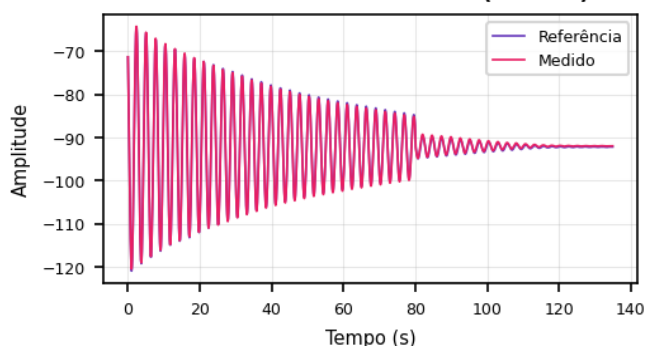


Pitch: Referência vs. Medido (99.16%)

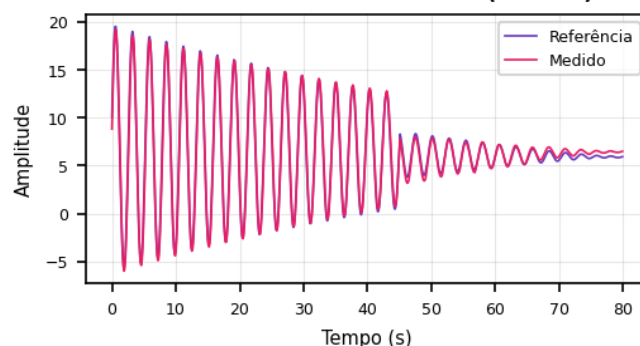

Erro Temporal - Roll

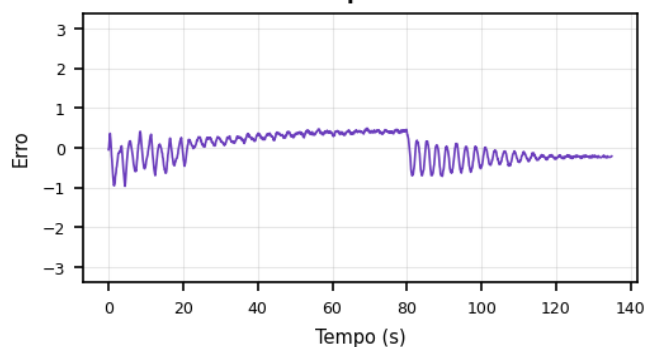

Erro Temporal - Pitch

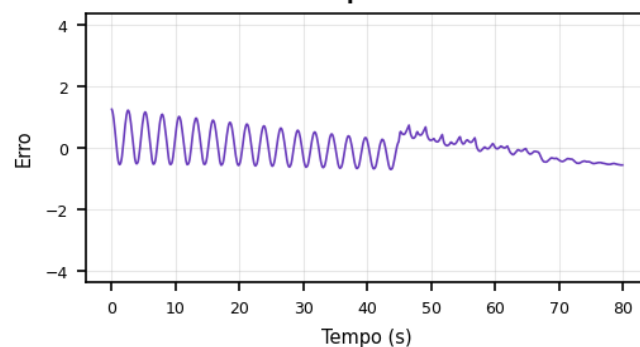

2. TESTES DE GIROSCÓPIO

Verificação através de rotações contínuas em velocidades conhecidas.

Parâmetro	Requisito	Medido	Status
Ruído Estático STD (deg/s)	≤ 0.3000	0.2612	Aprovado

3. TESTE DE ACELERÔMETRO

Verificação inclinando o MRU em degraus de 90° em um círculo completo.

Parâmetro	Requisito	Medido	Status
Ruído Estático STD (m/s²)	≤ 0.0500	0.0167	Aprovado



O sistema MRU atende a todos os requisitos de calibração.
Recomendamos nova calibração em 12 meses.

measureoffshore.com