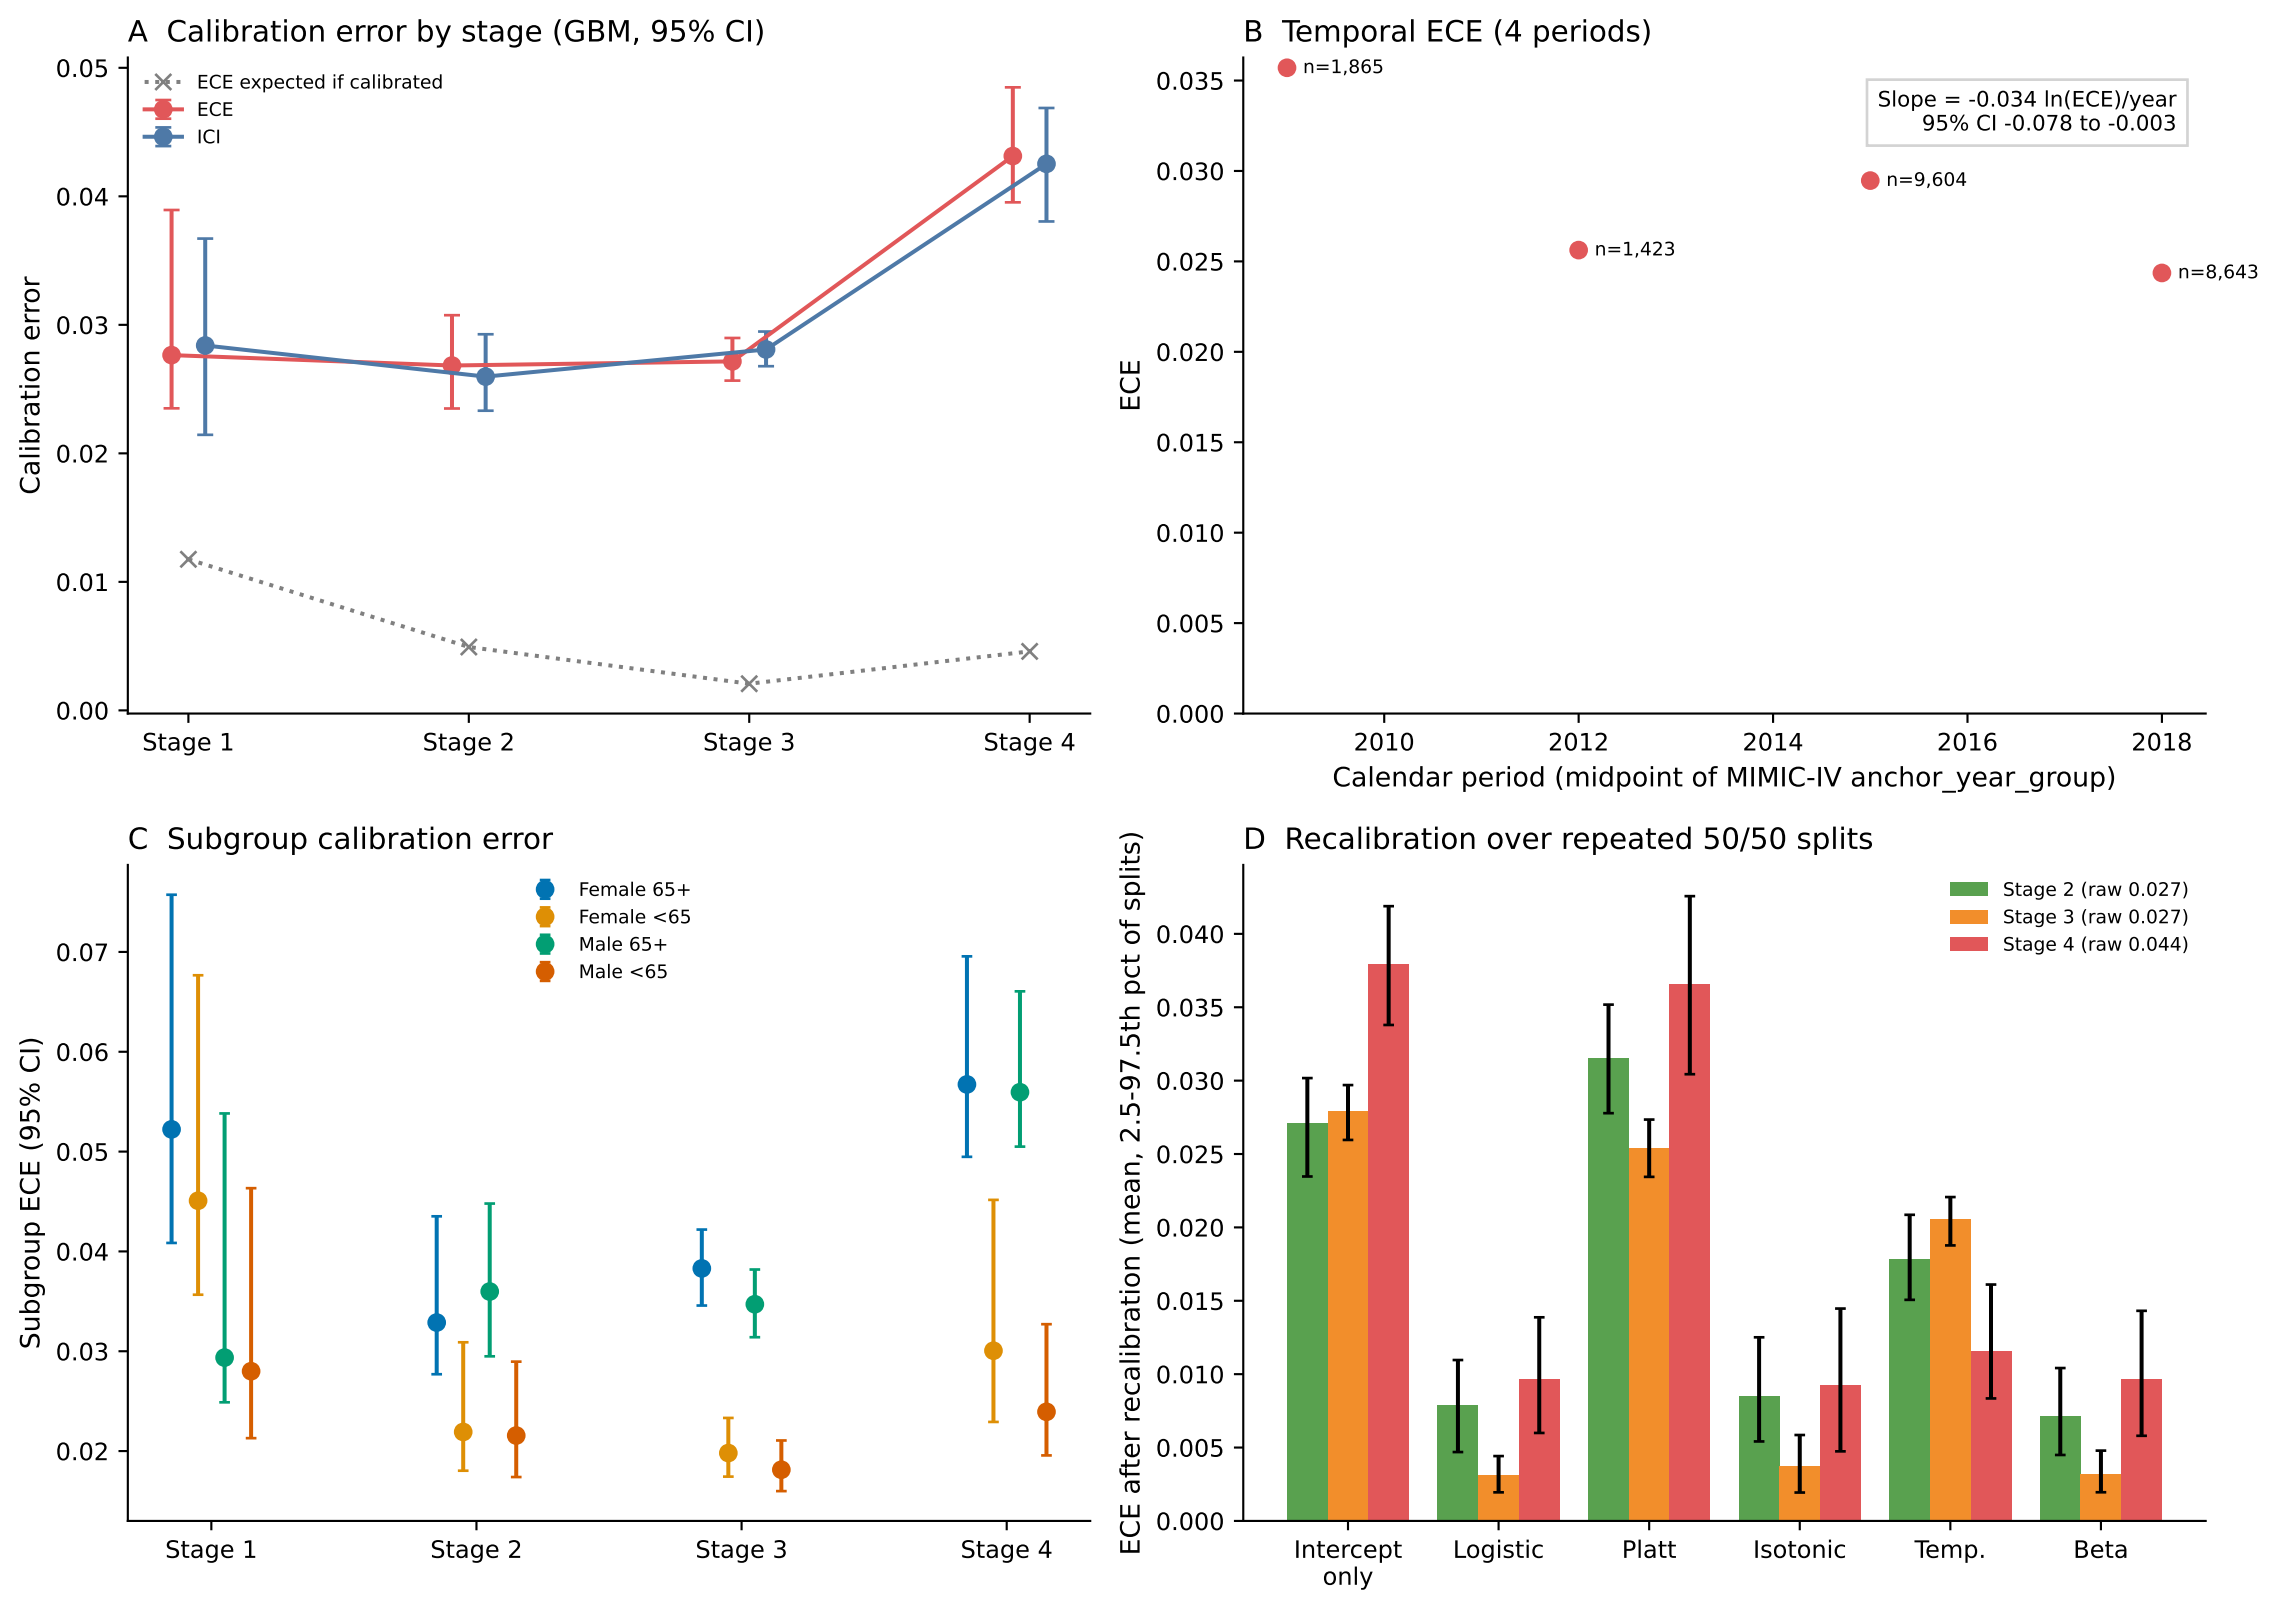
A Calibration error by stage (GBM, 95% CI)
ECE expected if calibrated
ECE
ICI
Calibration error
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
Stage 1
Stage 2
Stage 3
Stage 4
B Temporal ECE (4 periods)
n=1,865
n=1,423
n=9,604
n=8,643
Slope = -0.034 ln(ECE)/year
95% CI -0.078 to -0.003
ECE
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
2010
2012
2014
2016
2018
Calendar period (midpoint of MIMIC-IV anchor_year_group)
C Subgroup calibration error
Female 65+
Female <65
Male 65+
Male <65
Subgroup ECE (95% CI)
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
Stage 1
Stage 2
Stage 3
Stage 4
D Recalibration over repeated 50/50 splits
Stage 2 (raw 0.027)
Stage 3 (raw 0.027)
Stage 4 (raw 0.044)
ECE after recalibration (mean, 2.5-97.5th pct of splits)
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
Intercept only
Logistic
Platt
Isotonic
Temp.
Beta