| PLASMABIOTICS® IN ASSOCIATION WITH PENTAXMEDICAL | Connection card PLASMABIOTICS | APPROUVE |
|---|---|---|
| | 301077 – PW90 2C-G-D | B01-031_3_302_v01 |
| | 301077-1 – PW90 2C-G-D /A | |

Connection set for colonoscopes and gastroscopes with double operating channel
*Connectiques pour coloscopes et gastroscopes avec double canal opérateur*
**PENTAX Medical 90K series**

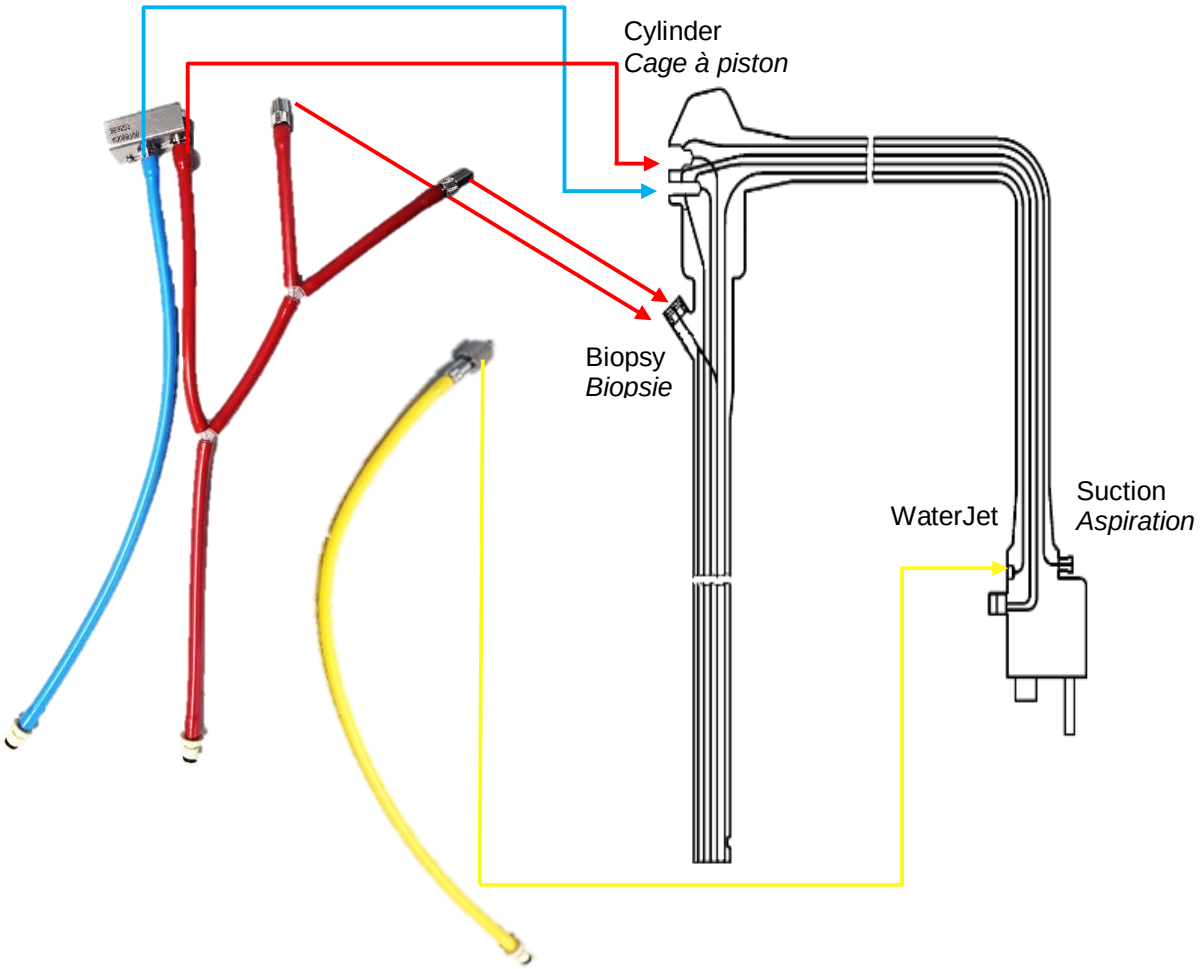


| Brands / Marques | Compatible Endoscopes / Endoscopes compatibles | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pentax** | EC-3890 TFK | EC-3890 TLK | | | | |


*** Les exemplaires imprimés ne sont pas contrôlés, sauf indication contraire ***
- document confidentiel de la société -