CTP 관리 사양서 Control Specification


입안 PREPARED	심사 EXAMINED	결재 APPROVED

MODEL 모델	KS9000		DATE 작성일	2026-11-09
PART 품명	COVER-DECORATION		WRITER 작성자	PHY
CODE 품번	43"	BN61-29348A	REV. 개정	1
	50"	BN61-29349A	PAGE 페이지	1 / 2
	65"	BN61-29350A	REV. NOTE 개정 내용	REV.1 C 전장 43" 8.80 → 8.85
	75"	BN61-29351A		
	85"	BN61-29352A		

MEASURING POINT 측정 위치

대표 이미지 : 65"

샘플 이미지 - 실제는 앱 캡처 (대표 65", 치수선·라벨 A~D)

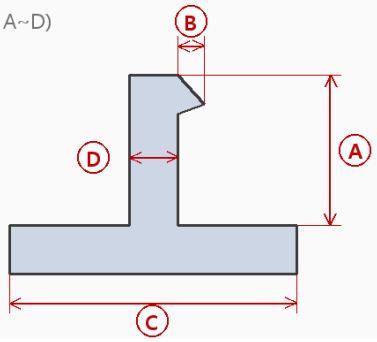

CHECK POINT 관리 항목

SPEC. 단위 mm / 공차 : 하한/상한

INCH	Point	Check Point 관리항목	SPEC. 도면 스펙	Tolerance 관리공차	Method of measurement	Remark 비고
43"	A	후크 높이 Hook Height	3.20	±0.05	Height Gauge	
50"			3.20	±0.05		
65"			3.20	±0.05		
75"			3.20	±0.05		
85"			3.20	±0.05		
43"	B	걸림량 Undercut	0.80	+0.00/+0.10	Calipers	
50"			0.80	+0.00/+0.10		
65"			0.80	+0.00/+0.10		
75"			0.80	+0.00/+0.10		
85"			0.80	+0.00/+0.10		
43"	C	전장 Length	**8.85**	**+0.00/+0.05**	Calipers	REV.1 변경 (8.80→8.85)
50"			8.85	+0.00/+0.06		
65"			8.85	+0.00/+0.07		
75"			8.85	+0.00/+0.08		
85"			8.85	+0.00/+0.09		
43"	D	두께 Thickness	1.50	±0.05	Calipers	
50"			1.50	±0.05		
65"			1.50	±0.05		
75"			1.50	±0.05		
85"			1.50	±0.05		

MEASUREMENT CONDITIONS 측정 환경 조건


온도 / 습도 Temp. / Humidity	23 ± 2 ℃ / 50 ± 10 %RH	측정 장비 Equipment	Calipers, Height Gauge (분해능 0.01mm)
시료 전처리 Conditioning	성형 후 상온 24 h 이상 방치	시료 수 Sample Q'ty	인치별 n = 5

CTP 관리 사양서 Control Specification	입안 PREPARED	심사 EXAMINED	결재 APPROVED

MODEL 모델	KS9000		DATE 작성일	2026-11-09
PART 품명	COVER-DECORATION		WRITER 작성자	PHY
CODE 품번	43"	BN61-29348A	REV. 개정	1
	50"	BN61-29349A	PAGE 페이지	2 / 2
	65"	BN61-29350A	REV. NOTE 개정 내용	REV.1 C 전장 43" 8.80 → 8.85
	75"	BN61-29351A		
	85"	BN61-29352A		

MEASURING POINT 측정 위치

전 인치 이미지 (인치별 형상 상이)

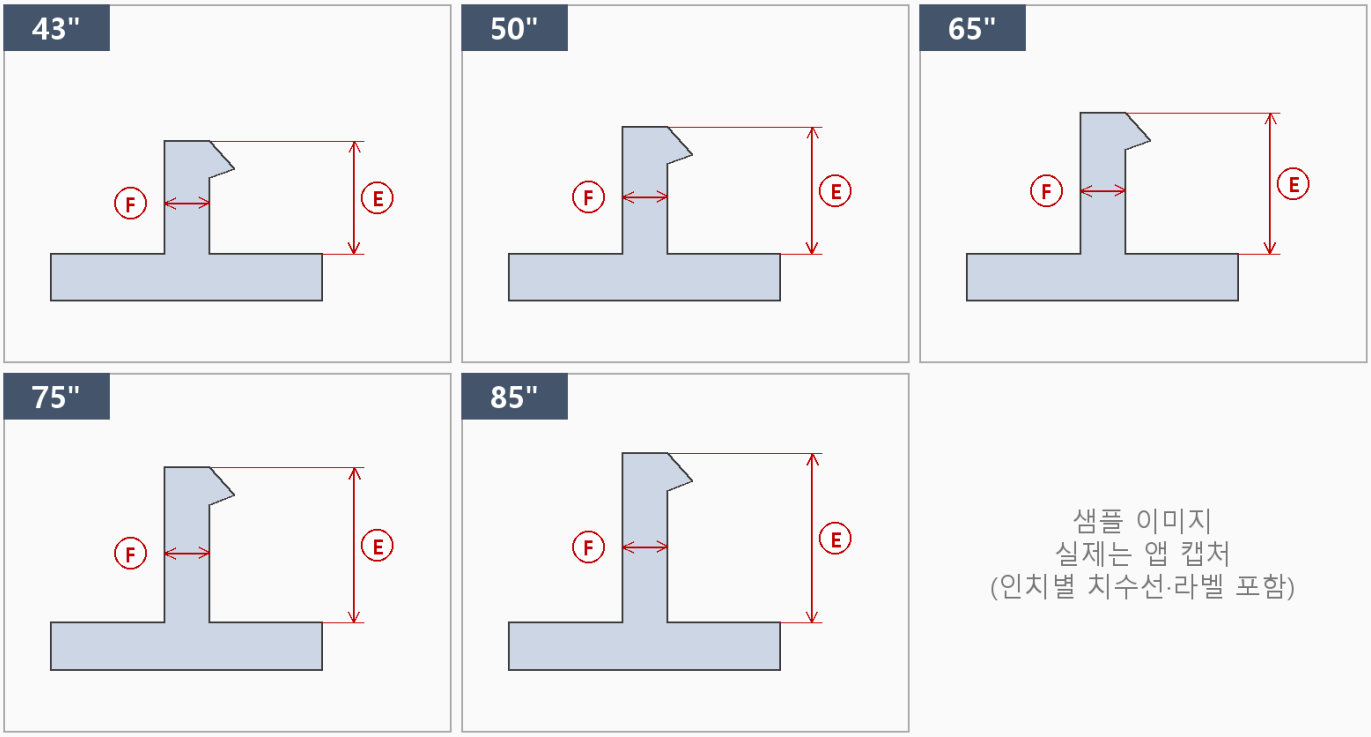

CHECK POINT 관리 항목

SPEC. 단위 mm / 공차 : 하한/상한

INCH	Point	Check Point 관리항목	SPEC. 도면 스펙	Tolerance 관리공차	Method of measurement	Remark 비고
43"	E	리브 높이 Rib Height	5.10	±0.10	Height Gauge	
50"			5.30	±0.10		
65"			5.60	±0.10		
75"			5.80	±0.10		
85"			6.00	±0.10		
43"	F	리브 두께 Rib Thickness	1.20	±0.05	Calipers	
50"			1.20	±0.05		
65"			1.20	±0.05		
75"			1.20	±0.05		
85"			1.20	±0.05		

MEASUREMENT CONDITIONS 측정 환경 조건

온도 / 습도 Temp. / Humidity	23 ± 2 ℃ / 50 ± 10 %RH	측정 장비 Equipment	Calipers, Height Gauge (분해능 0.01mm)
시료 전처리 Conditioning	성형 후 상온 24 h 이상 방치	시료 수 Sample Q'ty	인치별 n = 5