Reporte de evaluación BCI
Fecha: 2026-09-04 20:43
Duración: 01:53

Total de intentos: 92
Selecciones completadas (aciertos): 8
Fallos: 84
Accuracy: 8.70%
ITR: 1.89 bits/min

Método de clasificación: CCA
Ventana de tiempo: 1.0s
Canales utilizados: 0:O1, 1:Oz, 2:O2

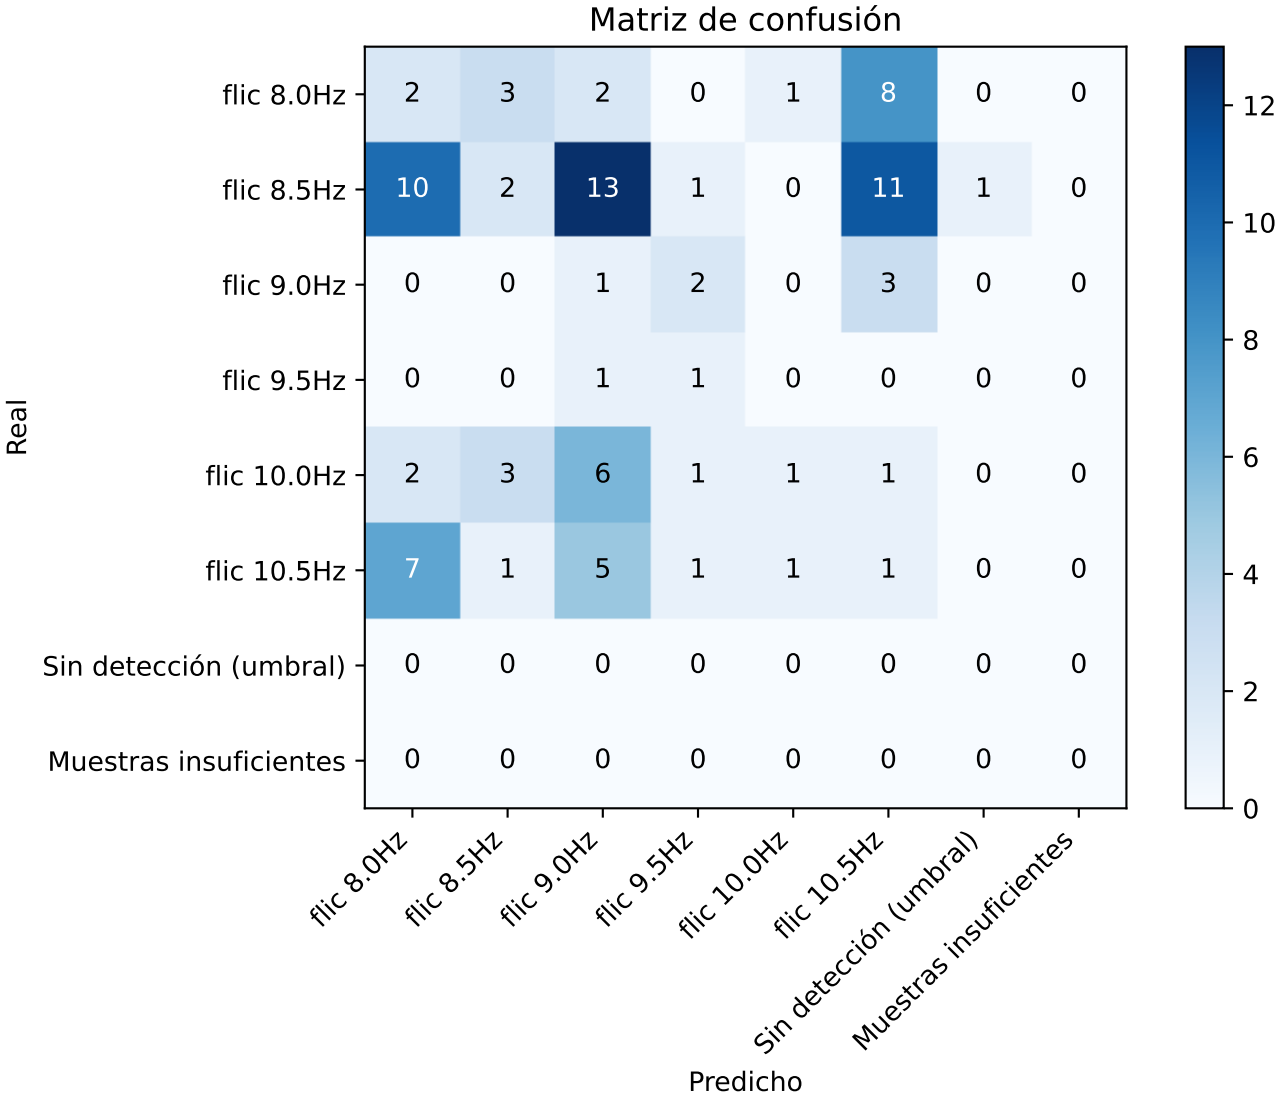
Matriz de confusión
Real
Predicho
flic 8.0Hz
flic 8.5Hz
flic 9.0Hz
flic 9.5Hz
flic 10.0Hz
flic 10.5Hz
Sin detección (umbral)
Muestras insuficientes
2 3 2 0 1 8 0 0
10 2 13 1 0 11 1 0
0 0 1 2 0 3 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
2 3 6 1 1 1 0 0
7 1 5 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
2
4
6
8
10
12