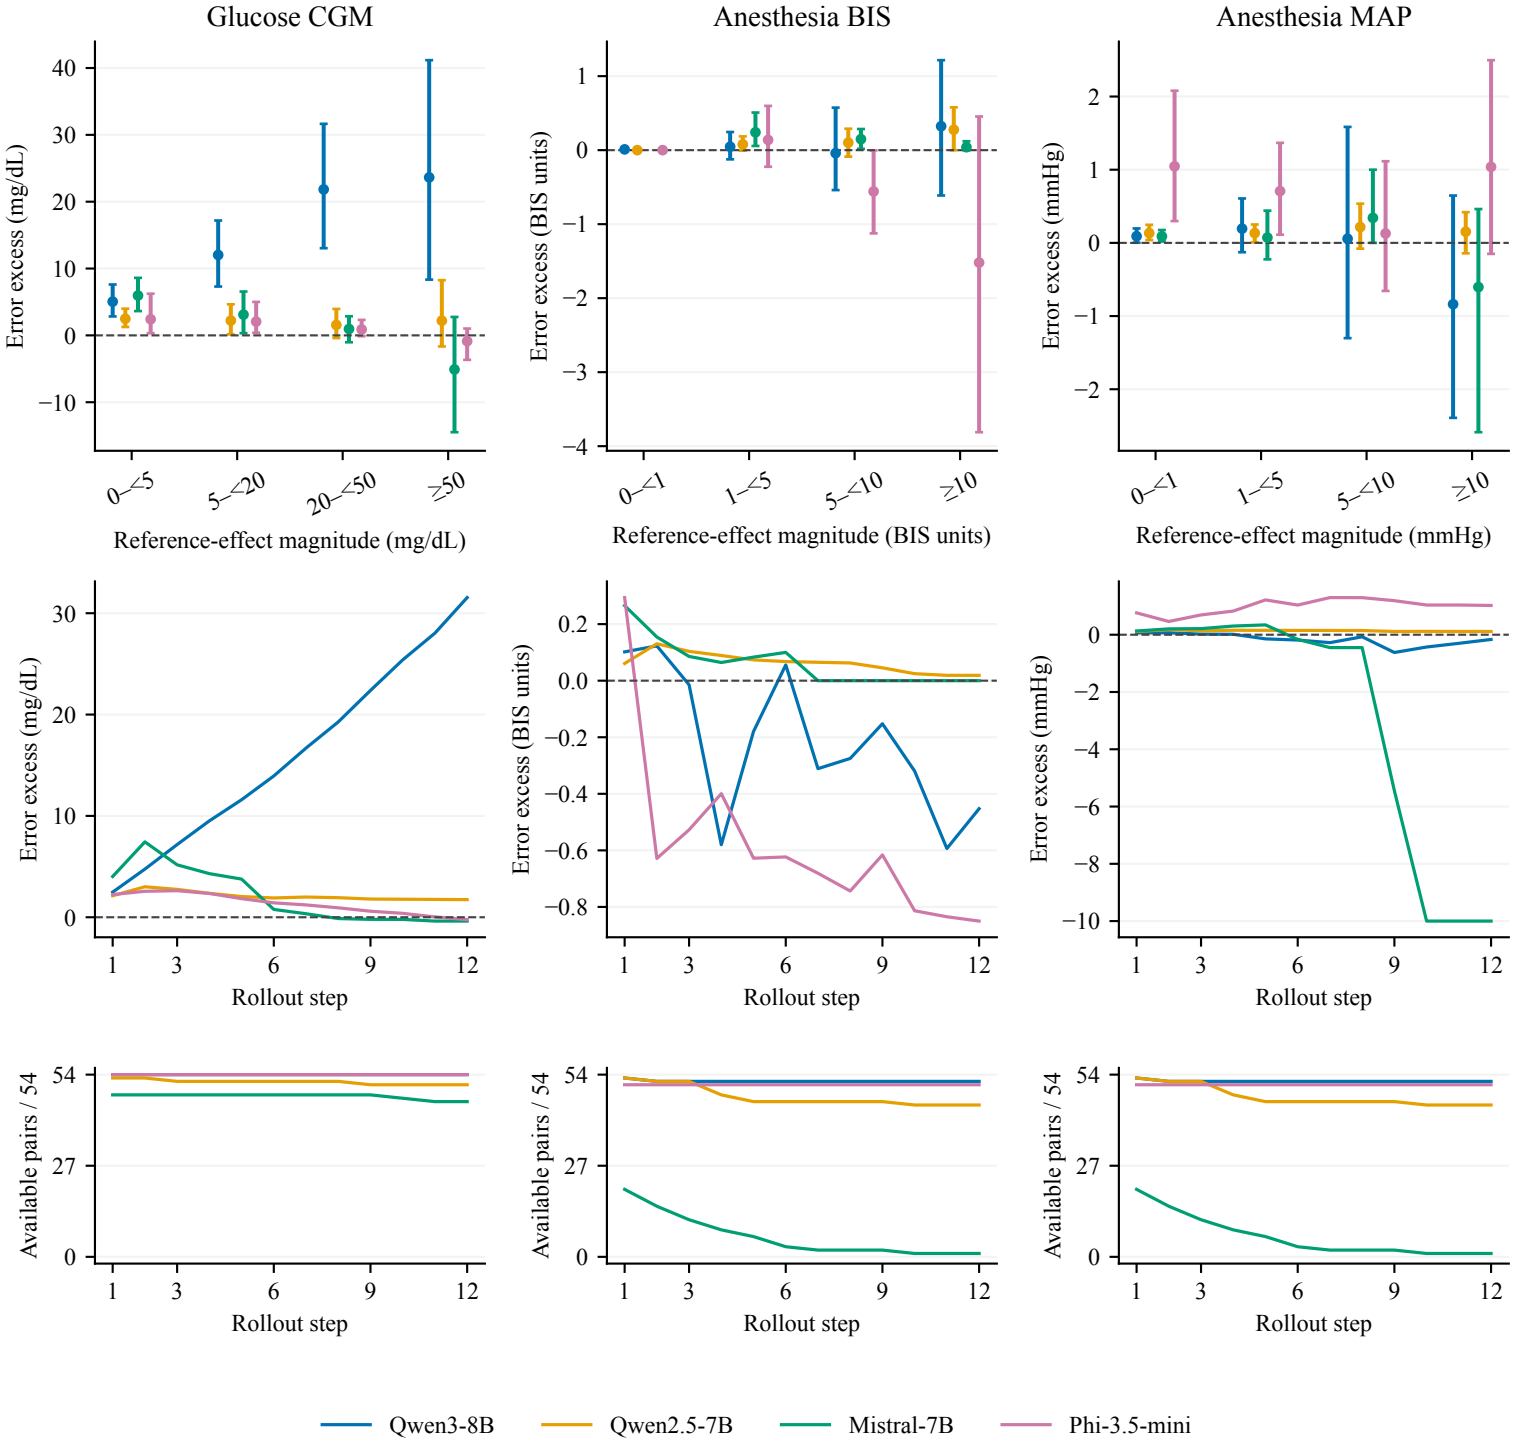
Glucose CGM
Anesthesia BIS
Anesthesia MAP
Error excess (mg/dL)
Error excess (BIS units)
Error excess (mmHg)
0–<5
5–<20
20–<50
≥50
0–<1
1–<5
5–<10
≥10
Reference-effect magnitude (mg/dL)
Reference-effect magnitude (BIS units)
Reference-effect magnitude (mmHg)
Rollout step
Available pairs / 54
Qwen3-8B
Qwen2.5-7B
Mistral-7B
Phi-3.5-mini