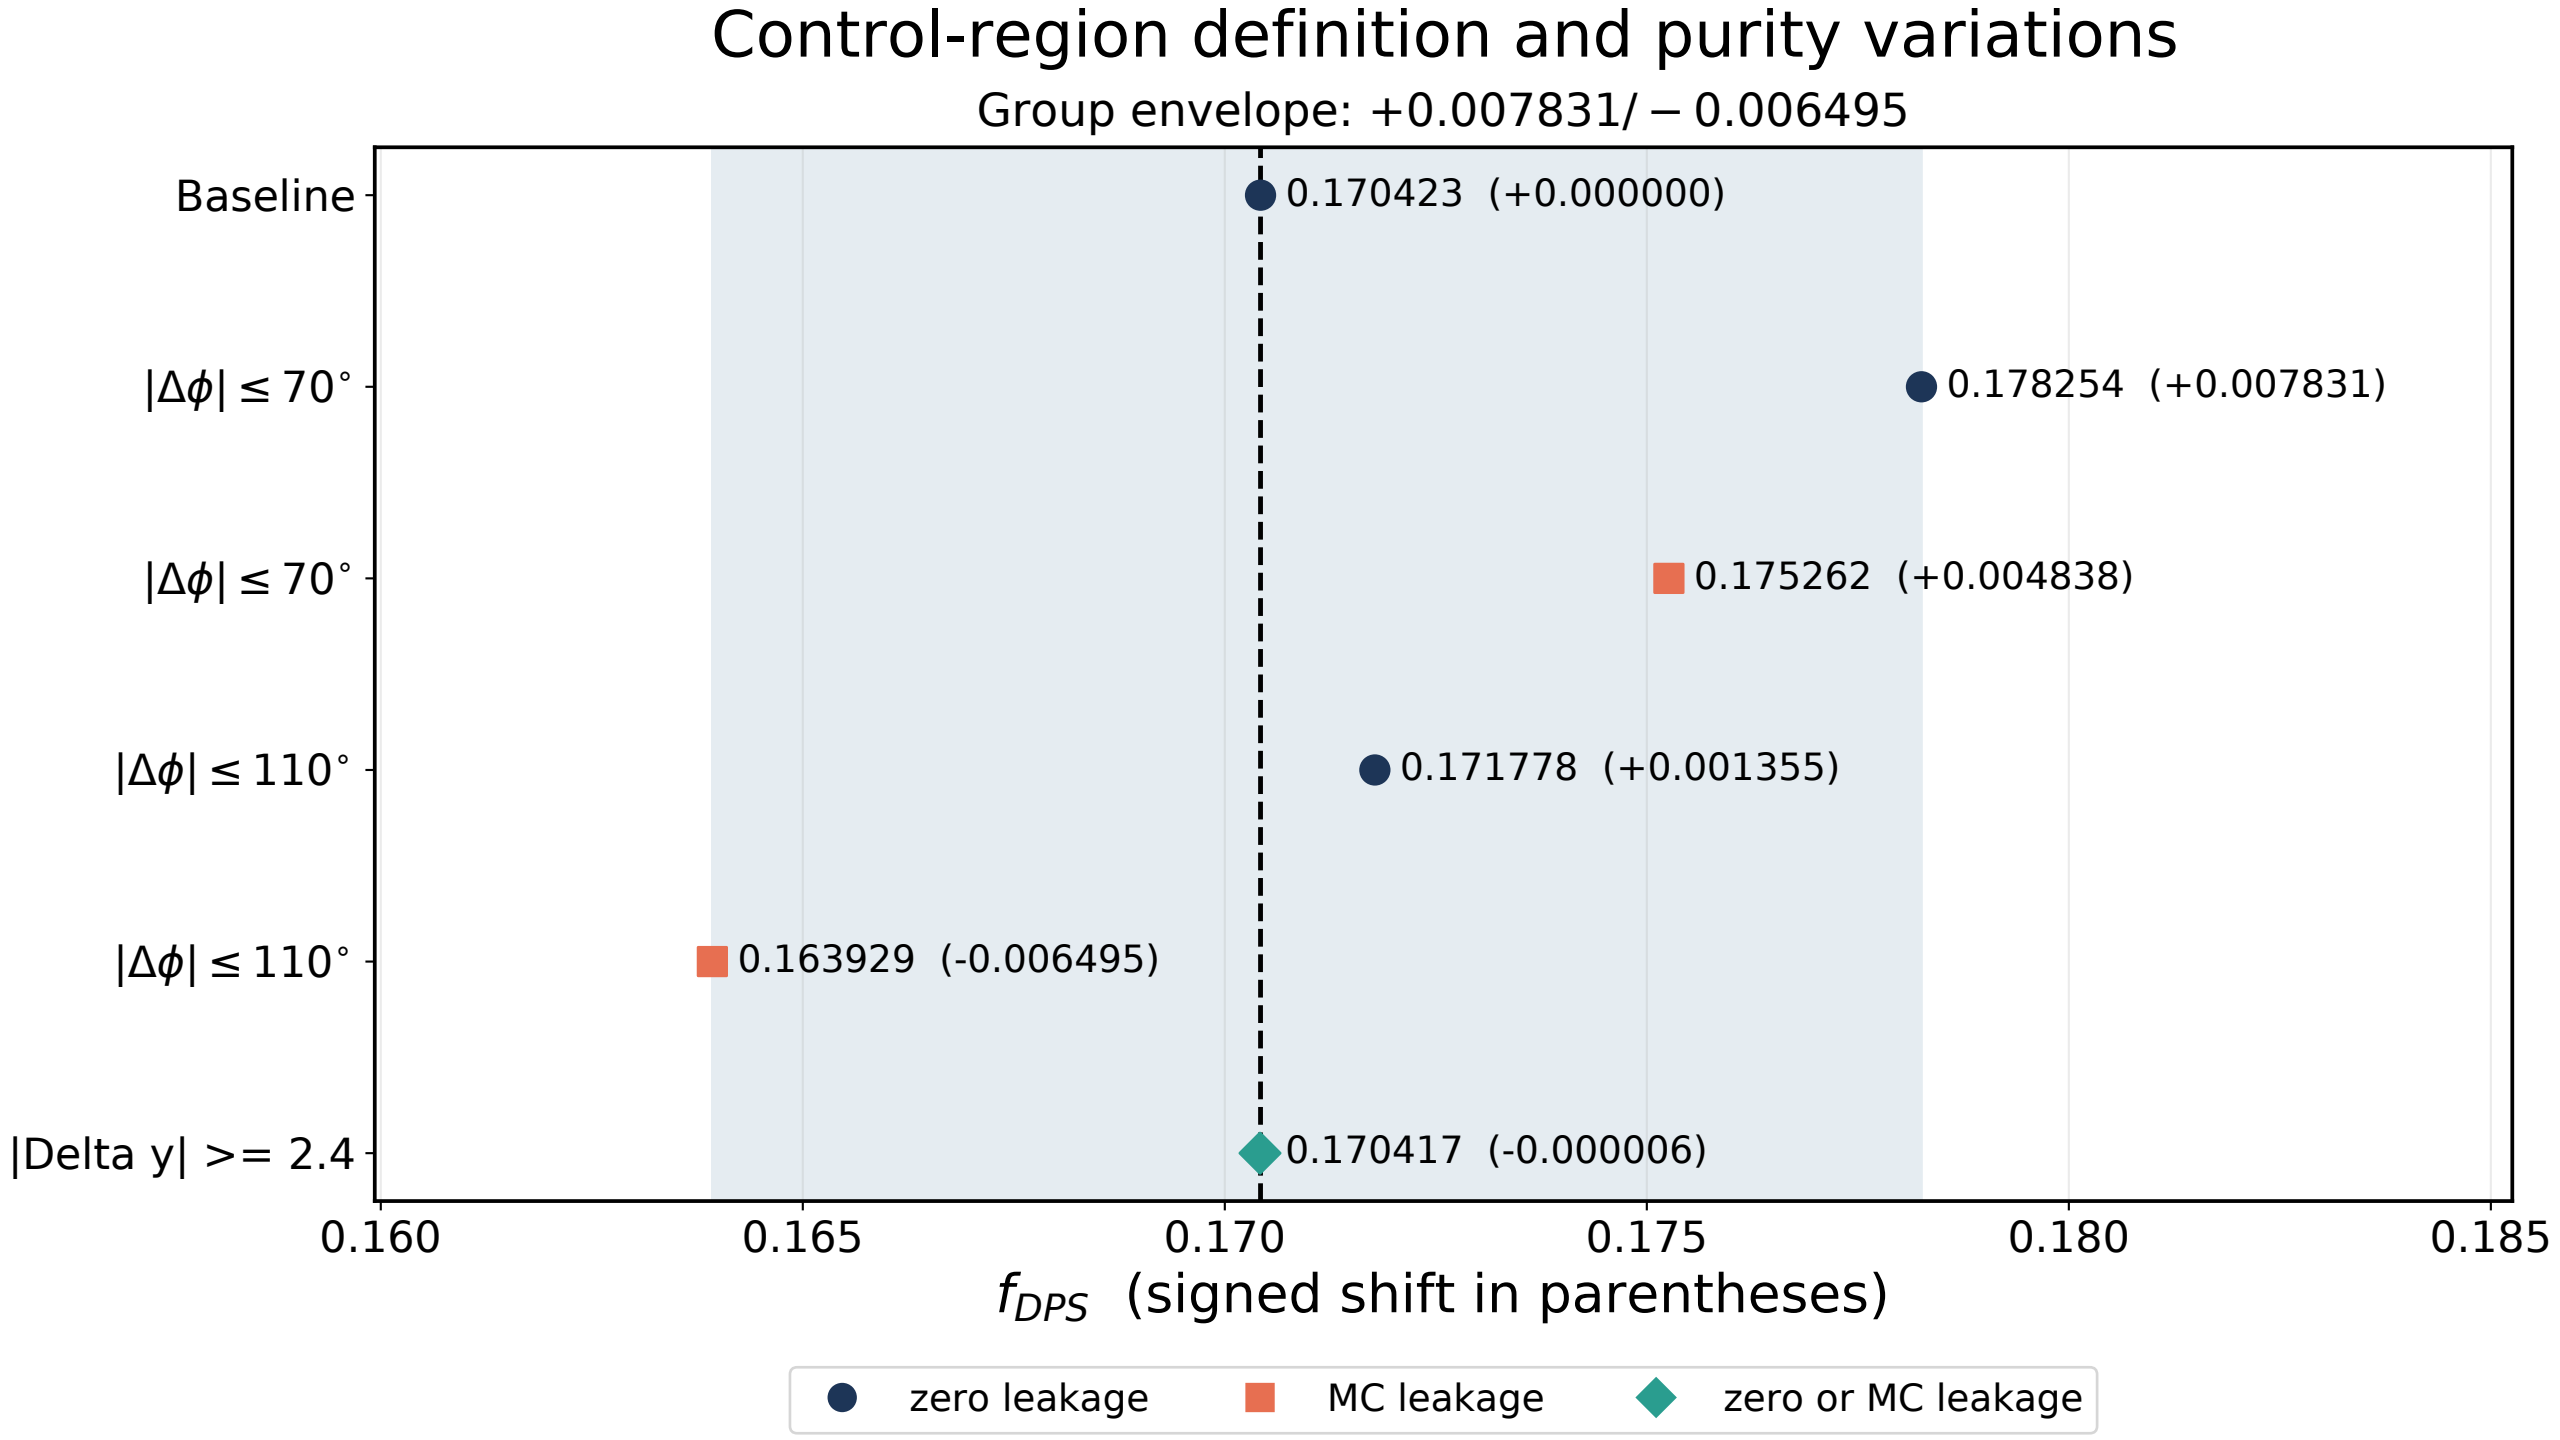

Control-region definition and purity variations
Group envelope: +0.007831/ − 0.006495
Baseline
|Δφ| ≤ 70°
|Δφ| ≤ 70°
|Δφ| ≤ 110°
|Δφ| ≤ 110°
|Delta y| >= 2.4
0.170423 (+0.000000)
0.178254 (+0.007831)
0.175262 (+0.004838)
0.171778 (+0.001355)
0.163929 (-0.006495)
0.170417 (-0.000006)
0.160
0.165
0.170
0.175
0.180
0.185
f_{DPS} (signed shift in parentheses)
zero leakage
MC leakage
zero or MC leakage