


Name, Vorname, Geburtsdatum, Patienten-ID

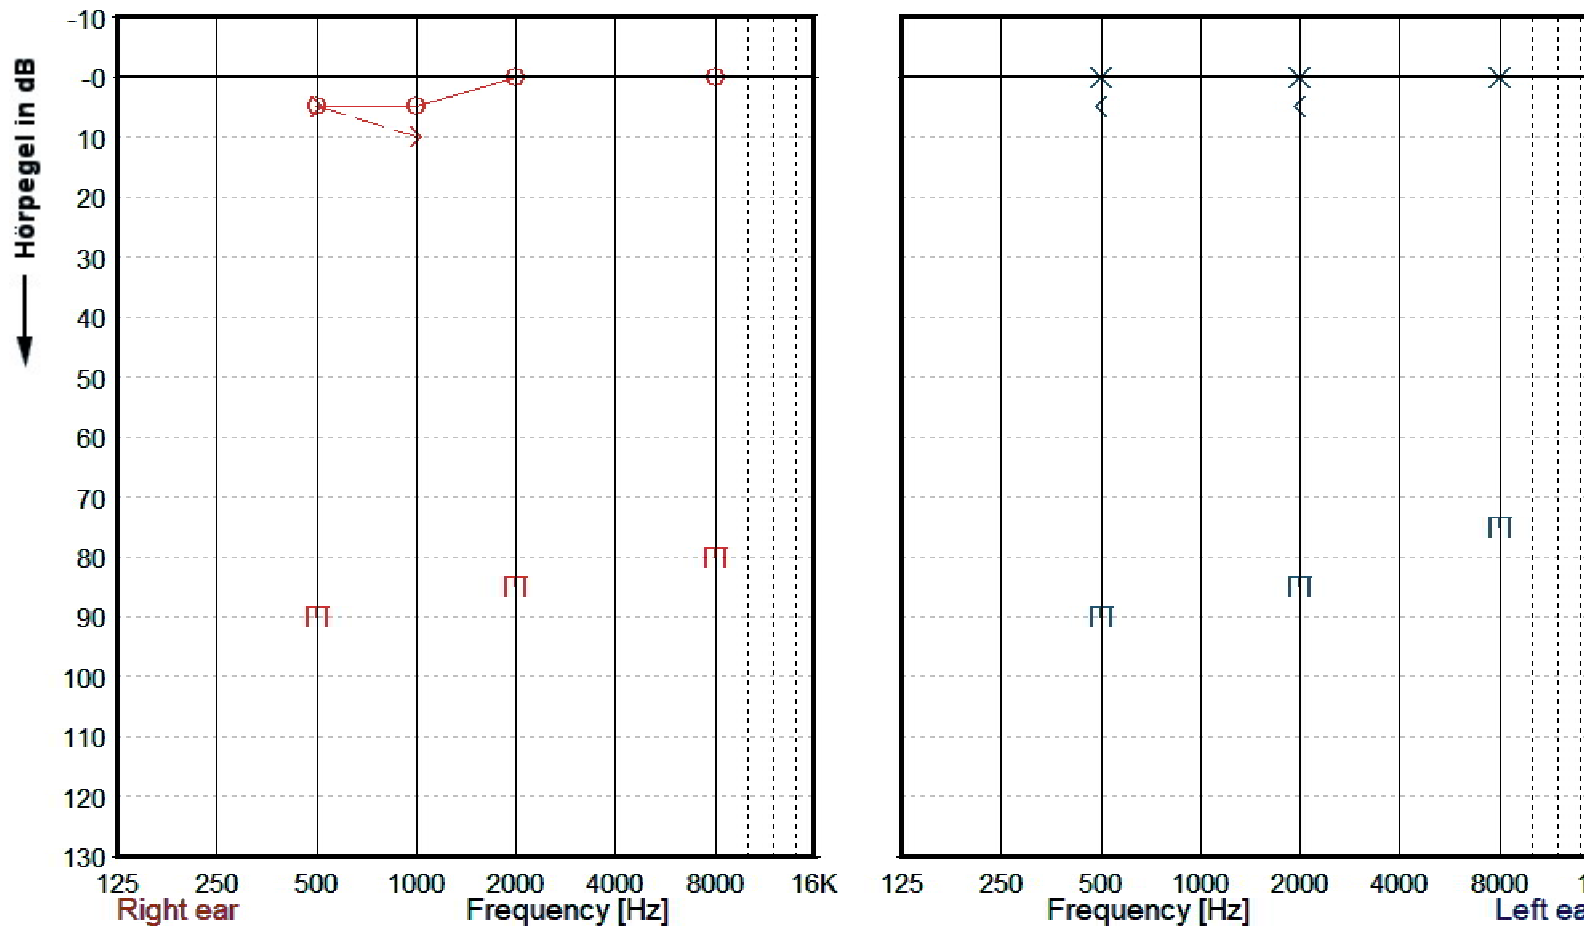

Test

Output

500	1.0K	2.0K	4.0K	8.0K	500	1.0K	2.0K	4.0K	8.0K
					SISI %				
					SISI US dB				
					Luscher dB				
					Luscher US				

	Weber	
	Rinne	
R	Tinnitus	L
	Signal	
	F[Hz]	
	HL[dB]	

Sprachaudiogramm Freiburger-Sprachtest

