



## 单个设备作 PCA 取主成分 1 再多个设备做 PCA


multi device pca on horizontal

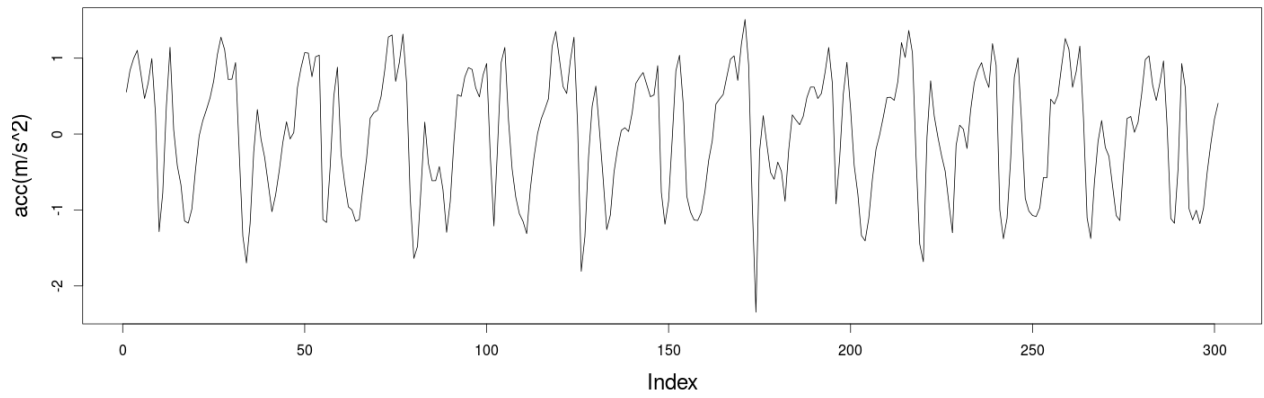


top forward correlation: 0.277

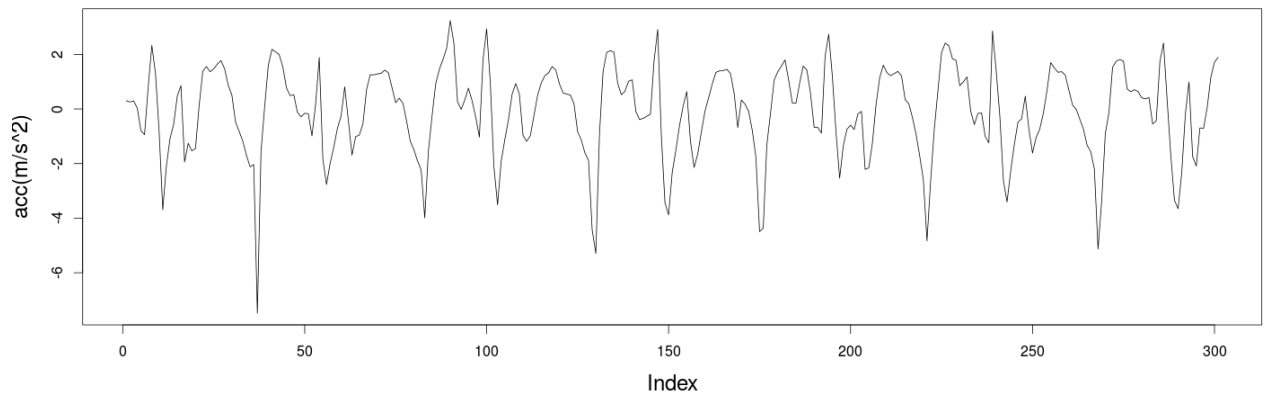


leftHand forward correlation: 0.083

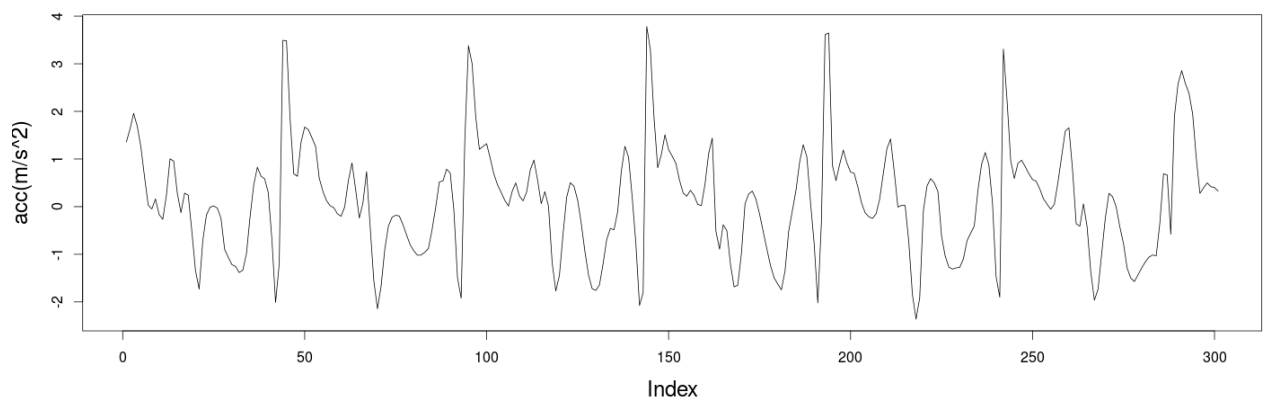

**rightHand forward correlation: -0.041**

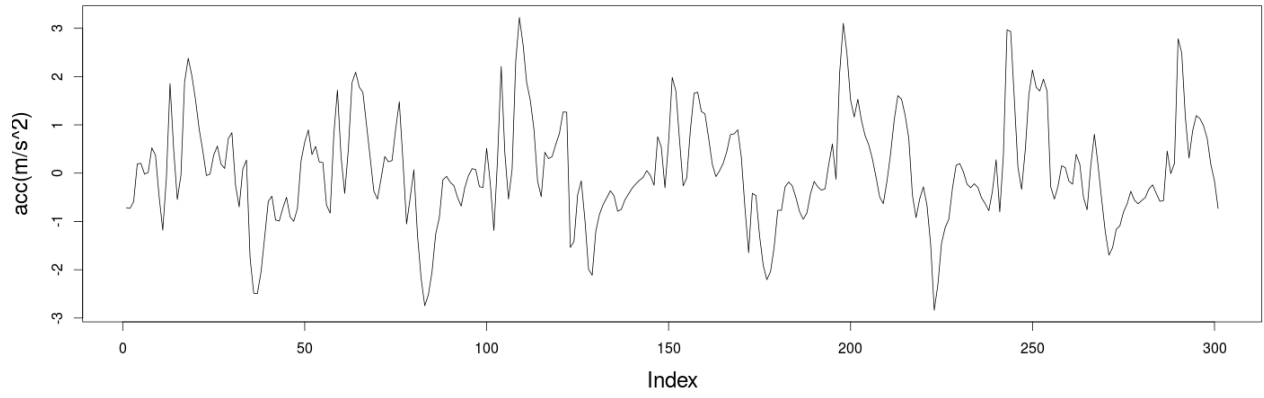

**leftPants forward correlation: 0.172**

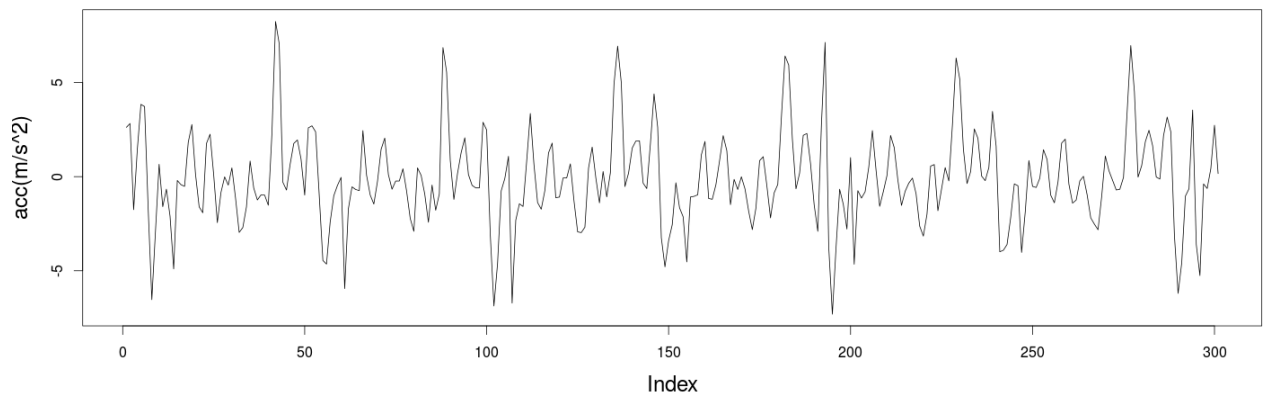

**rightPants forward correlation: -0.063**

