

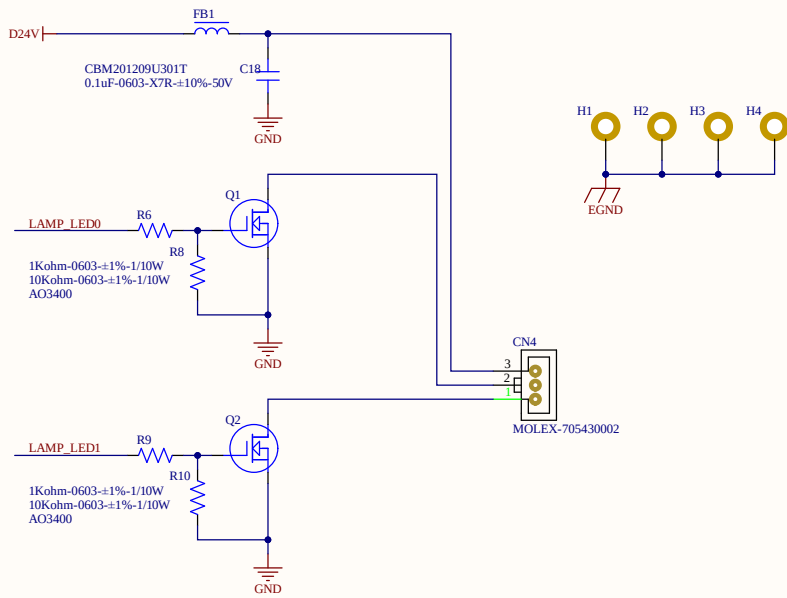
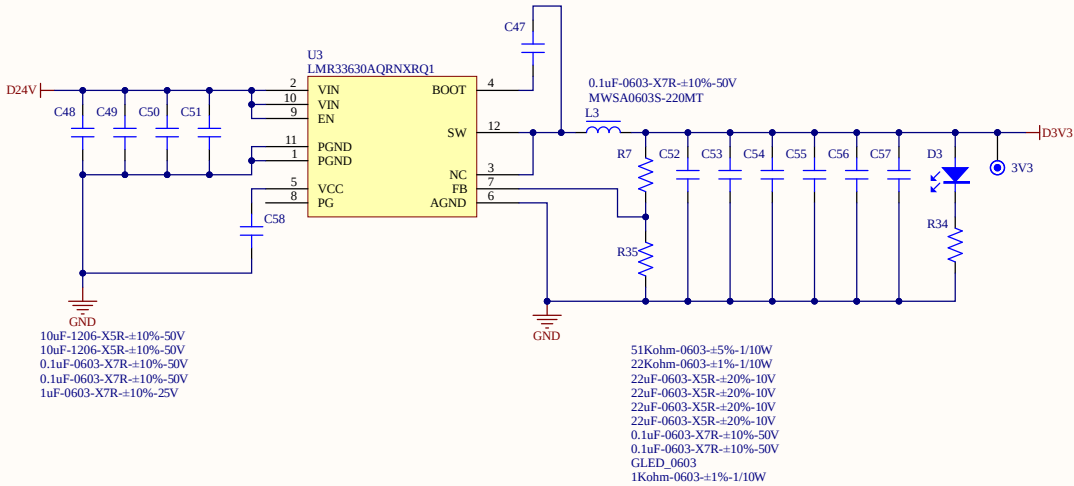


电源输入

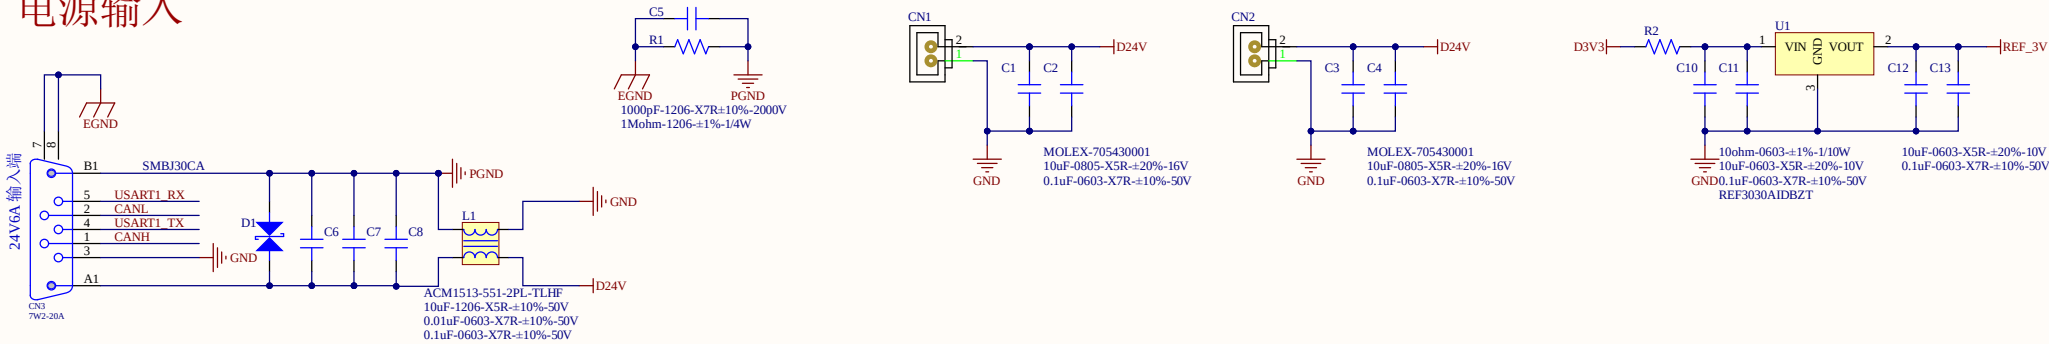

名称		文件编号		页码	1 / 6
公司	杭州犀燃医疗器械科技有限公司			版本	
设计		审核		批准	

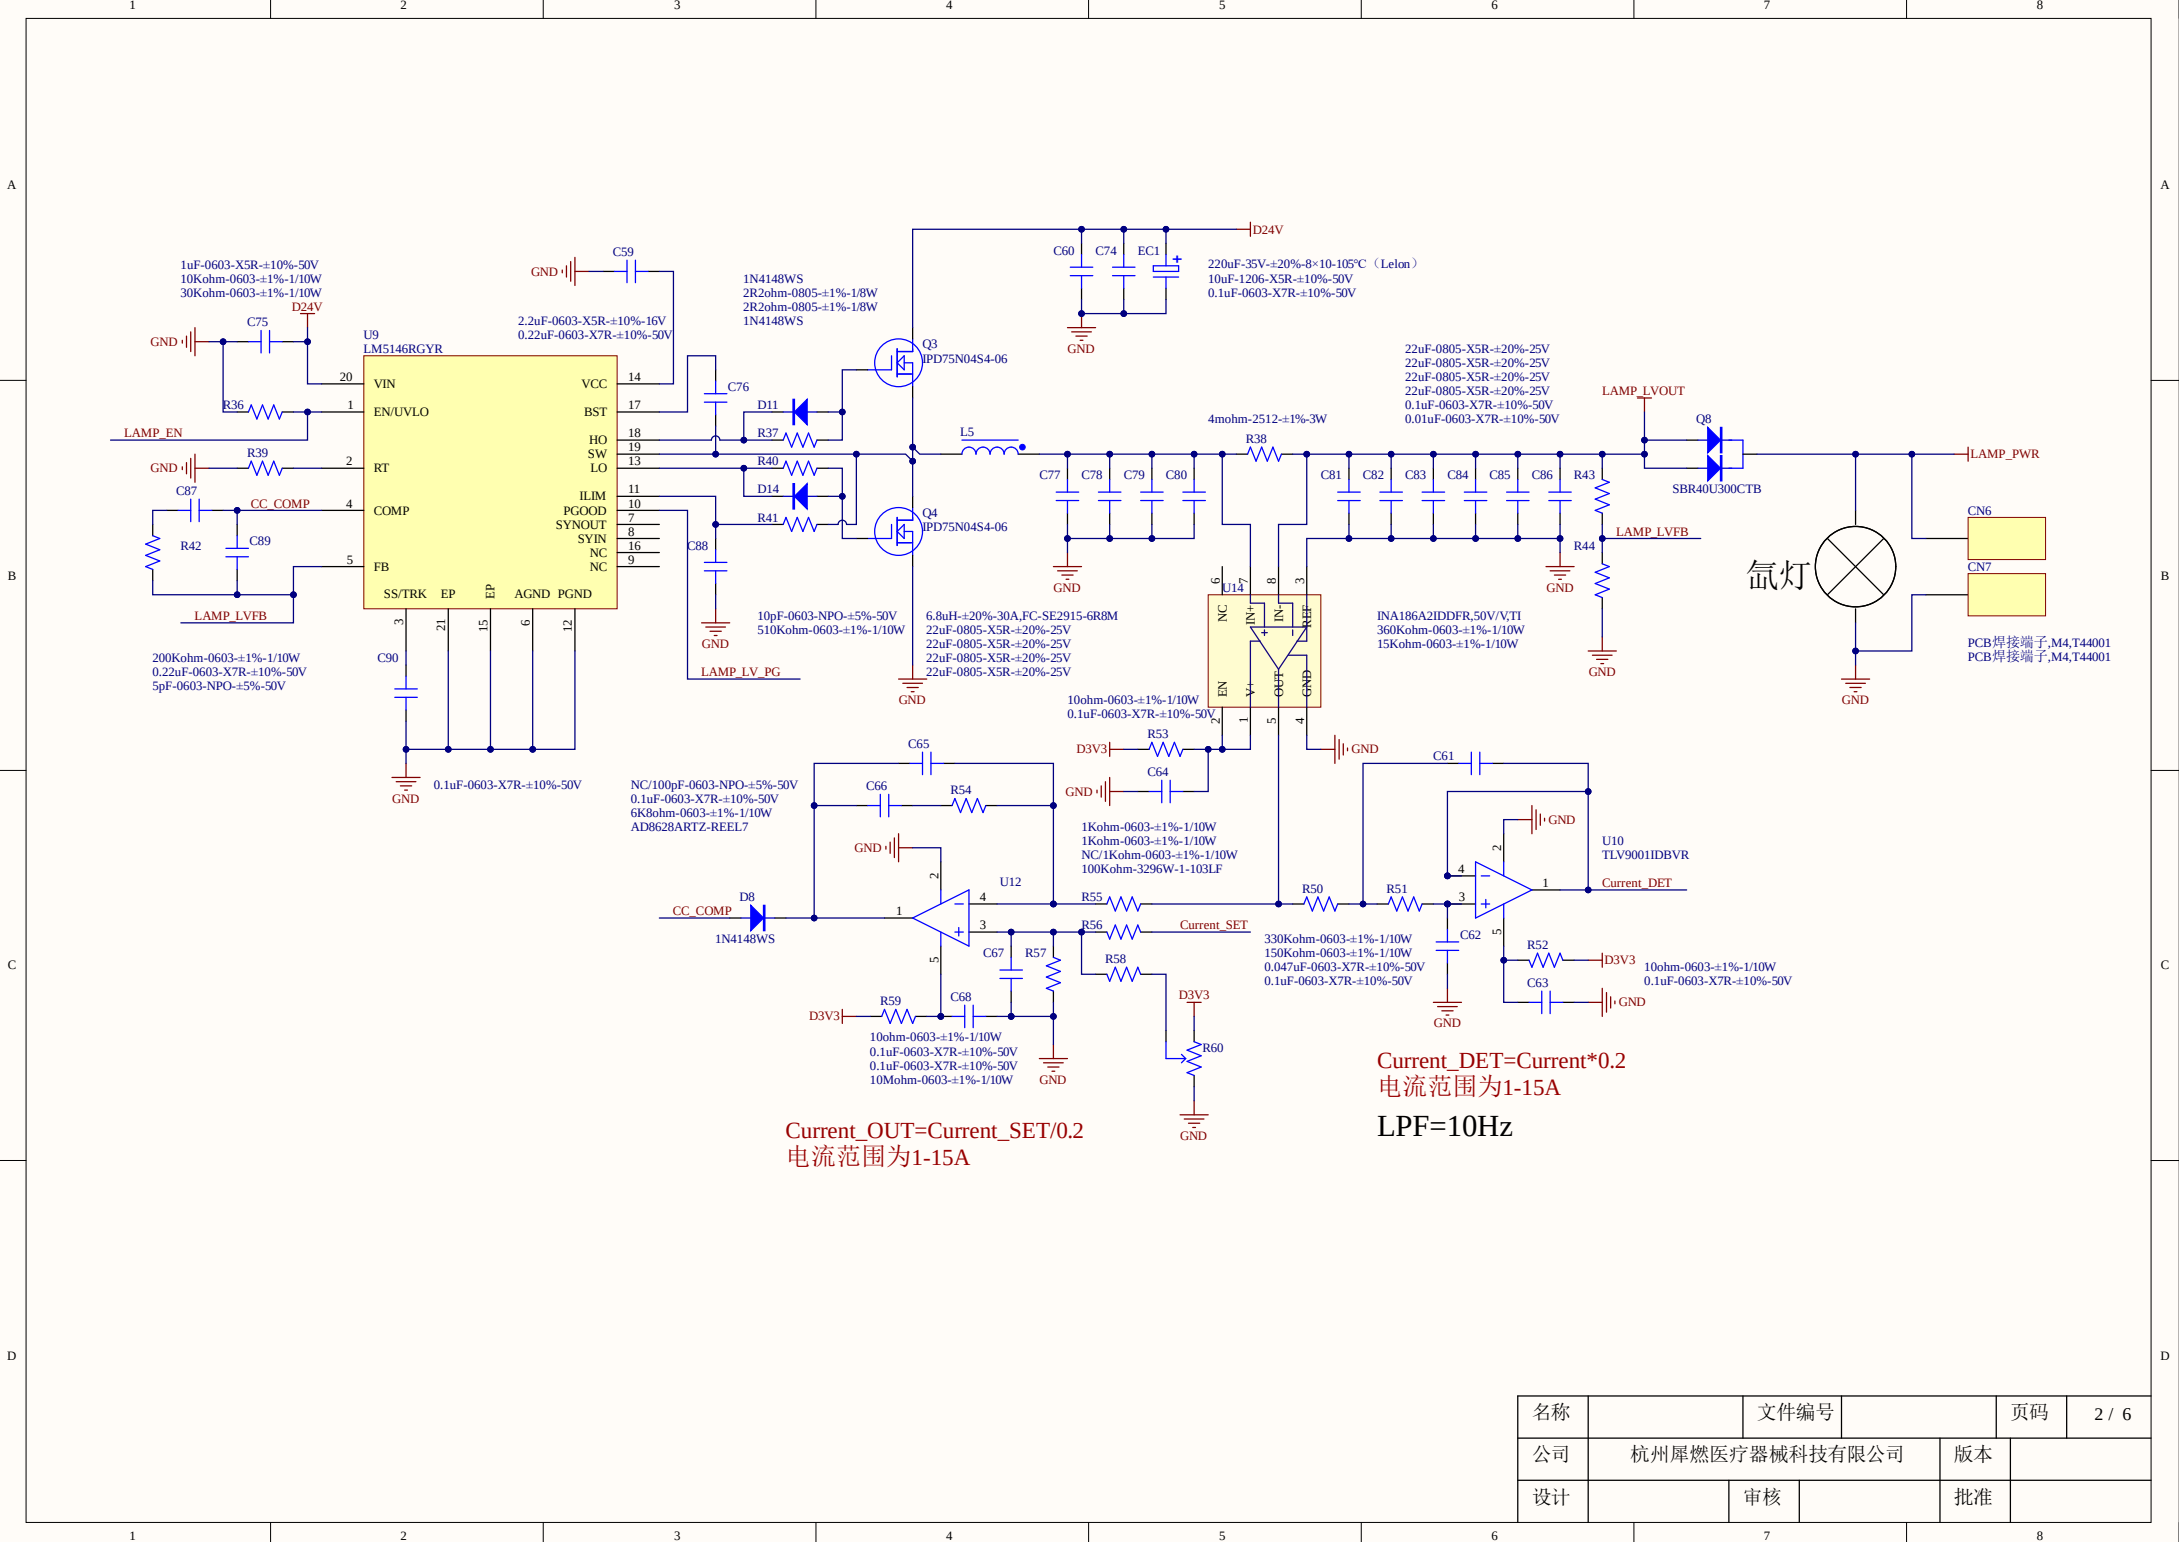


Current_OUT=Current_SET/0.2
电流范围为1-15A

Current_DET=Current*0.2
电流范围为1-15A
LPF=10Hz


名称		文件编号		页码	2 / 6
公司	杭州犀燃医疗器械科技有限公司			版本	
设计		审核		批准	

D

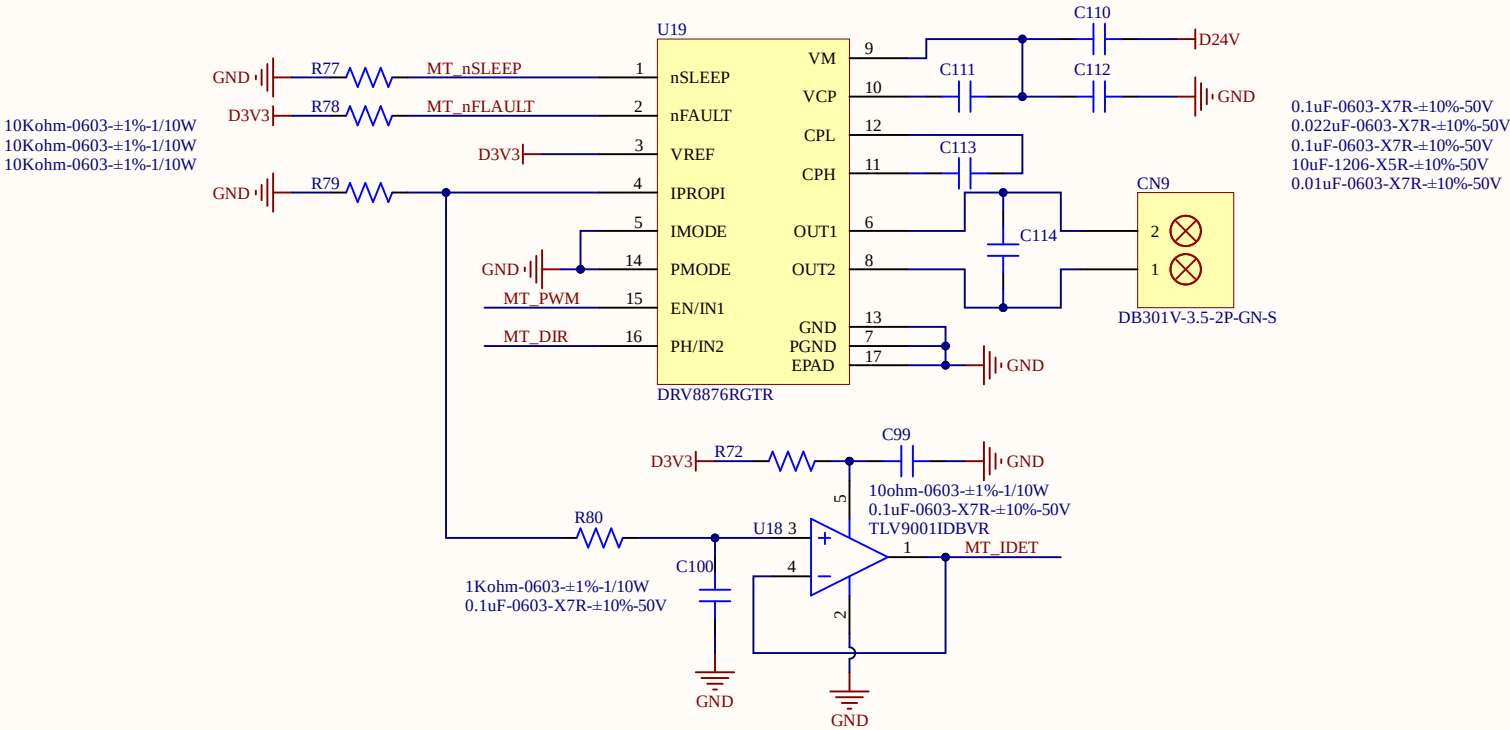


名称		文件编号		页码	5 / 6
公司	杭州犀燃医疗器械科技有限公司			版本	
设计		审核		批准	

ISO-CAN

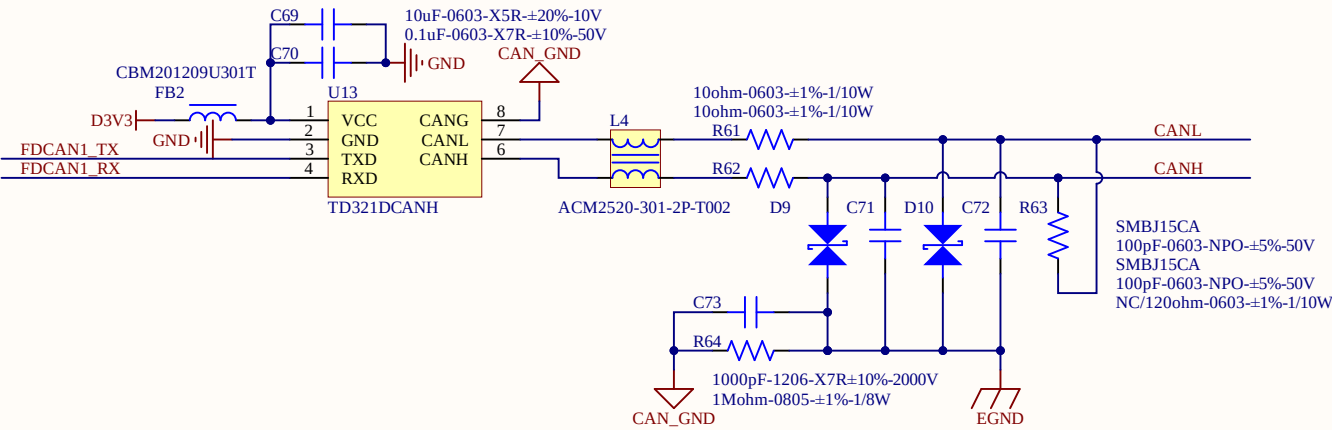

SWD调试口

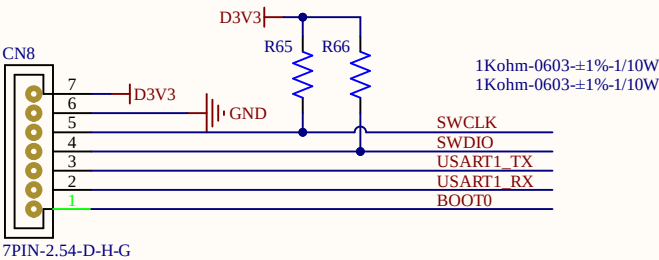

名称		文件编号		页码	6 / 6
公司	杭州犀燃医疗器械科技有限公司			版本	
设计		审核		批准	