


電腦斷層把定向量測、多角度資料與重建模型接成影像證據

量測前需校正 I_0 、位置、角度與偵測器響應


1 量測各方向的透射



$$p = -\ln(I/I_0) \approx \sum \mu_j \Delta \ell$$


光源與偵測器同步轉動
射線穿過較多物質時， I/I_0 較小

2 多角度衰減資料

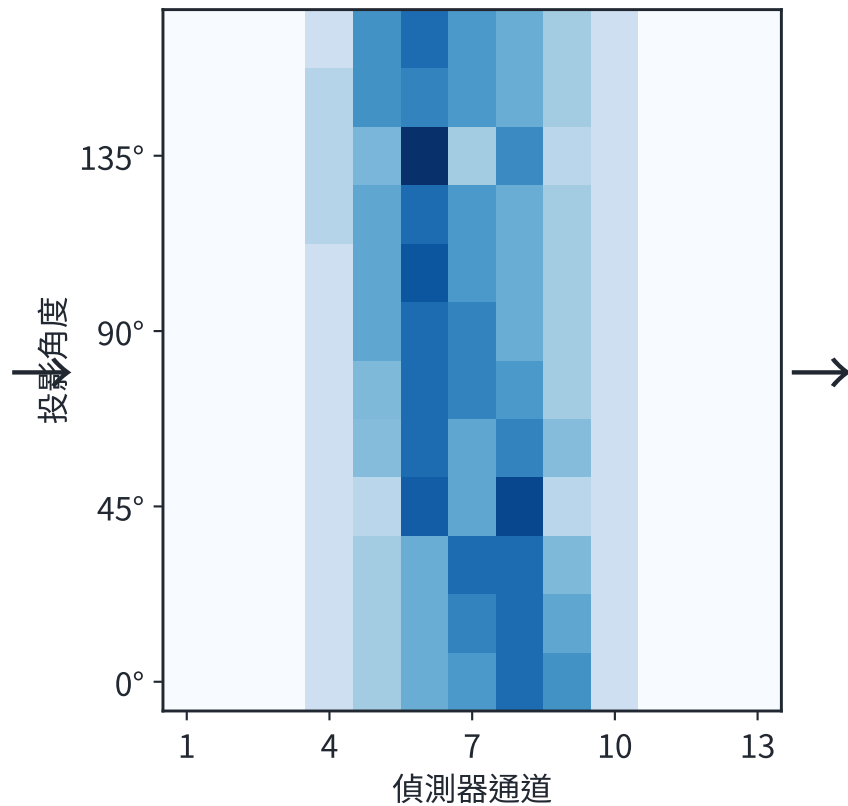

深色格：該角度與通道的總衰減較大

3 簡化反投影

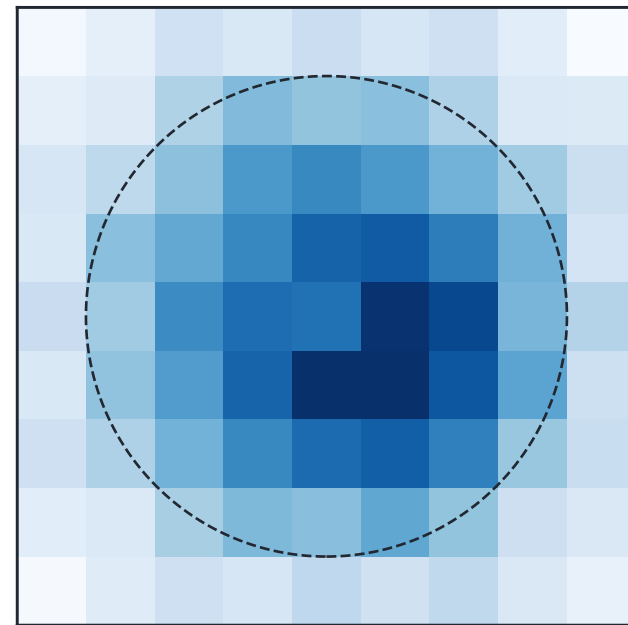

未濾波模型可定位高衰減區，但輪廓仍模糊