


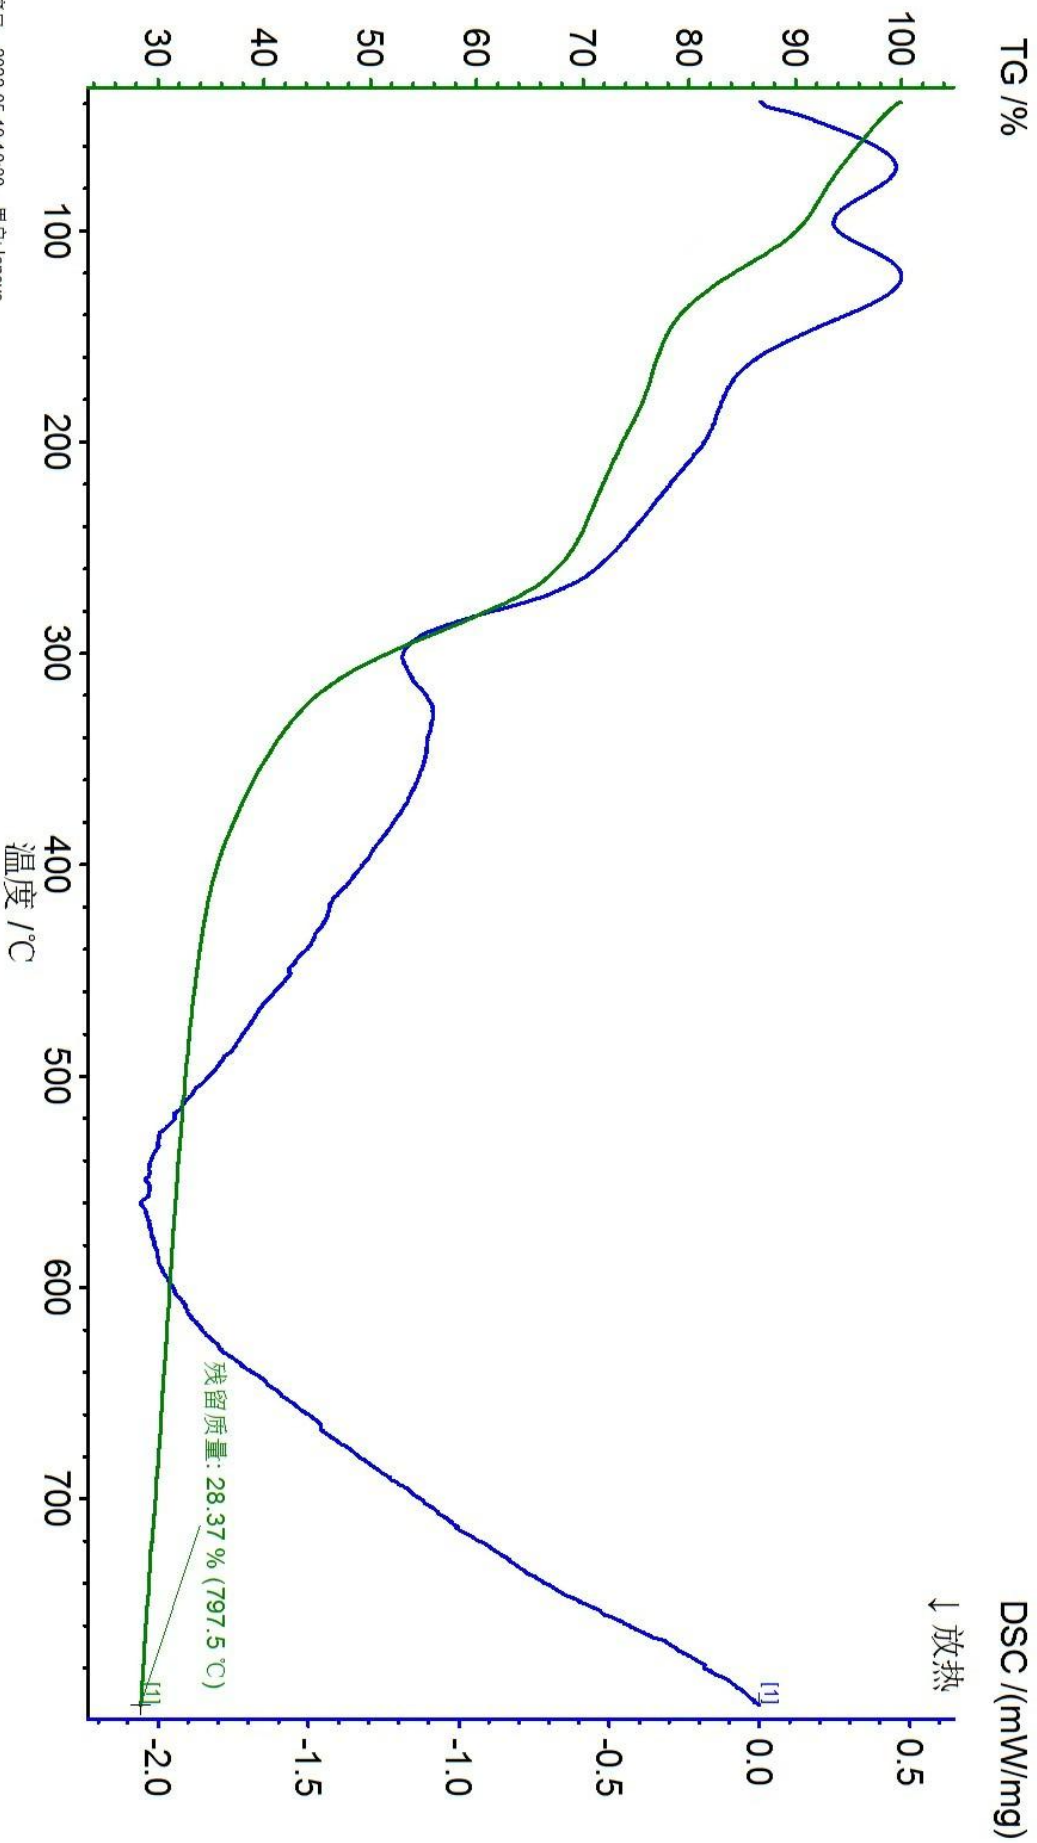

仪器：NETZSCH STA 449F3 STA449F3A-1312-M				文件：D:\HX\ML\阿晓5.1410.ngb-ds3			
项目：	样品：	0.86147 mg	样品支架/热电偶：	DSC/TG Std S /S	TG 校正/测量范围：	020/35000 mg	
标识：0	材料：	Al2O3	模式/测量类型：	DSC-TG / 样品+修正	DSC 校正/测量范围：	022/5000 μV	
日期/时间：2022/5/18 15:07:04	校正文件：	基线-10K-1200-20180510.ngb-bs3	段：	1/1			
实验室：	温度/灵敏度校正文件：	20150721.ngb-ts3 / 20150721.ngb-es3	坩埚：	DSC/TG pan Al2O3			
操作者：lyf	范围：	40°C/10.0K(mn)/800°C	气氛：	<not defined>/0 / NITROGEN/50 / NITROGEN/20			