


Операция 070. Контроль качества и укупорка

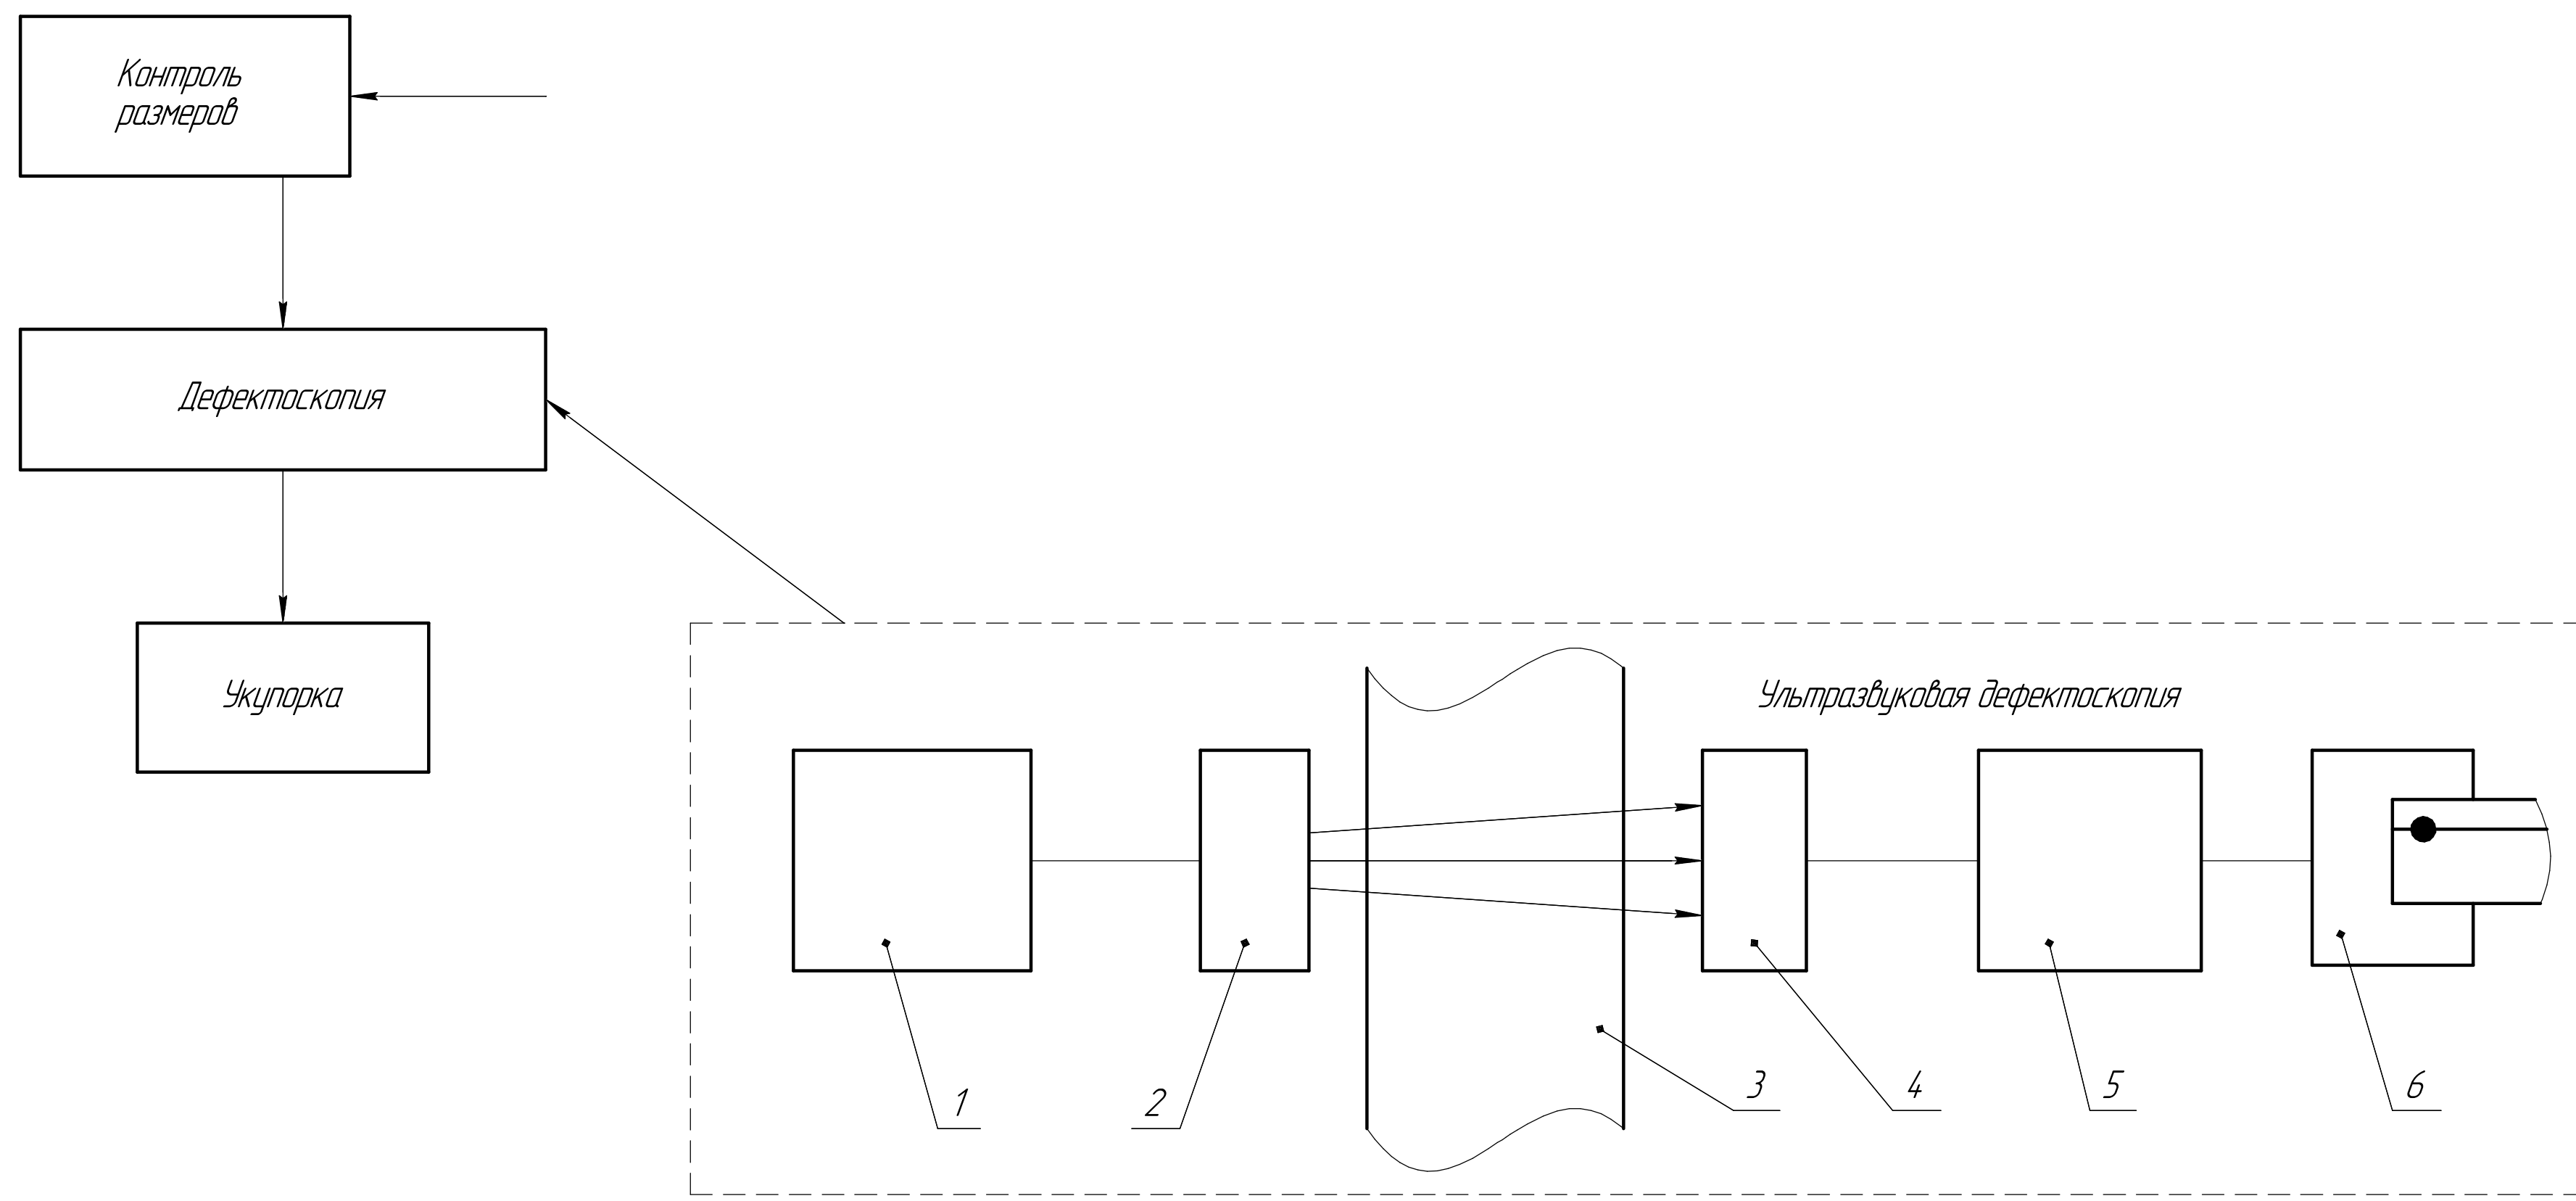

- 1 – генератор ультразвуковой аппаратуры;
- 2 – излучающий преобразователь;
- 3 – снаряженный корпус;
- 4 – приемный преобразователь;
- 5 – приемник ультразвуковой аппаратуры;
- 6 – регистрирующее устройства.

- 1. Оборудование:
 - ультразвуковой дефектоскоп, УЗД-150
- 2. Скорость перемещения стола не более 10 мм/с
- 3. Не допускаются пустоты в заряде с размером более 5 мм и суммарным объемом более 10 см³
- 4. Не допускаются сколы, трещины и расслоения в заряде

					Выпускная квалификационная работа		
					Операционная карта		
					Лист	Масса	Масштаб
					Лист		
					МГТУ им. Н.Э. Баумана		
					кафедра "Ракетные двигатели"		
					группа ЭТ-122		
					Формат А2		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Габрилова Е.И.		
Проб.		Комков М.А.		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Копировал