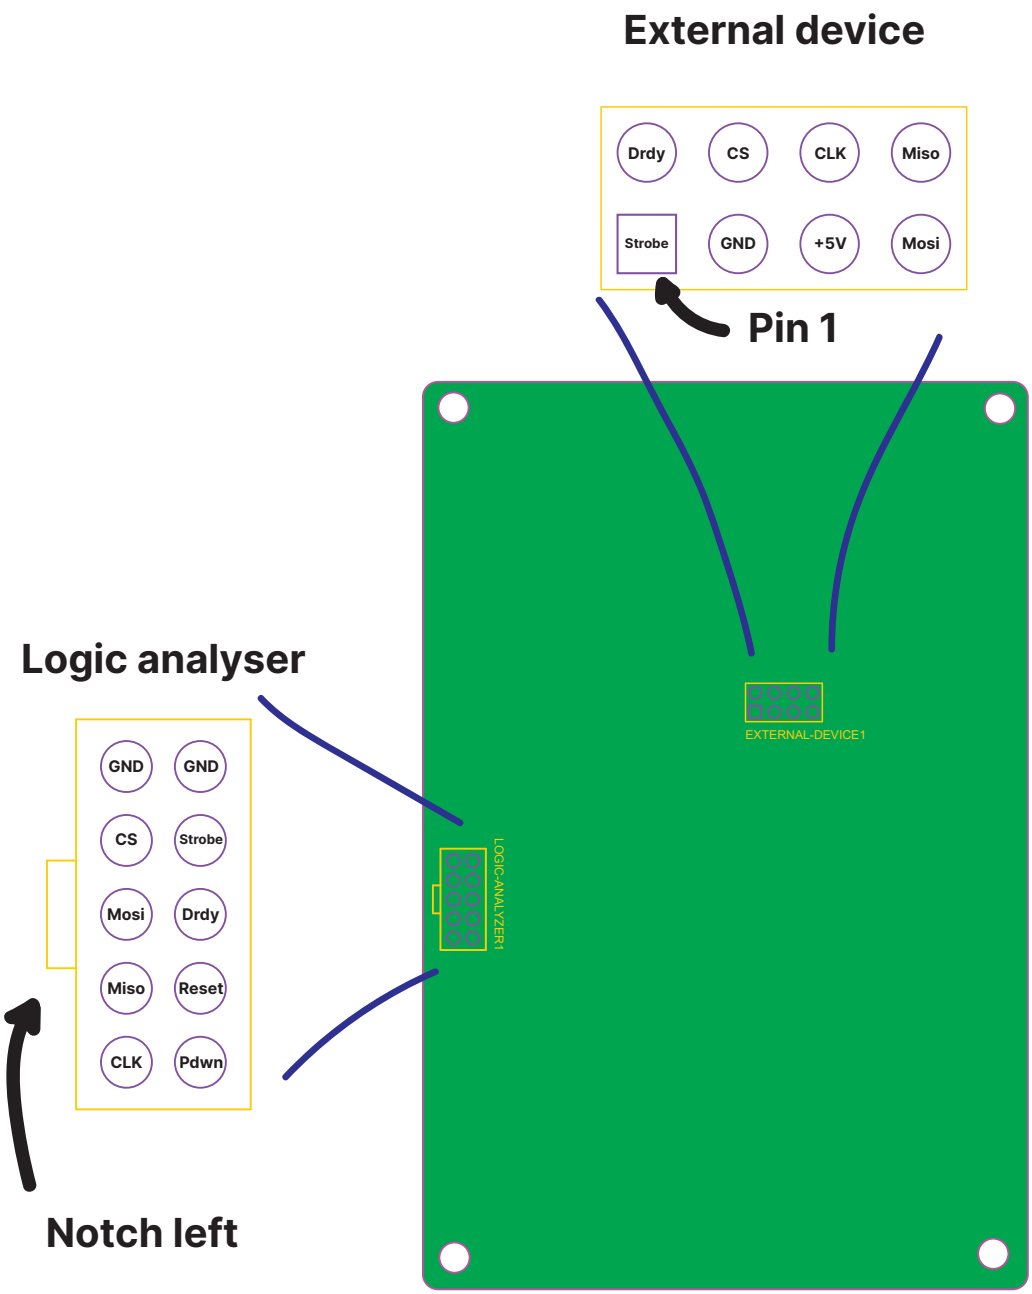
External device
Drdy
CS
CLK
Miso
Strobe
GND
+5V
Mosi
Pin 1
Logic analyser
GND
GND
CS
Strobe
Mosi
Drdy
Miso
Reset
CLK
Pdwn
Notch left
EXTERNAL-DEVICE1
LOGIC-ANALYZER1

Scale 1:1