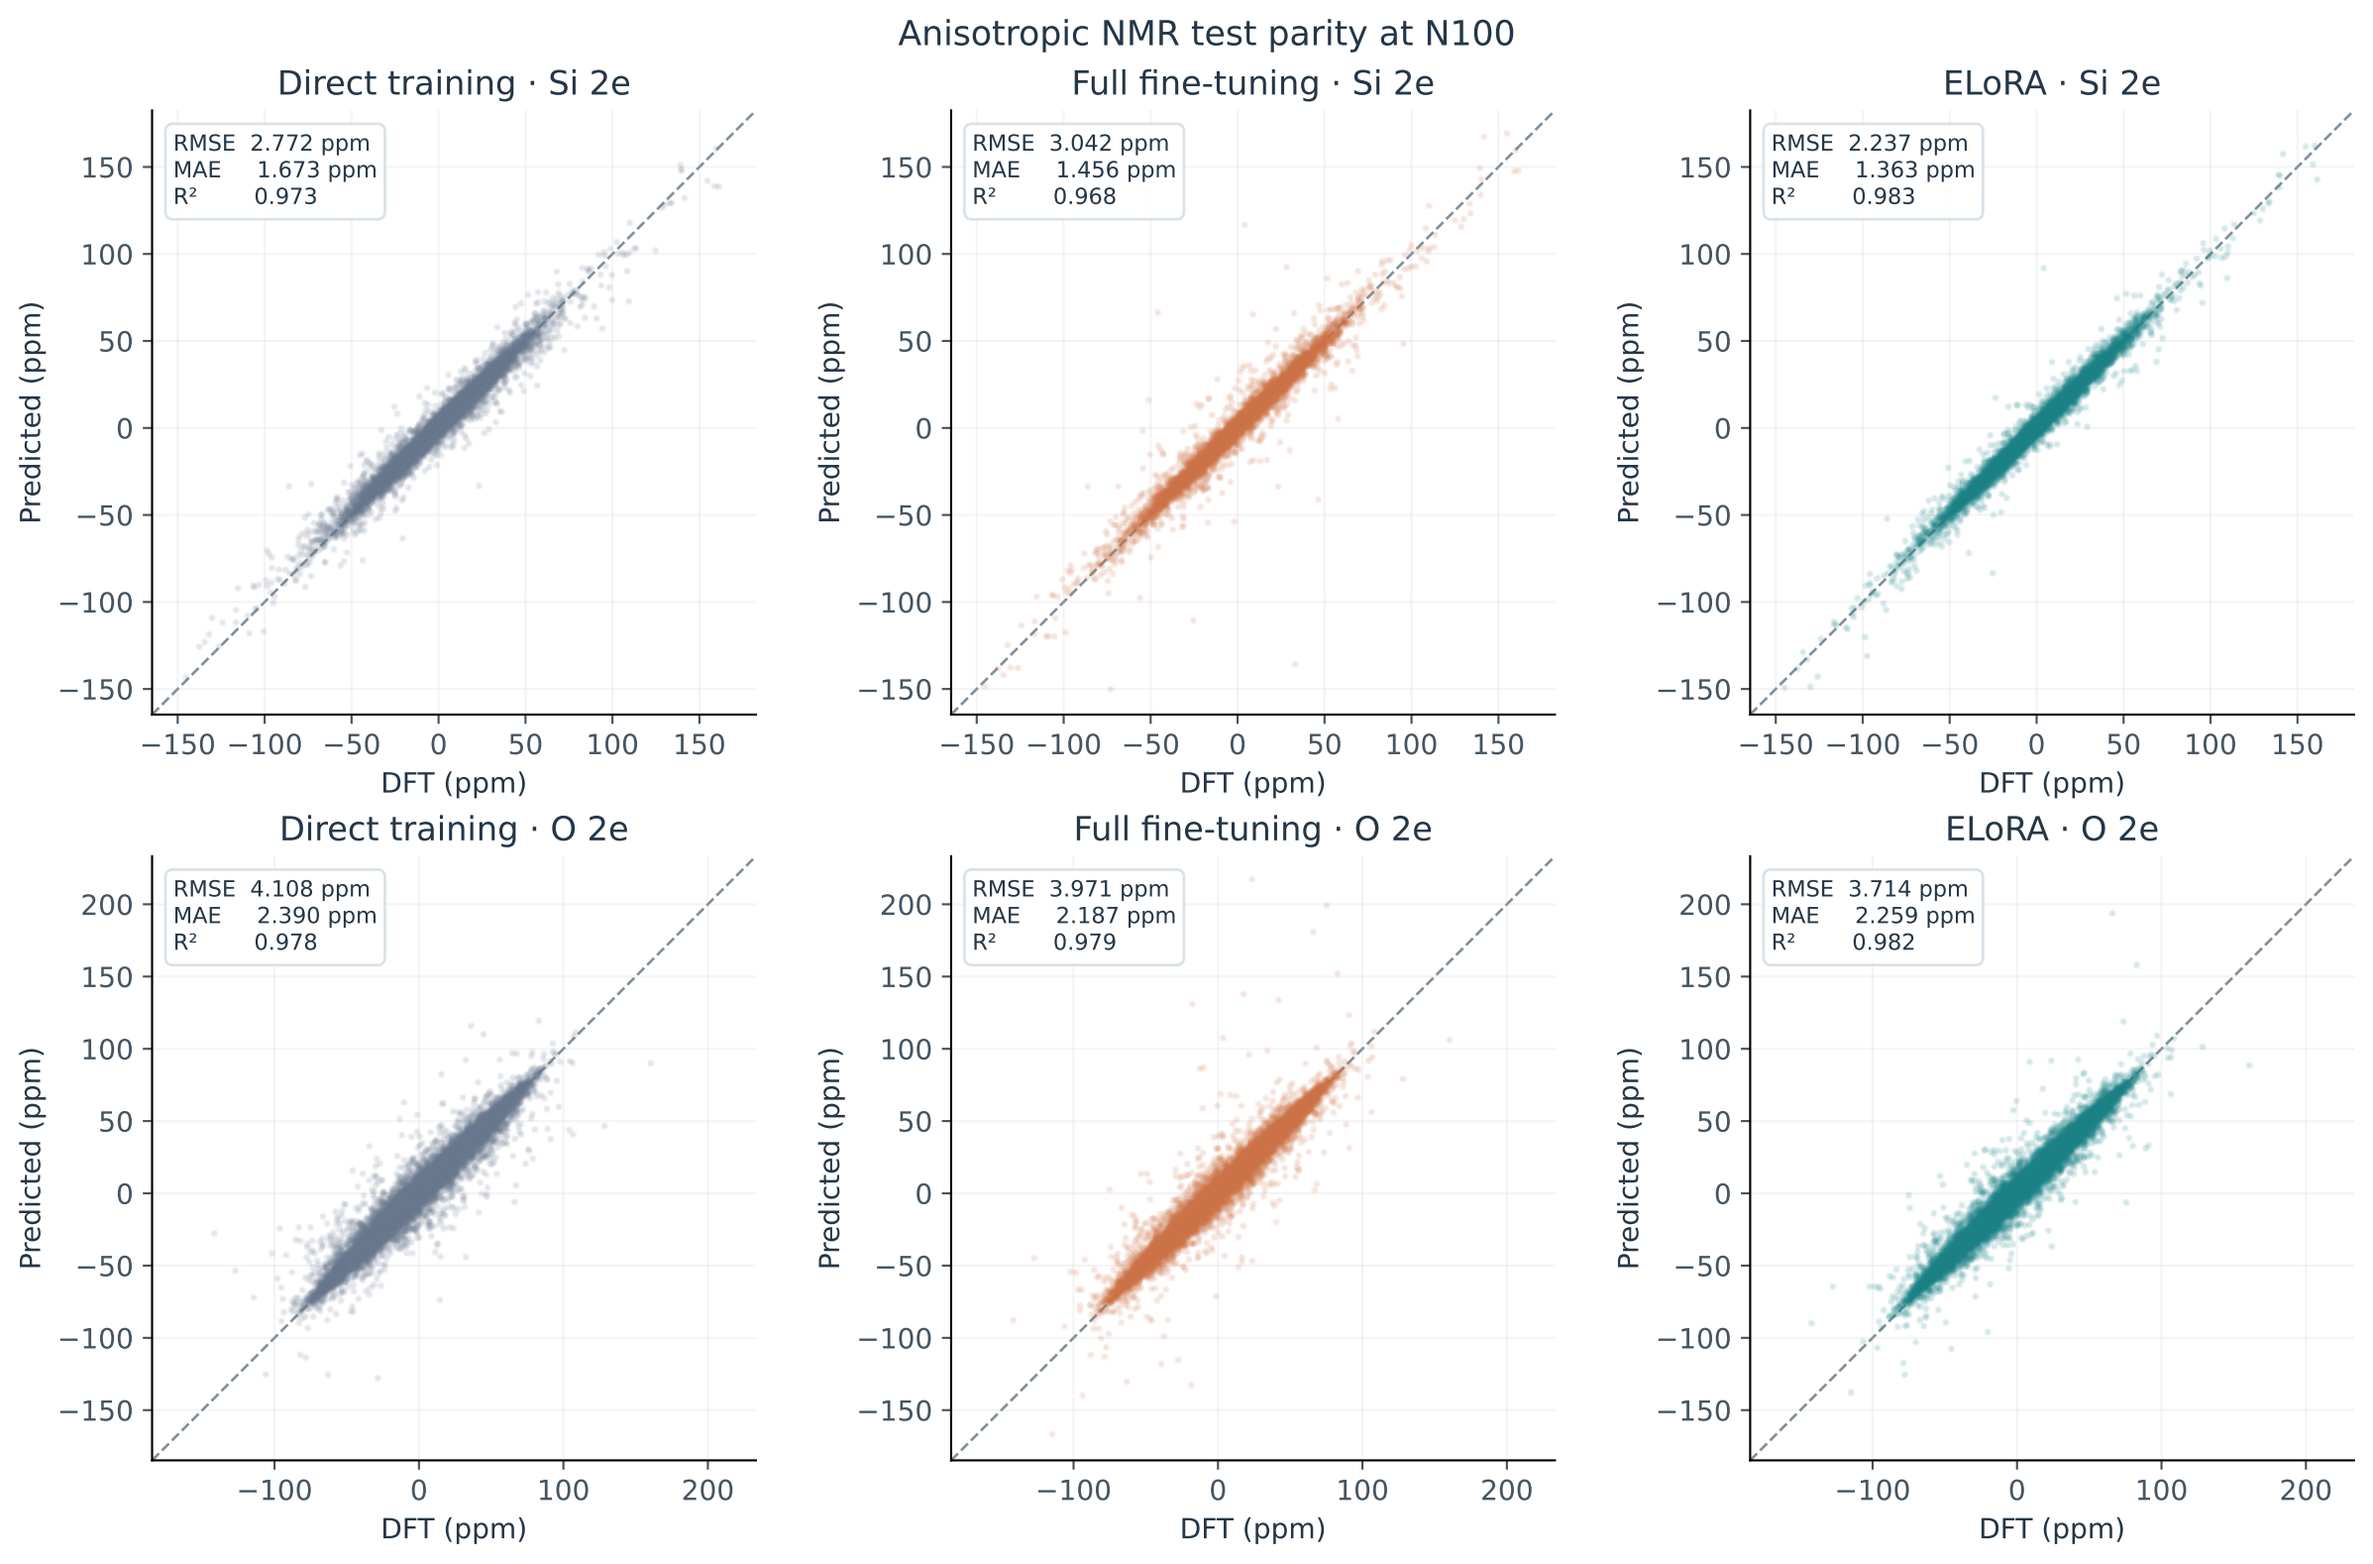

Anisotropic NMR test parity at N100
Direct training · Si 2e
RMSE 2.772 ppm
MAE 1.673 ppm
R² 0.973
Full fine-tuning · Si 2e
RMSE 3.042 ppm
MAE 1.456 ppm
R² 0.968
ELoRA · Si 2e
RMSE 2.237 ppm
MAE 1.363 ppm
R² 0.983
Direct training · O 2e
RMSE 4.108 ppm
MAE 2.390 ppm
R² 0.978
Full fine-tuning · O 2e
RMSE 3.971 ppm
MAE 2.187 ppm
R² 0.979
ELoRA · O 2e
RMSE 3.714 ppm
MAE 2.259 ppm
R² 0.982
Predicted (ppm)
DFT (ppm)