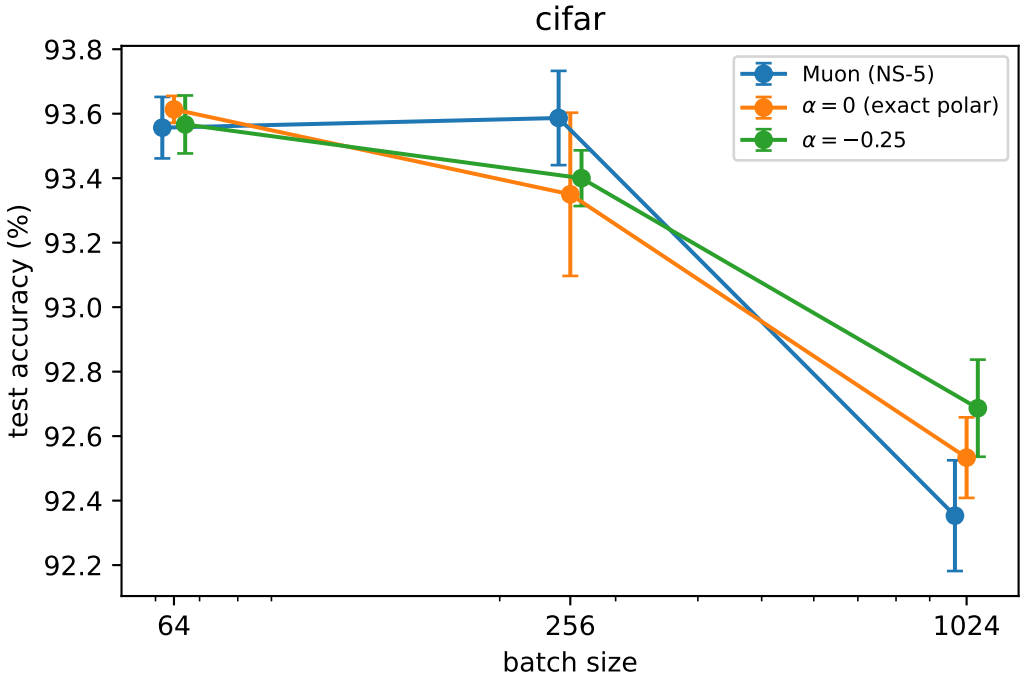
cifar
test accuracy (%)
93.8
93.6
93.4
93.2
93.0
92.8
92.6
92.4
92.2
64
256
1024
batch size
Muon (NS-5)
$\alpha = 0$ (exact polar)
$\alpha = -0.25$

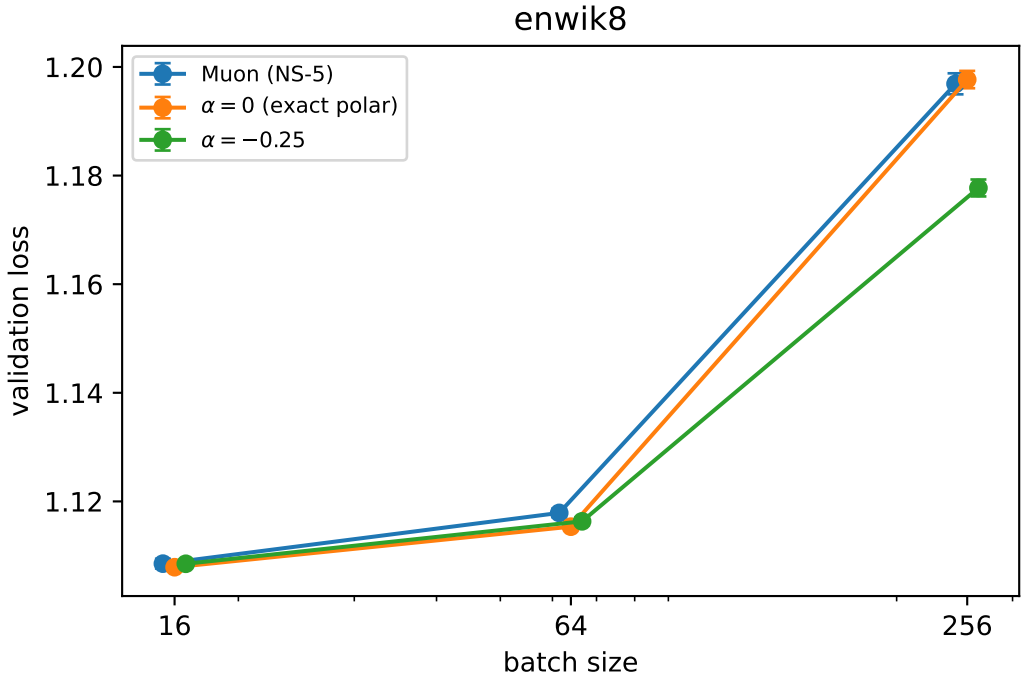
enwik8
validation loss
1.20
1.18
1.16
1.14
1.12
16
64
256
batch size
Muon (NS-5)
$\alpha = 0$ (exact polar)
$\alpha = -0.25$