




3.3 – Valores Certificados

Filtro	λ (nm) à 25°C - Slit 1 nm				
	279 nm	361 nm	453 nm	536 nm	638 nm
666-F1	279,08 \pm 0,30	361,02 \pm 0,30	453,78 \pm 0,30	536,46 \pm 0,30	637,56 \pm 0,30

As incertezas expandidas (U) declaradas para intervalo de confiança de 95% , correspondem a soma das incertezas dos padrões primários NIST, reprodutibilidade das medidas e erros sistemáticos do instrumento.

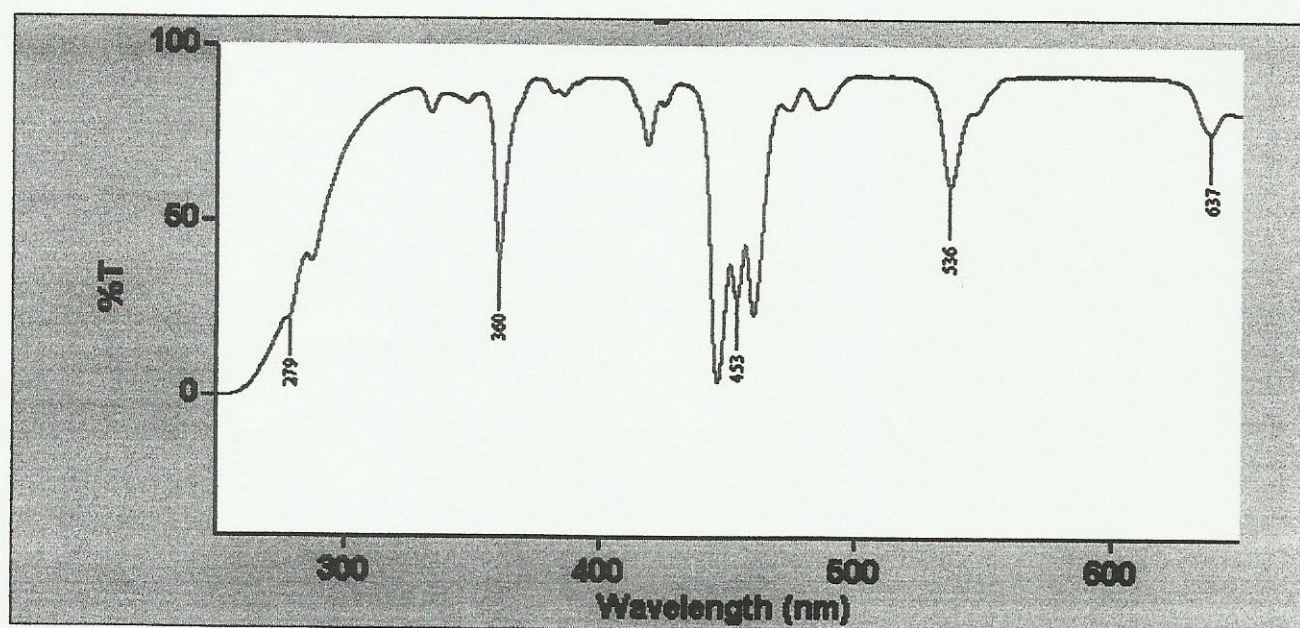

Espectro Típico do Filtro de Holmio