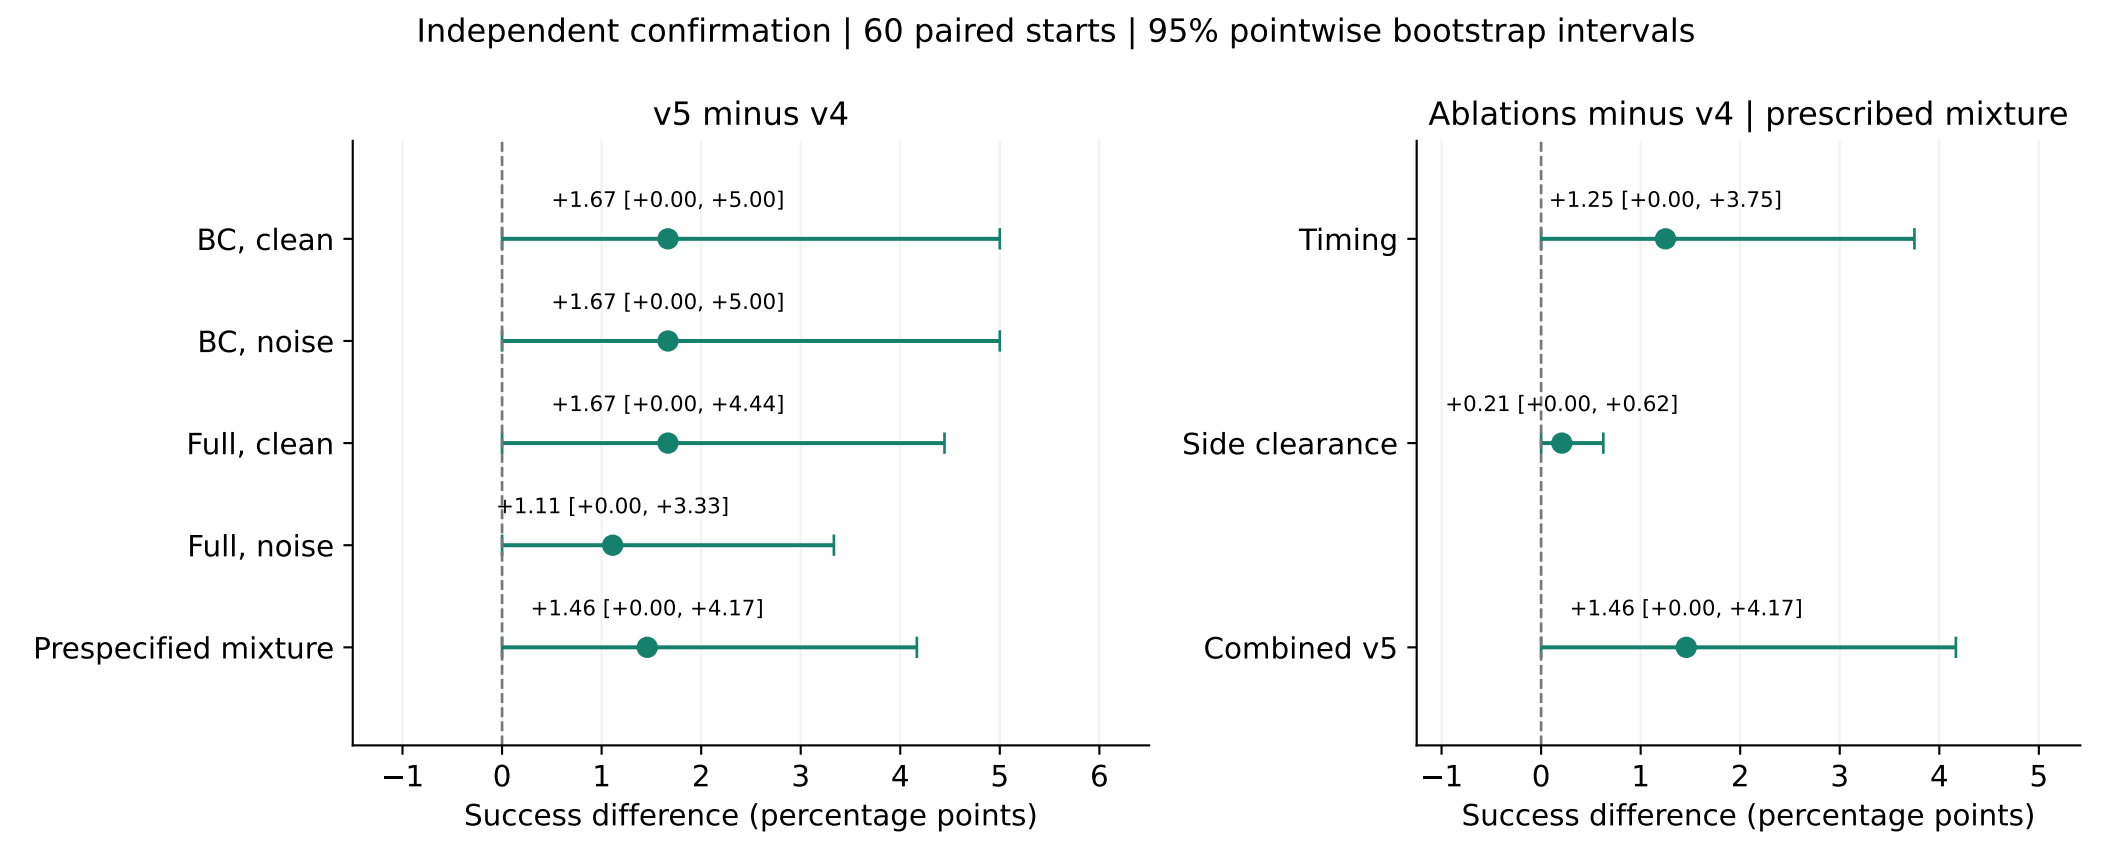
Independent confirmation | 60 paired starts | 95% pointwise bootstrap intervals
v5 minus v4
BC, clean
+1.67 [+0.00, +5.00]
BC, noise
+1.67 [+0.00, +5.00]
Full, clean
+1.67 [+0.00, +4.44]
Full, noise
+1.11 [+0.00, +3.33]
Prespecified mixture
+1.46 [+0.00, +4.17]
−1
0
1
2
3
4
5
6
Success difference (percentage points)
Ablations minus v4 | prescribed mixture
Timing
+1.25 [+0.00, +3.75]
Side clearance
+0.21 [+0.00, +0.62]
Combined v5
+1.46 [+0.00, +4.17]
−1
0
1
2
3
4
5
Success difference (percentage points)