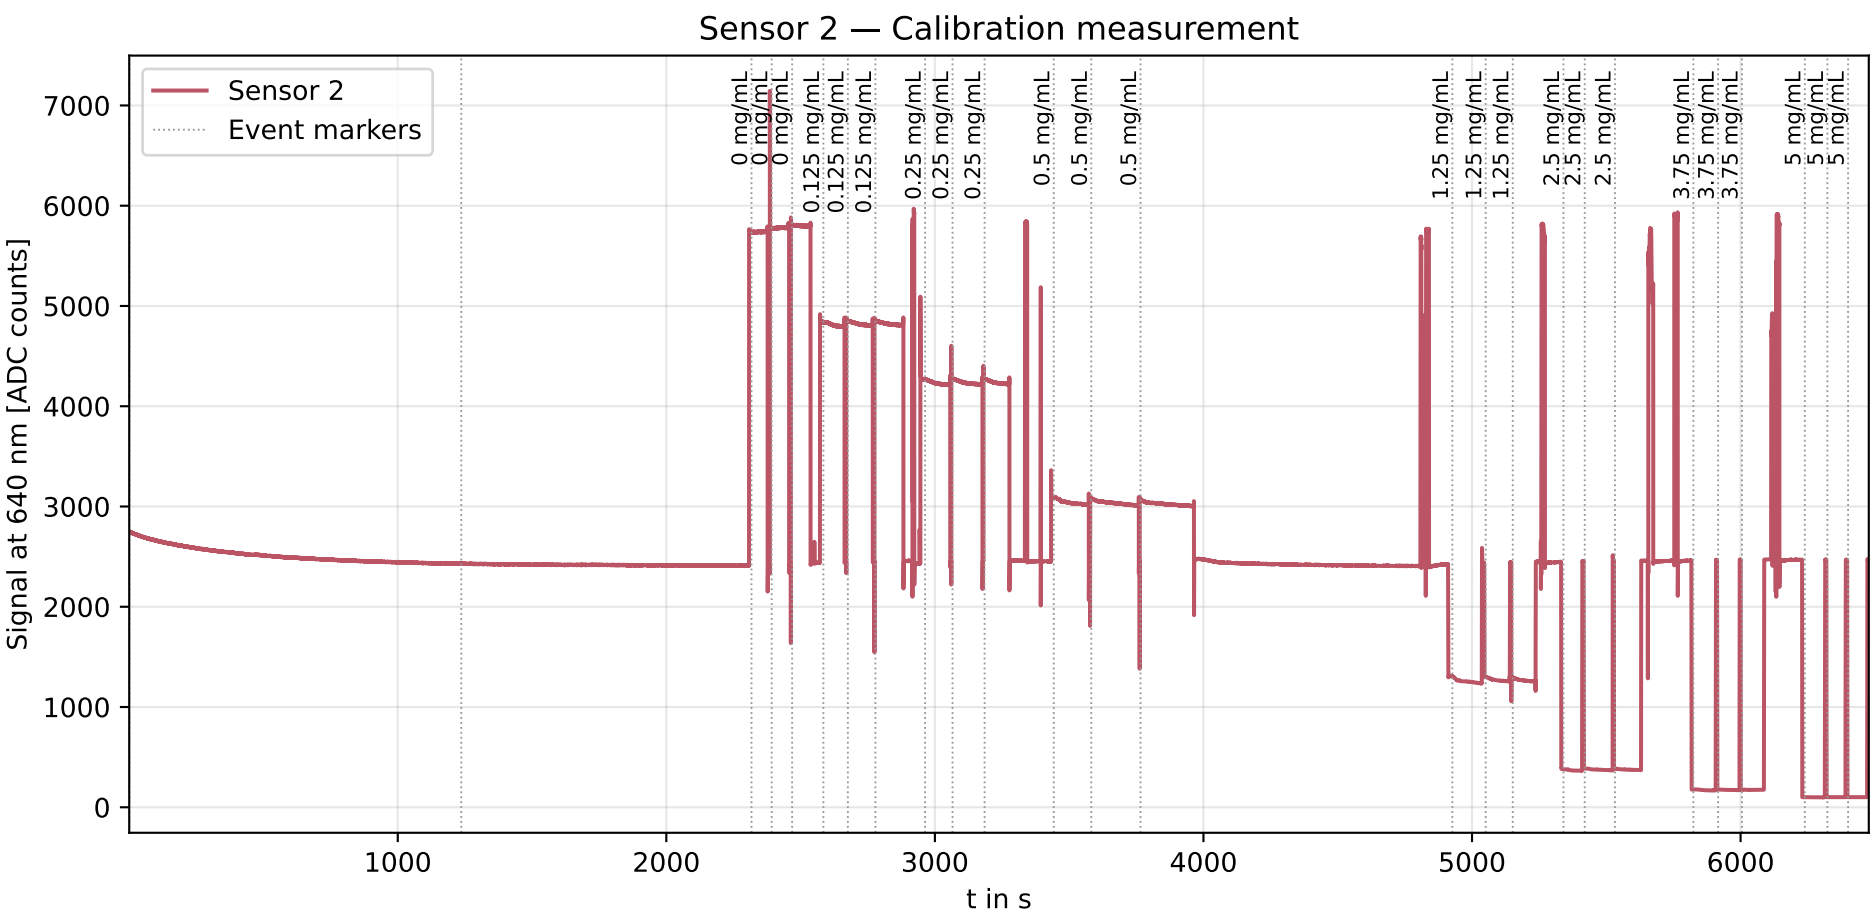

Sensor 2 — Calibration measurement
Sensor 2
Event markers
0 mg/mL
0 mg/mL
0 mg/mL
0.125 mg/mL
0.125 mg/mL
0.125 mg/mL
0.25 mg/mL
0.25 mg/mL
0.25 mg/mL
0.5 mg/mL
0.5 mg/mL
0.5 mg/mL
1.25 mg/mL
1.25 mg/mL
1.25 mg/mL
2.5 mg/mL
2.5 mg/mL
2.5 mg/mL
3.75 mg/mL
3.75 mg/mL
3.75 mg/mL
5 mg/mL
5 mg/mL
5 mg/mL
Signal at 640 nm [ADC counts]
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1000
2000
3000
4000
5000
6000
t in s